



EASYCAL™ 5

Kalibrier-Software | Calibration software

Impressum

BRAND GMBH + CO KG
Otto-Schott-Str. 25
97877 Wertheim (Germany)
T +49 9342 808 0
F +49 9342 808 98000
info@brand.de
www.brand.de

Do you need more operating manuals and translations?
Please refer to <http://www.brand.de/om> or use the following Quick Response Code:



The original operating manual is written in German. Other languages are translations of the original operating manual.

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkungen	4
2	Installation.....	5
3	Erste Schritte in EASYCAL™ 5.....	14
3.1	Tutorial.....	14
3.1.1	Waage als Prüfmittel einrichten	14
3.1.2	Auftrag anlegen	14
3.1.3	Prüfmittel festlegen	19
3.1.4	Prüfung durchführen	19
3.1.5	Prüfung abschließen.....	27

1 Vorbemerkungen


Das vorliegende Tutorial soll Ihnen den Umgang mit EASYCAL™ 5 im Rahmen des 30-Tage-Testzeitraums erleichtern. Sie lernen hier an einem exemplarischen Ablauf, wie Sie verschiedene Bereiche von EASYCAL™ 5 befüllen, die erste Geräteprüfung durchführen und ein Zertifikat ausdrucken.

Bitte beachten Sie, dass im Zuge dieser Einführung Musterdaten in der Datenbank erzeugt werden, welche später nicht mehr gelöscht werden können. Wir empfehlen, dies mit den regulatorischen Vorgaben Ihres Qualitätsmanagementsystem abzustimmen.

2 Installation


Voraussetzung:

- ✓ Sie haben bereits die Installationsdatei von EASYCAL™ 5, EasyCal-Setup.exe, von der BRAND Homepage erhalten und lokal gespeichert.
 - ✓ Sie haben eine Demolizenz (Ticket) per E-Mail erhalten.
 - ✓ Sie besitzen lokale Adminrechte und haben eine bestehende Internetverbindung.
- a. Starten Sie die Installation durch Öffnen der EasyCal-Setup.exe und folgen Sie den Anweisungen im Installationsassistenten.

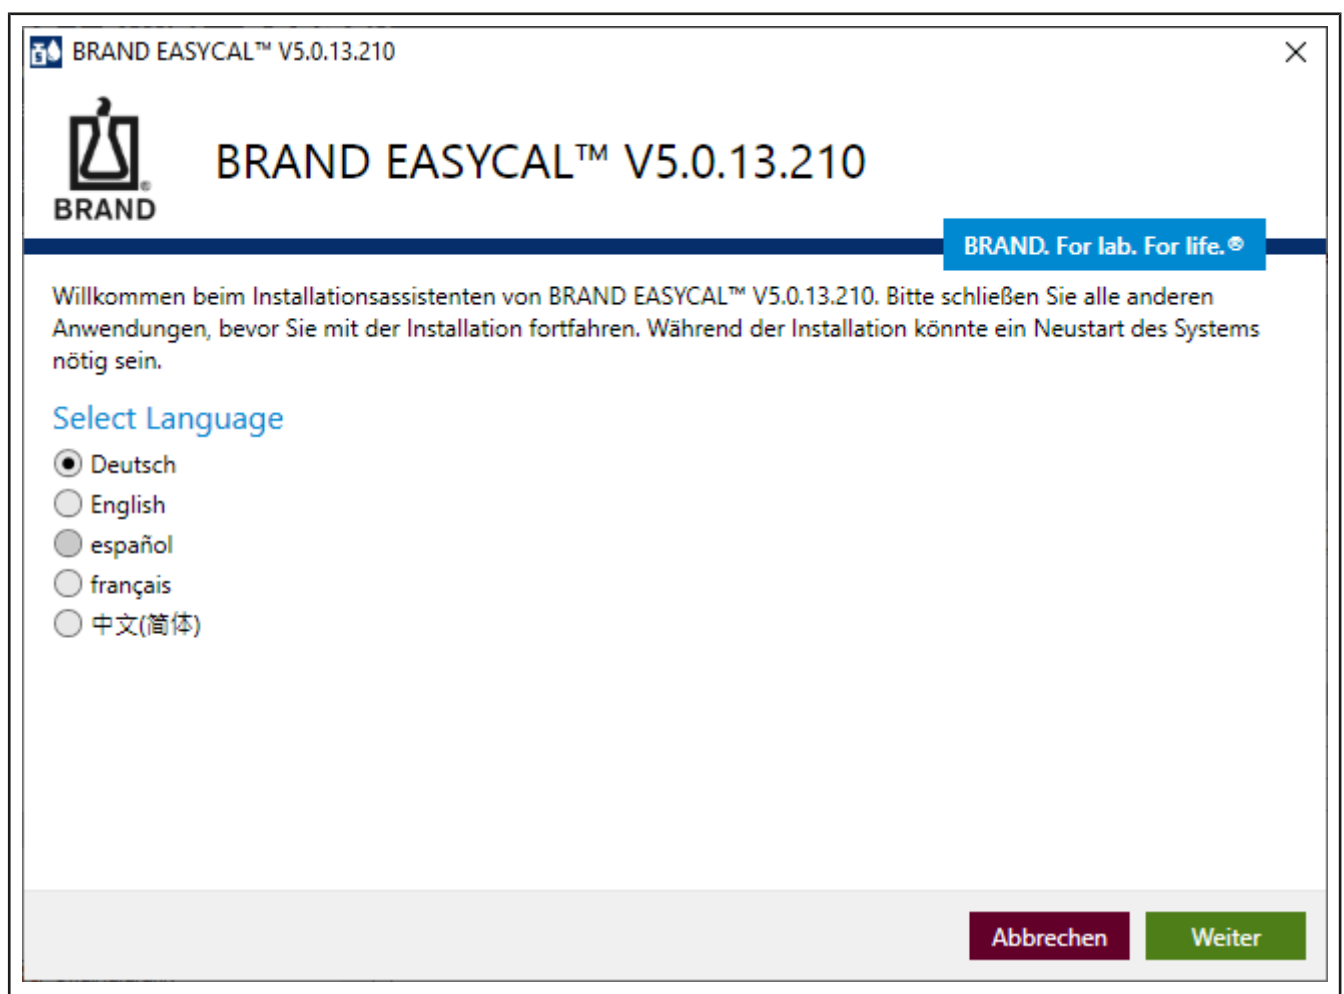


➔ EASYCAL™ 5 sowie alle zum Betrieb benötigten Softwarekomponenten werden auf Ihrem PC installiert.

- b. Nach Abschluss der Installation starten Sie EASYCAL™ 5, indem Sie den Haken setzen und auf Fertigstellen klicken.

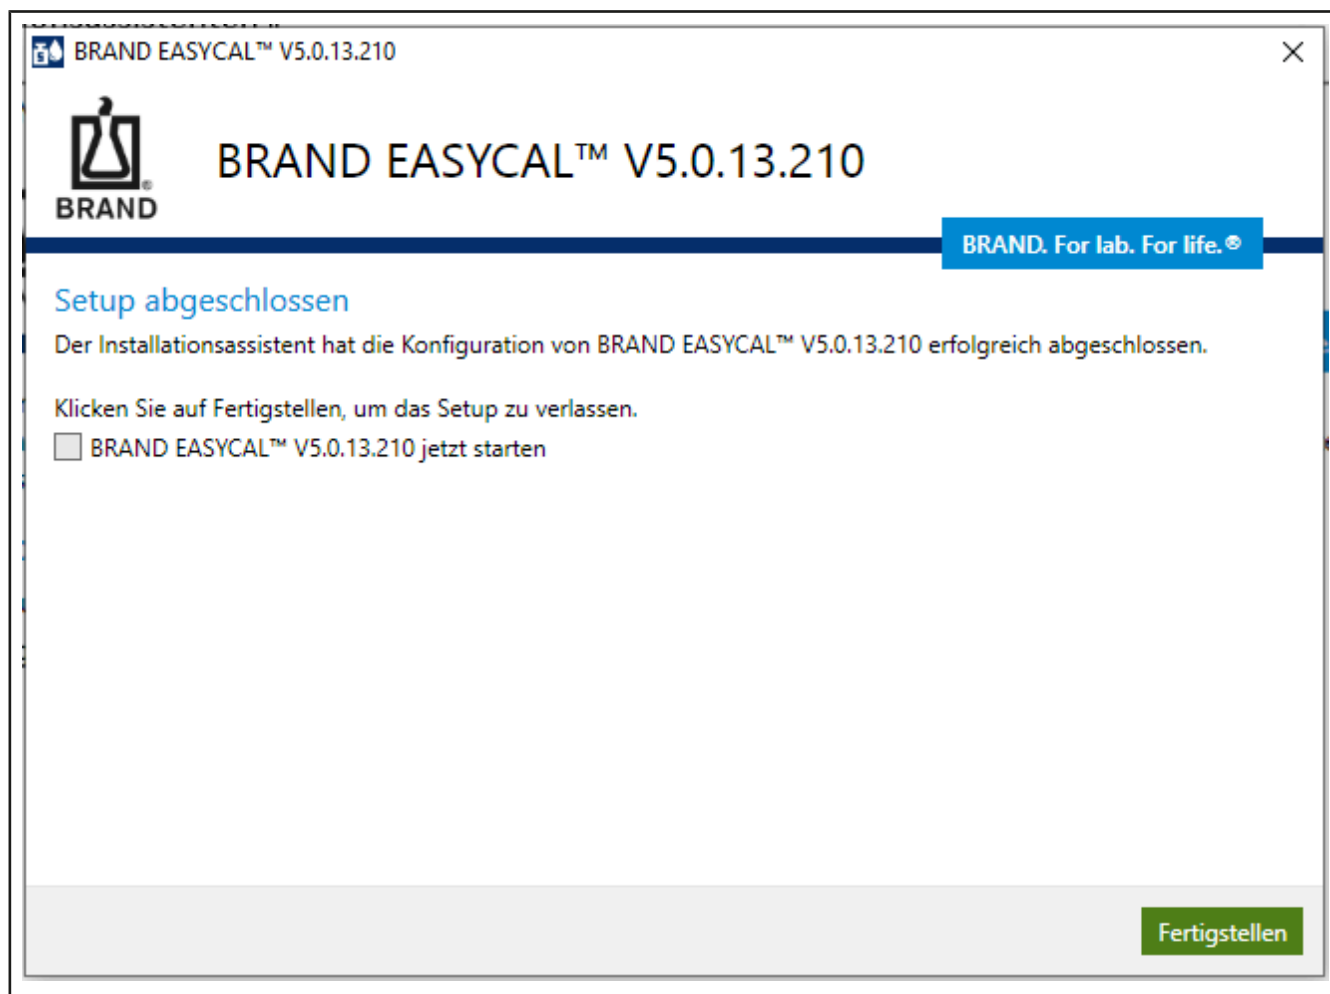


- c. Sie werden aufgefordert EASYCAL™ 5 zu aktivieren.

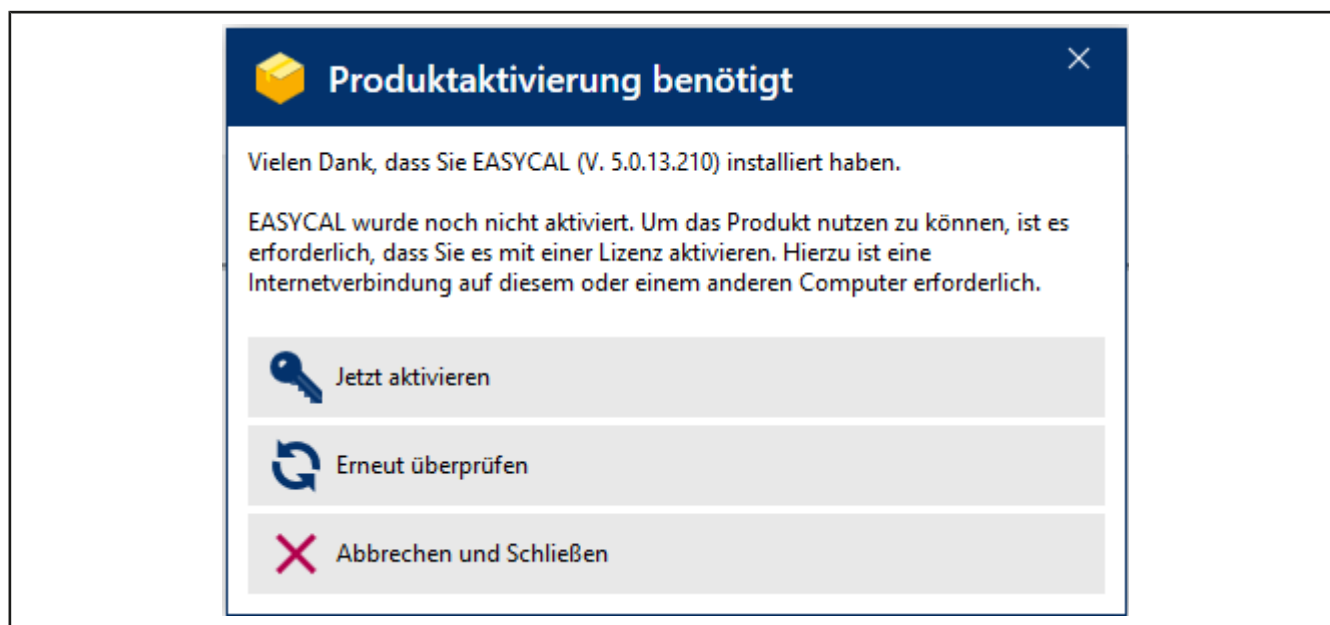

- d. Klicken Sie auf Jetzt aktivieren.

➔ Es öffnet sich Ihr Standard-Webbrowser mit der Seite <https://license.brand.de/index.php>.

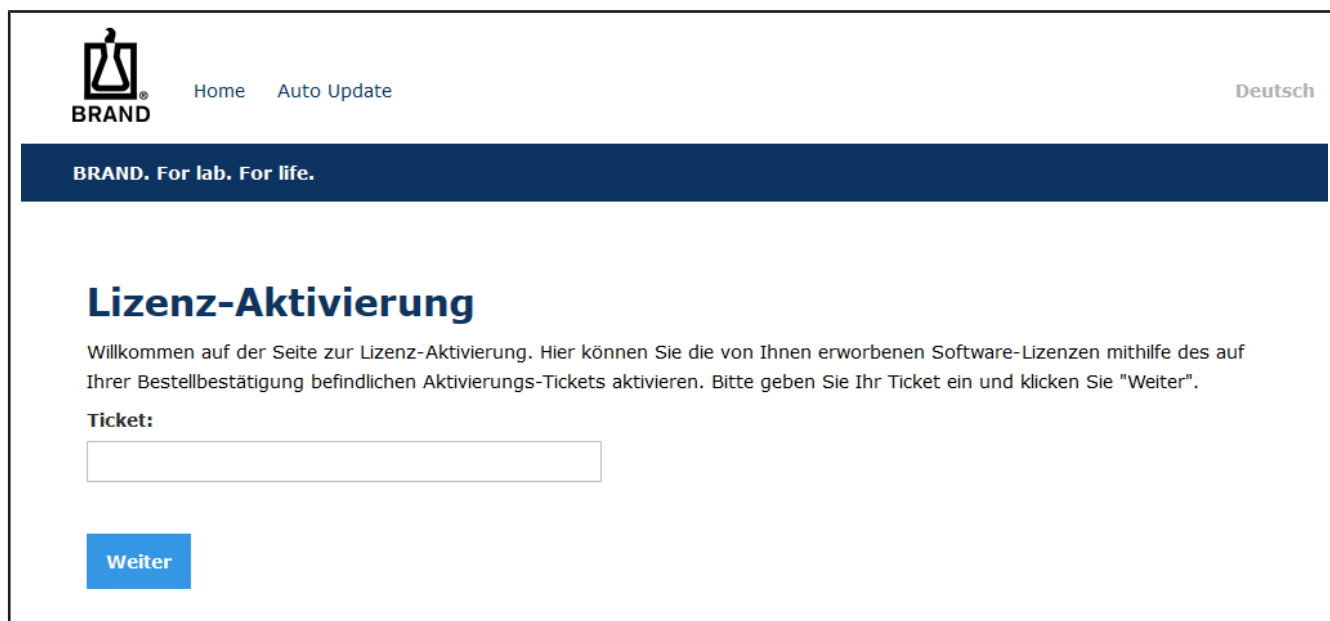

BRAND. For lab. For life.


Lizenz-Aktivierung

Willkommen auf der Seite zur Lizenz-Aktivierung. Hier können Sie die von Ihnen erworbenen Software-Lizenzen mithilfe des auf Ihrer Bestellbestätigung befindlichen Aktivierungs-Tickets aktivieren. Bitte geben Sie Ihr Ticket ein und klicken Sie "Weiter".

Ticket:

Weiter

- e. Geben Sie hier Ihr Ticket (= Lizenzschlüssel) ein.

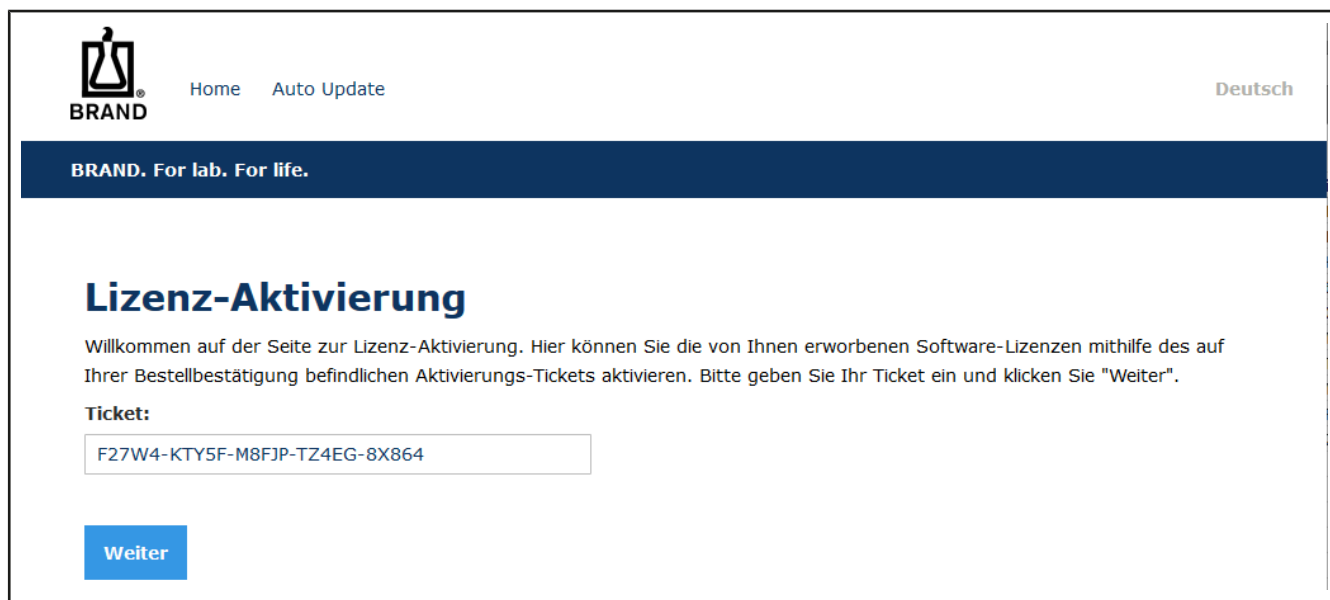

BRAND. For lab. For life.


Lizenz-Aktivierung

Willkommen auf der Seite zur Lizenz-Aktivierung. Hier können Sie die von Ihnen erworbenen Software-Lizenzen mithilfe des auf Ihrer Bestellbestätigung befindlichen Aktivierungs-Tickets aktivieren. Bitte geben Sie Ihr Ticket ein und klicken Sie "Weiter".

Ticket:

Weiter

- f. Klicken Sie auf Weiter.

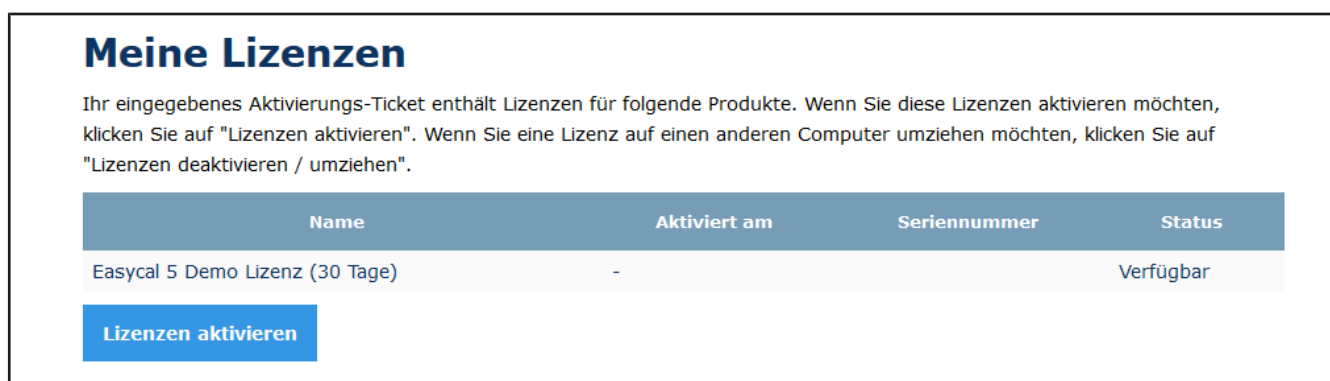

Meine Lizenzen

Ihr eingegebenes Aktivierungs-Ticket enthält Lizenzen für folgende Produkte. Wenn Sie diese Lizenzen aktivieren möchten, klicken Sie auf "Lizenzen aktivieren". Wenn Sie eine Lizenz auf einen anderen Computer umziehen möchten, klicken Sie auf "Lizenzen deaktivieren / umziehen".

Name	Aktiviert am	Seriennummer	Status
Easycal 5 Demo Lizenz (30 Tage)	-		Verfügbar

Lizenzen aktivieren

- g. Klicken Sie auf Lizenz aktivieren.


[Home](#)
[Meine Lizenzen](#)
[Auto Update](#)
Deutsch

BRAND. For lab. For life.

Lizenzen aktivieren

So aktivieren Sie Ihre Lizenzen:

1. Wählen Sie die Lizenzen, die Sie aktivieren möchten.
2. Wählen Sie eine Lizenzdatei, in die die Lizenzen geladen werden sollen.
3. Klicken Sie auf "Ausgewählte Lizenzen jetzt aktivieren".

☒	Name	Aktiviert am	Seriennummer	Status
☒	Easycal 5 Demo Lizenz (30 Tage)	-		Verfügbar

Wählen Sie die Lizenzdatei

↻

[Ausgewählte Lizenzen jetzt aktivieren](#)
[Manuelle Lizenzübertragung](#)

[← Meine Lizenzen](#)

h. Ändern Sie nichts an den Einstellungen, klicken Sie auf Ausgewählte Lizenzen jetzt aktivieren.

→ Die Online-Lizenzübertragung wird durchgeführt.

Online-Lizenzübertragung

Starte Lizenzübertragung.
 Lade Lizenzvorlage vom Server.
 Registriere Lizenzvorlage.
 Generiere Lizenzübertragungsanfrage.
 Lade Lizenzaktualisierung vom Server.
 Übertrage Lizenzaktualisierung in das Ziel.
 Generiere Quittung.
 Sende Quittung.

☒
Lizenzübertragung erfolgreich abgeschlossen!

Ok

- i. Klicken Sie auf OK.

Meine Lizenzen


Ihr eingegebenes Aktivierungs-Ticket enthält Lizenzen für folgende Produkte. Wenn Sie diese Lizenzen aktivieren möchten, klicken Sie auf "Lizenzen aktivieren". Wenn Sie eine Lizenz auf einen anderen Computer umziehen möchten, klicken Sie auf "Lizenzen deaktivieren / umziehen".

Name	Aktiviert am	Seriennummer	Status
Easycal 5 Demo Lizenz (30 Tage)	2021-09-28 15:42:03	130-4164463369	Aktiviert


Lizenzen deaktivieren / umziehen

- j. Die Lizenz ist aktiviert. Sie können das Browser-Fenster schließen.

- k. Wechseln Sie zum Fenster der Produktaktivierung.

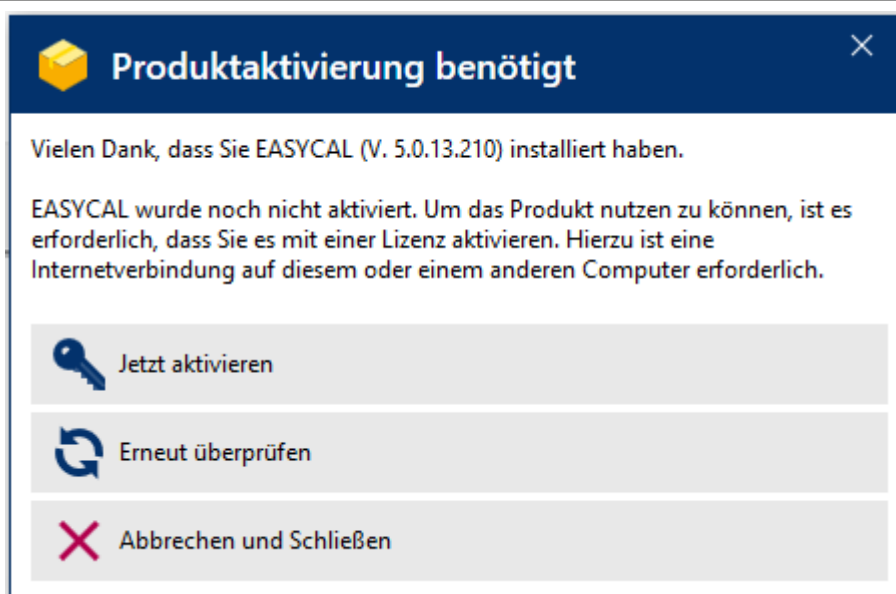


- l. Klicken Sie auf „Erneut überprüfen“.

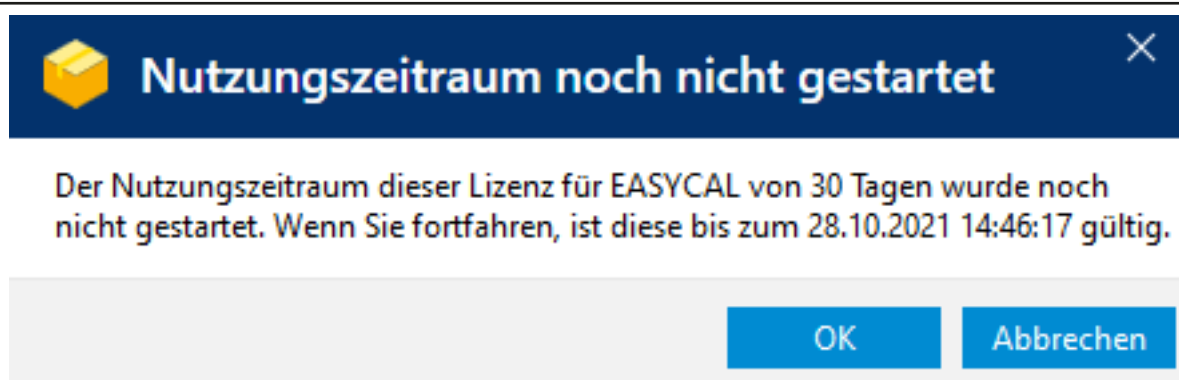

- m.** Mit Klick auf OK starten Sie den Nutzungszeitraum. Es erscheint ein Informationsfenster.




- n.** Klicken Sie auf OK.
- o.** Parallel wird EASYCAL™ 5 gestartet und es erscheint eine Benachrichtigung.

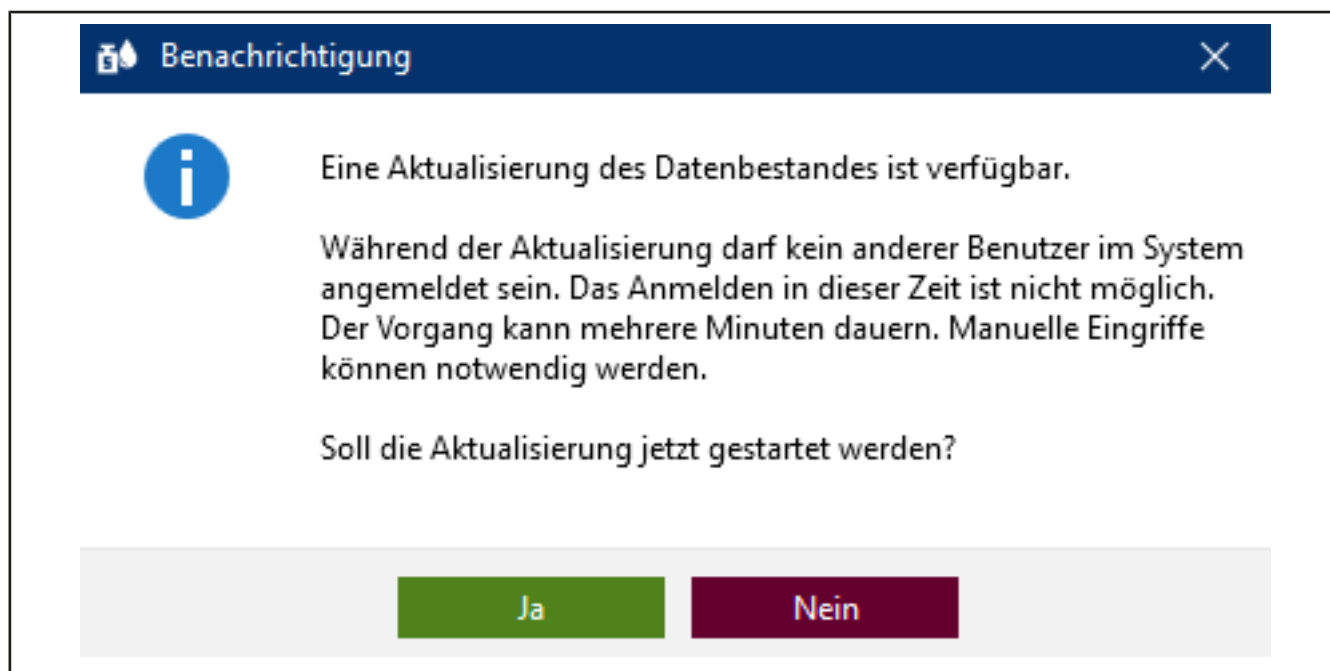


- p.** Quittieren Sie die Benachrichtigung mit Klick auf Ja, damit die Datenbank initial gefüllt wird.

- q. Es erscheint nach kurzer Zeit eine Benachrichtigung.

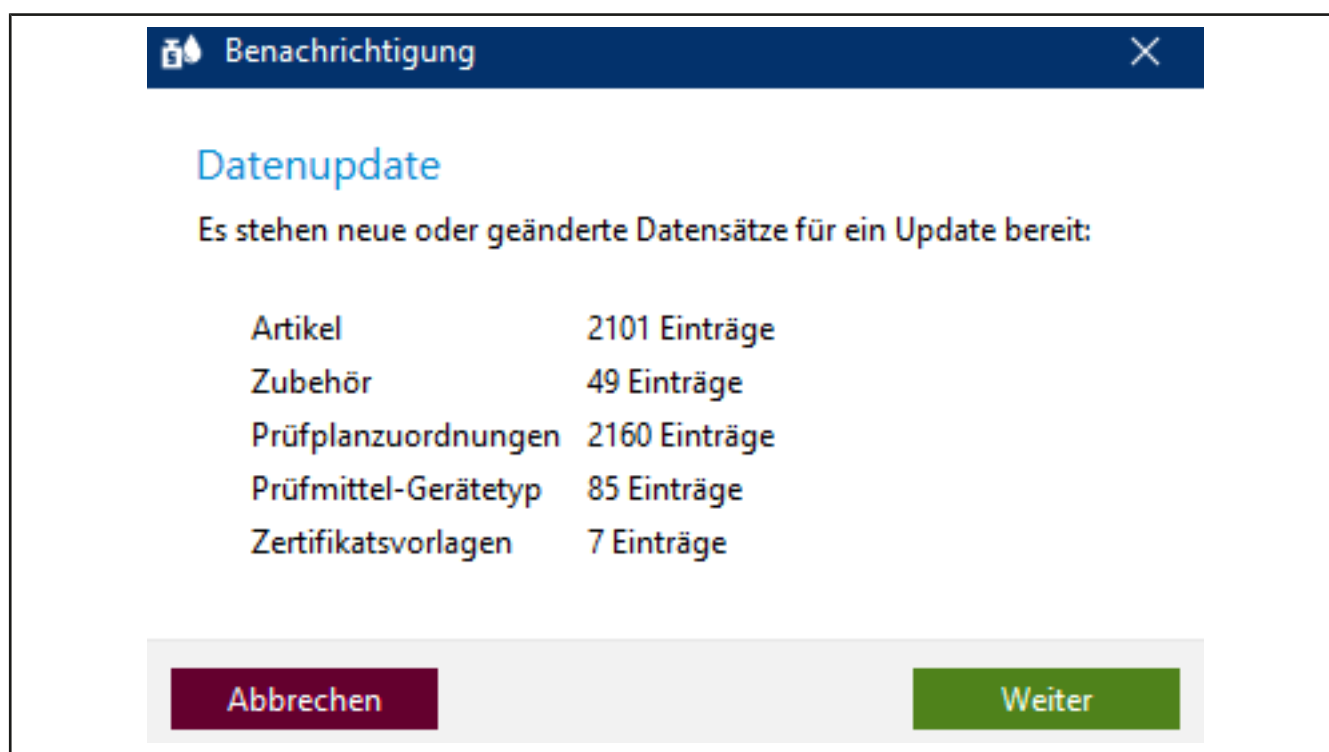


- r. Quittieren Sie diese mit Klick auf Weiter.

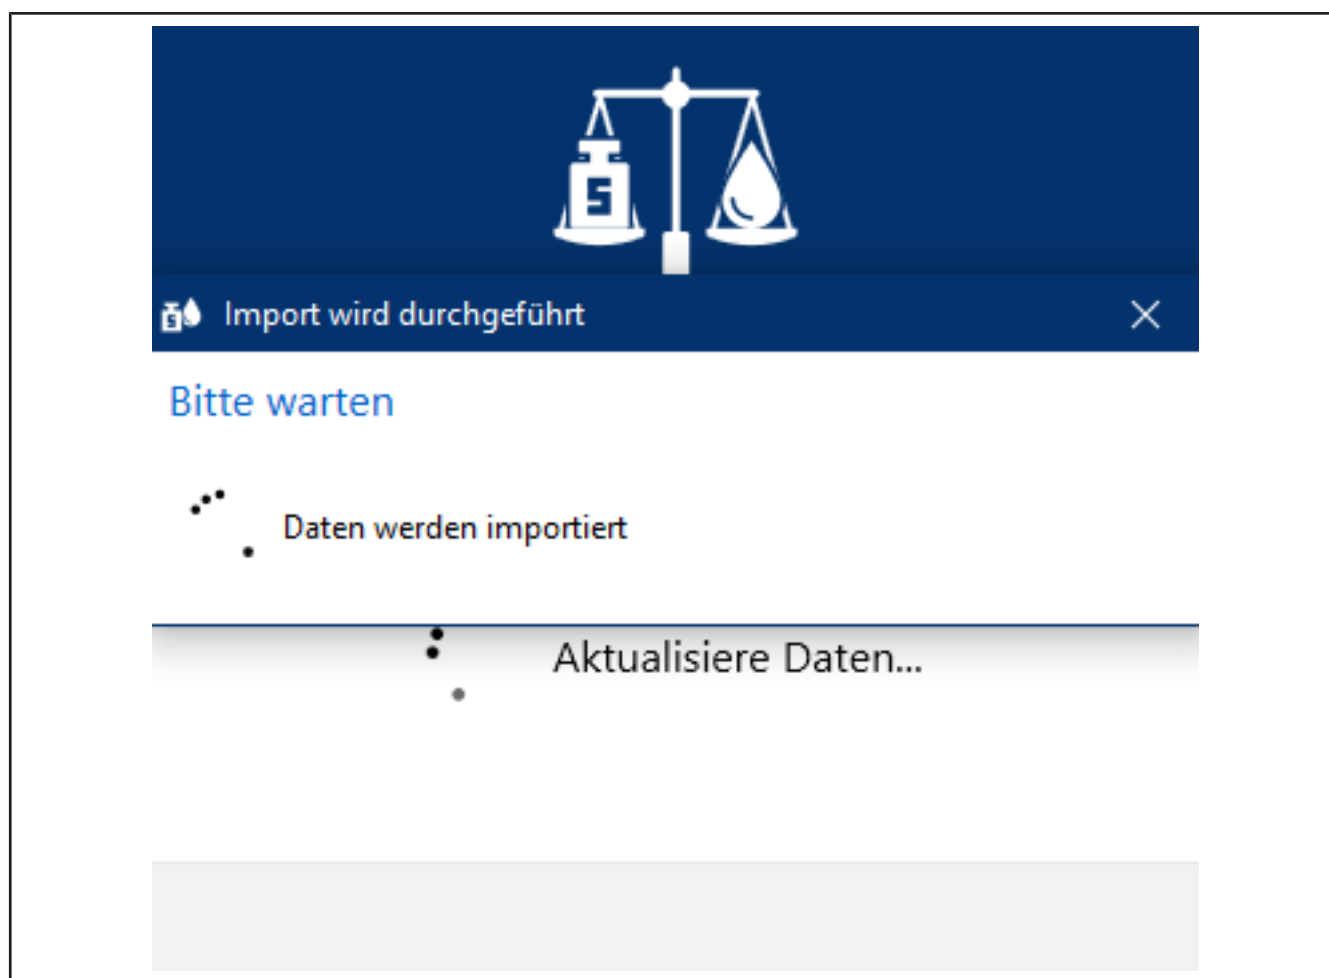

- s. Die neuen Daten werden importiert und der Fortschritt angezeigt.




- ➔ Nach einiger Zeit erscheint eine Benachrichtigung, dass das Update abgeschlossen ist.

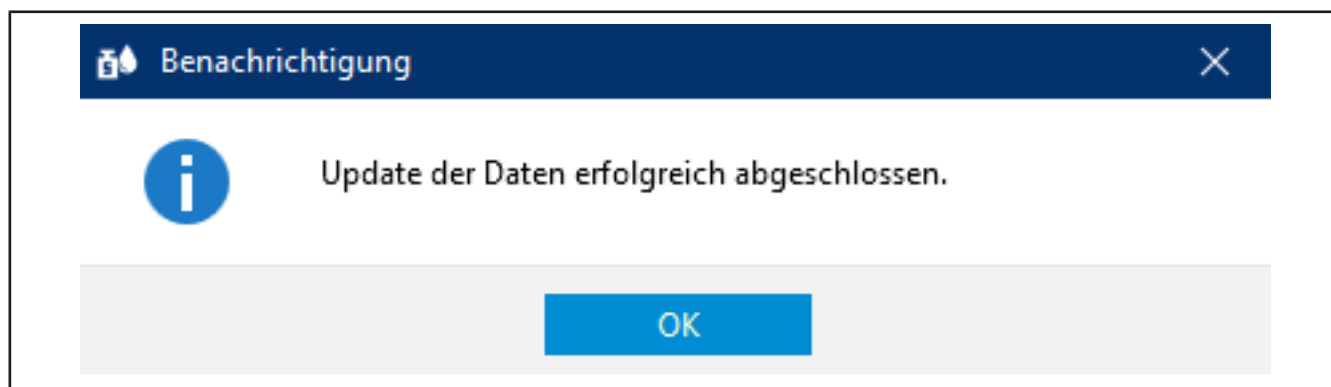

- t. Quittieren Sie diese mit Klick auf OK.

- ➔ EASYCAL™ 5 wird gestartet. Es erscheinen verschiedene Meldungen, um den Fortschritt anzuzeigen.

- ➔ Es erscheint eine Warnung, dass Sie eine Demoversion verwenden. Lesen Sie die Hinweise durch.

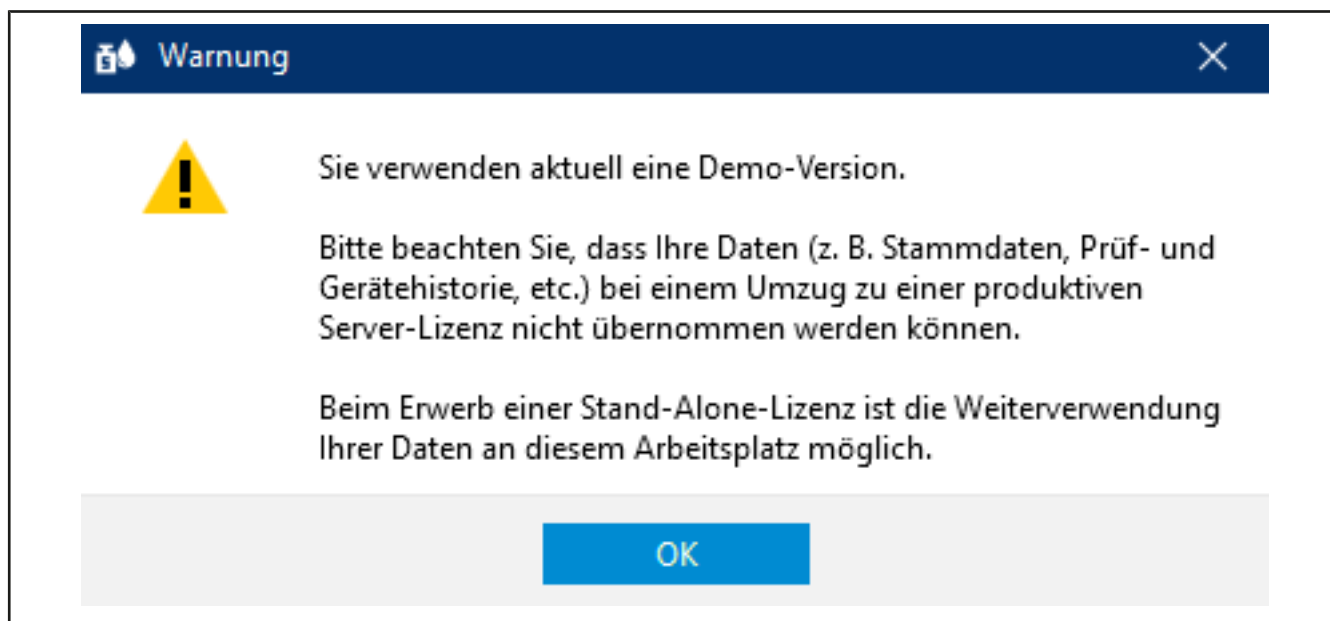

- u. Nach Quittieren der Warnung steht Ihnen EASYCAL™ 5 zum Testen bereit.
- Sie werden automatisch als „EASYCAL Admin“ angemeldet. Beachten Sie, dass EASYCAL™ 5 nach der Installation immer im Einzelbenutzermodus gestartet wird. Sie können dies später in den „Globalen Einstellungen“ ändern, sollten dies zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht tun.

3 Erste Schritte in EASYCAL™ 5

3.1 Tutorial

Dieses Beispiel zeigt den Ablauf einer Prüfung – von der Anlage eines Auftrags, über die Prüfung bis hin zum Zertifikatsdruck. Der Abschnitt bezieht sich auf in der Demolizenz vorhandene Stammdaten und dient als ersten Einstieg in das Programm.

Anmeldung

Wird das Programm EASYCAL™ 5 gestartet, erscheint ein Anmeldedialog. Hier meldet sich der Benutzer mit Benutzernamen und Passwort an.

3.1.1 Waage als Prüfmittel einrichten

Um eine Waage als Prüfmittel einzurichten, gehen Sie wie folgt vor. Die Einrichtung erfolgt immer in der Reihenfolge Prüfmittel in den Stammdaten einrichten, Prüfmittel am Arbeitsplatz einrichten und Prüfmittel für die Aufträge auswählen.

Voraussetzung:

- ✓ Sie haben eine Waage am Arbeitsplatz angeschlossen.
 - ✓ Sie kennen die Verbindungsparameter der Waage.
 - ✓ Sie wissen, an welchem COM-Port die Waage am Arbeitsplatz angeschlossen ist.
- a. Waage benennen, siehe Verwaltung > Stammdatenpflege > Prüfmittel > Prüfmittel.
 - b. Ort für Prüfmittel einrichten (sofern nicht bereits geschehen).
 - c. Waage als Prüfmittel konfigurieren, siehe Prüfmittel-Gerätetyp. Dabei spezifizieren Sie sowohl die Funktion als auch die Verbindung der Waage zum Arbeitsplatz, siehe Messfunktion, Kommunikation.

Dieses Menü verlassen. In das Menü Einstellungen wechseln.

- d. Waage als Prüfmittel am Arbeitsplatz anmelden, siehe Einstellungen > Arbeitsplatz-Einstellungen > Prüfmittel.
- e. Waage und die Verbindung für den Arbeitsplatz auswählen. Darüber hinaus können Sie die Verbindung zur Waage testen.

Dieses Menü verlassen. In das Menü Aufträge und Kalibrierscheine wechseln.

- f. Sie können im Auftrag bei der Prüfmittelauswahl die angeschlossene Waage auswählen. Im Tutorial siehe Prüfmittel festlegen, S. 19, in der Gebrauchsanleitung unter Prüfmittel für die Prüfung auswählen.

3.1.2 Auftrag anlegen

- a. Navigieren Sie vom Hauptmenü zu Aufträge und Kalibrierscheine.

Aufträge und Kalibrierscheine

Prüfartfilter keine Angabe
Suche
von bis

Auftragsübersicht
Kalibrierscheine

Auf	Prü	Auftragsnumm	Artikel	Status
5	STD	2022-07-15-12-C	EC-704780 - Transferpette® S (bis 2019) Variabel 100 - 1000 µl	Erstellt
4	STD	2022-07-15-12-C	EC-704106 - Transferpette® Fix 5 µl	Erstellt

Zurück
Einzelgeräteprüfung
Auftrag erstellen
Öffnen

b. Klicken Sie auf Auftrag erstellen.

Auftragsart auswählen

Chargenprüfung

Verwendung beim Prüfen von Stichproben (beliebiger Größe).
Es werden Chargenzertifikate ausgestellt.

Einzelprüfung

Verwendung bei 100%-Prüfung oder Prüfung eines einzelnen Gerätes.
Jedes Gerät erhält ein eigenes Zertifikat.

Zurück

c. Klicken Sie auf Einzelprüfung.

d. Wählen Sie bei Prüfart den Wert STD – Normwerte.

Prüfarten organisieren Ihre Prüfverfahren. Sie können keine zusätzlichen Prüfarten anlegen, sondern müssen aus den bereits hinterlegten Prüfarten wählen. An die Prüfart sind die Prüfpläne geknüpft sowie die Zertifikatsvorlagen. In der Benutzerverwaltung muss dem Anwender die jeweilige Berechtigung für die entsprechende Prüfart gegeben werden. Da Sie momentan als Global-Admin angemeldet sind, haben Sie Zugriff auf alle Daten.

Einzelprüfung - Auftrag erstellen

Prüfart: **STD - Normwerte** | Geräteanzahl: **1** | Kunde:

Auftragsnummer: | Bestell-Nr.:

Artikelcode: | AB-Nummer:

Artikel:

☐ Vor- und Nachprüfung erforderlich

Hinweise zum Auftrag:

Endkunde:

Volumenbereiche:

Prüfplan:

Zurück | Prüfung starten

- e. Klicken Sie auf die Schaltfläche bei Artikel-Code, um bereits angelegten Artikel anzuzeigen.

Einzelprüfung - Auftrag erstellen

Prüfart: **STD - Normwerte** | Geräteanzahl: **1** | Kunde:

Auftragsnummer: | Bestell-Nr.:

Artikelcode: | AB-Nummer:

Artikel:

☐ Vor- und Nachprüfung erforderlich

Hinweise zum Auftrag:

Endkunde:

Volumenbereiche:

Prüfplan:

Zurück | Prüfung starten

Artikel auswählen

Suche:

Artikelcode	Ver	Hersteller	Produkt	Produktvariation	Volumen	Status
EC-10002	0	BRAND GMBH + CO KG	Bürette	SILBERBRAND, ohne Hahn, Klasse B, Economy	0,1 - 25 ml	Freigegeben
EC-10004	0	BRAND GMBH + CO KG	Bürette	SILBERBRAND, ohne Hahn, Klasse B, Economy	0,1 - 50 ml	Freigegeben
EC-10012	0	BRAND GMBH + CO KG	Kompakt-Bürette	SILBERBRAND, Klasse B, Economy	0,1 - 25 ml	Freigegeben
EC-10014	0	BRAND GMBH + CO KG	Kompakt-Bürette	SILBERBRAND, Klasse B, Economy	0,1 - 50 ml	Freigegeben
EC-100210	0	Eppendorf AG	Research® plus	Fix	10 µl	Freigegeben
EC-100211	0	Eppendorf AG	Research® plus	Fix	20 µl	Freigegeben
EC-100212	0	Eppendorf AG	Research® plus	Fix	10 µl	Freigegeben
EC-100213	0	Eppendorf AG	Research® plus	Fix	20 µl	Freigegeben
EC-100214	0	Eppendorf AG	Research® plus	Fix	25 µl	Freigegeben
EC-100215	0	Eppendorf AG	Research® plus	Fix	50 µl	Freigegeben
EC-100216	0	Eppendorf AG	Research® plus	Fix	100 µl	Freigegeben
EC-100217	0	Eppendorf AG	Research® plus	Fix	200 µl	Freigegeben
EC-100218	0	Eppendorf AG	Research® plus	Fix	200 µl	Freigegeben
EC-100219	0	Eppendorf AG	Research® plus	Fix	250 µl	Freigegeben
EC-100220	0	Eppendorf AG	Research® plus	Fix	500 µl	Freigegeben
EC-100221	0	Eppendorf AG	Research® plus	Fix	1000 µl	Freigegeben
EC-100310	0	Eppendorf AG	Research® plus	Variabel	0,1 - 2,5 µl	Freigegeben
EC-100311	0	Eppendorf AG	Research® plus	Variabel	0,5 - 10 µl	Freigegeben
EC-100312	0	Eppendorf AG	Research® plus	Variabel	2 - 20 µl	Freigegeben

- f. Geben Sie im Suchfeld **Transferpette S 1000** ein. Während Sie tippen, sehen Sie wie sich die Artikelauswahl verändert. Dieses Verhalten ist in allen Suchfeldern von EASYCAL™ 5 gleich. Wir empfehlen immer erst die Suchfunktion zu nutzen, da EASYCAL™ 5 mit einer umfangreichen Stammdatenbank ausgeliefert wird.

Das Präfix EC- weist darauf hin, dass es sich um einen vorgefertigten und unveränderlichen Datensatz handelt. Möchten Sie diese Datensätze ändern, kopieren Sie den Datensatz und bearbeiten und speichern Sie diesen unter anderem Namen. Für weitere Informationen siehe Hilfe in EASYCAL™ 5.

Einzelprüfung - Auftrag erstellen

Prüfart: STD - Normwerte | Geräteanzahl: 1 | Kunde: []

Auftragsnummer: [] | Bestell-Nr.: []

Artikelcode: [] | AB-Nummer: []

Artikel: []

Volumenbereiche: []

Prüfplan: []

Zurück

Artikel auswählen

Suche: Transferpette S |

Artikelcode	Vei	Hersteller	Produkt	Produktvariation	Volumenbereich	Status
700768	2	Treff AG	TreffLab-Transferpette®	Variabel	0,1 - 1 µl	Freigegeben
700769	2	Treff AG	TreffLab-Transferpette®	Variabel	0,1 - 2,5 µl	Freigegeben
700770	2	Treff AG	TreffLab-Transferpette®	Variabel	0,5 - 10 µl	Freigegeben
700774	2	Treff AG	TreffLab-Transferpette®	Variabel	10 - 100 µl	Freigegeben
700780	2	Treff AG	TreffLab-Transferpette®	Variabel	100 - 1000 µl	Freigegeben
700784	2	Treff AG	TreffLab-Transferpette®	Variabel	1000 - 1000 µl	Freigegeben
700800	2	Treff AG	TreffLab-Transferpette®	-8	0,5 - 10 µl	Freigegeben
700808	2	Treff AG	TreffLab-Transferpette®	-8	10 - 100 µl	Freigegeben
700810	2	Treff AG	TreffLab-Transferpette®	-8	20 - 200 µl	Freigegeben
700812	2	Treff AG	TreffLab-Transferpette®	-8	30 - 300 µl	Freigegeben
700820	2	Treff AG	TreffLab-Transferpette®	-12	0,5 - 10 µl	Freigegeben
700826	2	Treff AG	TreffLab-Transferpette®	-12	5 - 50 µl	Freigegeben
700828	2	Treff AG	TreffLab-Transferpette®	-12	10 - 100 µl	Freigegeben
700830	2	Treff AG	TreffLab-Transferpette®	-12	20 - 200 µl	Freigegeben
700832	2	Treff AG	TreffLab-Transferpette®	-12	30 - 300 µl	Freigegeben
700963	0	BRAND GMBH + CO KG	Transferpette® α	100 µl, 1-Stop	100 µl	Freigegeben
700965	0	BRAND GMBH + CO KG	Transferpette® α	1.0 ml, 1-Stop	1000 µl	Freigegeben

- g. Wählen Sie den Artikelcode EC-704780. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Doppelklick.
- h. Wählen Sie bei Prüfplan den entsprechenden Prüfplan aus. In der Regel finden Sie hier 1 – 2 Einträge.
- i. Im Prüfplan sind die Rahmenbedingungen für die Prüfung sowie die Fehlergrenzen des zugeordneten Artikels hinterlegt.

Einzelprüfung - Auftrag erstellen

Prüfart: STD - Normwerte | Geräteanzahl: 1 | Kunde: []

Auftragsnummer: [] | Bestell-Nr.: []

Artikelcode: 704780 | AB-Nummer: []

Artikel: **Transferpette® S**
Variabel
BRAND GMBH + CO KG

Volumenbereiche: 1000µl (95 - 1000) []

Prüfplan: 4437.0 - EC-STD-ISO-PiPip-var-LHDiv []

Hinweise zum Auftrag: []

Endkunde: []

Zurück | Prüfung starten

- j. Klicken Sie auf Prüfung starten.


Es erscheint eine Benachrichtigung, dass keine Auftragsnummer vergeben wurde.

Bestehen in Ihrer Firma /Qualitätsmanagementprozess Vorgaben zur Organisation von Prüfungen, wäh-


len Sie Nein und vergeben eine Auftragsnummer.

Bestehen keine Vorgaben zur Organisation von Prüfungen, wählen Sie Ja und EASYCAL™ 5 vergibt eine eindeutige Auftragsnummer.

Wir empfehlen, sich frühzeitig für ein einheitliches Vorgehen zu entscheiden.

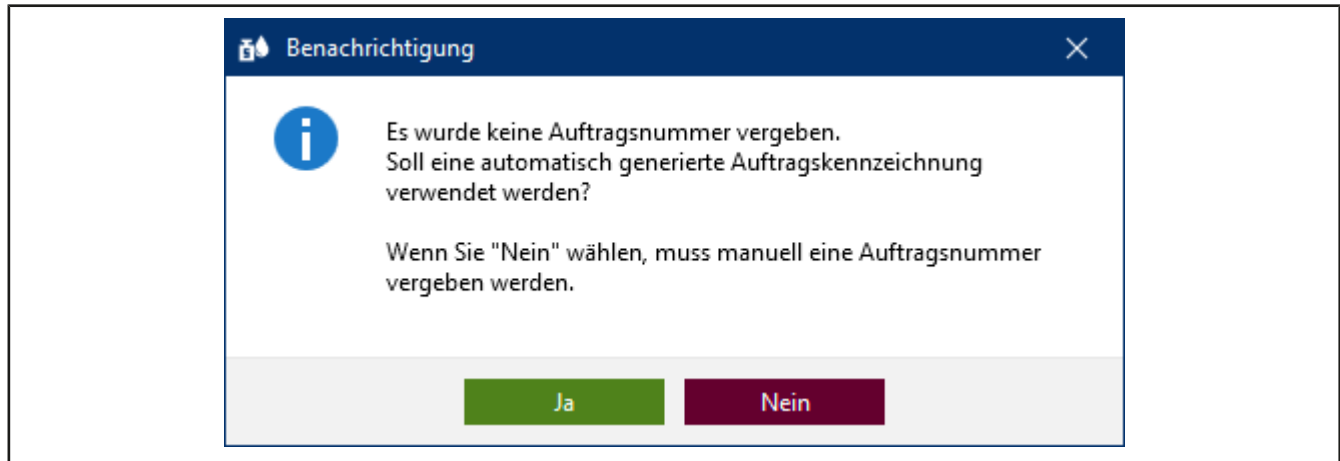

- k.** Fahren Sie das Tutorial mit einem Klick auf Ja fort. Die Auftragsnummer wird auf Basis des aktuellen Zeitstempels angelegt.

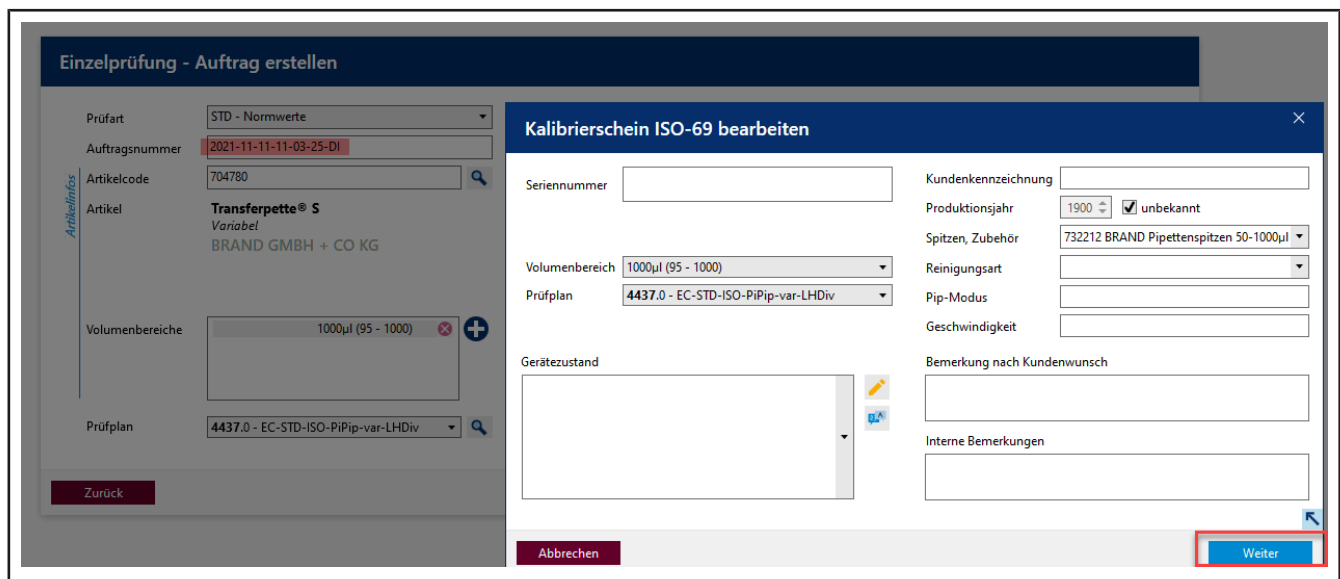

- l.** Sie können eine Seriennummer für die Identifizierung des Gerätes eingeben. Dies ist notwendig bei echten Prüfungen. Für das Tutorial ist es aber nicht nötig.

- m.** Klicken Sie auf Weiter. Der Prüfauftrag ist angelegt.

Es öffnet sich das Fenster für den Start der eigentlichen Prüfung.

3.1.3 Prüfmittel festlegen

BRAND - EASYCAL™ 5

2021-11-11-11-03-25-DI / ISO-69 - - 704780 BRAND GMBH + CO KG Transferpette® S Variabel 95 - 1000µl

Prüfmittel 2. TV 1. TV NV

Temperatur der Luft Thermometer 351000-71

Temperatur des Mediums Thermometer 351000-71

Rel. Luftfeuchte Hygrometer 600029-10

Luftdruck Barometer 600029-10

Wägewert Waage Einkanal Jetzt kalibrieren 300400-20

Wägewert Waage Linkanal Jetzt kalibrieren 300400-20

Wägewert Waage Einkanal Jetzt kalibrieren 300300-20

Zurück Vorheriges Gerät Vorheriges Merkmal Nächstes Merkmal Zusätzliches Gerät Geräteauswertung Prüfung abschließen Druckvorschau

Daniel Hög Letzter Status: Kalibrierschein "13001" wurde aktualisiert Verbunden mit: BCAQ03T v 5.0.14.213

Voraussetzung:

- ✓ Der Auftrag ist angelegt.
- a. Bei den Prüfmitteln sind die nötigen Parameter sowie die Prüfmittelart und das Prüfmittel (Prüfmittelnummer) vorgewählt. Da nur ein Prüfmittel angelegt ist, belassen wir es bei dieser Auswahl.

3.1.4 Prüfung durchführen

- a. Fahren Sie mit Klick auf Nächstes Merkmal fort.

Sie sehen die zentrale Eingabemaske der Messfunktionalität von EASYCAL™ 5.

BRAND - EASYCAL™ 5

2021-11-11-11-03-25-DI / ISO-69 - - 704780 BRAND GMBH + CO KG Transferpette® S Variabel 95 - 1000µl

Umgebungsdaten

Prüfmittel 2. TV 1. TV NV

✓/✗ A/B/C µl Messreihe 1

Nummer Zeitpunkt Messwert Volumen [µl] Sta

Graph der Messwerte

Statistik Gerät

Statistik Auftrag

Zurück Vorheriges Gerät Vorheriges Merkmal Nächstes Merkmal Zusätzliches Gerät

Geräteauswertung Prüfung abschließen Druckvorschau

- b. Geben Sie bei Neue Messung fiktive Wägewerte ein. Starten Sie mit 0,1 und klicken Sie auf „Messwert übernehmen“. Es erscheint ein Fenster, in dem Sie die Messwerte eingeben oder vervollständigen müssen.

Die Wahl des Trennzeichens (Komma oder Punkt) erfolgt über die Sprachwahl in der Software.

Messwerte eingeben

Temperaturdifferenz 0,5 °C

Wägewert 0,1 g

Temperatur der Luft 0 °C (20°C - 25°C)

Temperatur des Medium 0 °C (20°C - 25°C)

Rel. Luftfeuchte 0 %rh (40%rh - 60%rh)

Luftdruck 0 mbar (960mbar - 1025mbar)

Manuell

Manuell

Manuell

Manuell

Manuell

Abbrechen Übernehmen

- c. Geben Sie fiktive Werte für die Umgebungsparameter wie folgt ein:

Messwerte eingeben

Temperaturdifferenz	0,00 °C		0,5 °C		
Wägewert	0,1	g			☒ Manuell
Temperatur der Luft	21	°C	(20°C - 25°C)		☒ Manuell
Temperatur des Mediums	21	°C	(20°C - 25°C)		☒ Manuell
Rel. Luftfeuchte	40	%rh	(40%rh - 65%rh)		☒ Manuell
Luftdruck	960	mbar	(960mbar - 1025mbar)		☒ Manuell

Abbrechen
Übernehmen

- d. Klicken Sie auf Übernehmen. Hiermit ist die erste Messung abgeschlossen. Der Messwert und das daraus berechnete Volumen erscheinen in der Tabelle.

Prüfmittel > 2. TV > 1. TV > NV ✓ / ✗ A / B / C µl % Messreihe 1				
Nummer	Zeitpunkt	Messwert	Volumen [µl]	Sta
1	11.11.2021 13:55:59	0,10000 g	100,3	✓

- e. Geben Sie nun auf gleiche Weise 8 Mal den Wert 0,1 g als Messwert ein. Die Tabelle füllt sich.

BRAND EASYCAL™ 5
i

2021-11-11-11-03-25-DI / ISO-69 - - 704780 BRAND GMBH + CO KG Transferpette® S Variabel 95 - 1000µl

Umgebungsdaten

21 °C 21 °C 40 %rh 960 mbar

☒ Umgebungsdaten anfordern

Soll-Wert
100 µl

Anzahl
9 / 10

Letzte Messungen:

0,1 g

1003,01106966 µl / g

100,3 µl

13:58:59

Neue Messung:

0,1 g

1003,01106966 µl / g

100,3 µl

Messwert übernehmen

Nummer	Zeitpunkt	Messwert	Volumen [µl]	Sta
2	11.11.2021 13:57:59	0,10000 g	100,3	✓
3	11.11.2021 13:58:05	0,10000 g	100,3	✓
4	11.11.2021 13:58:10	0,10000 g	100,3	✓
5	11.11.2021 13:58:15	0,10000 g	100,3	✓
6	11.11.2021 13:58:19	0,10000 g	100,3	✓
7	11.11.2021 13:58:23	0,10000 g	100,3	✓
8	11.11.2021 13:58:28	0,10000 g	100,3	✓
9	11.11.2021 13:58:34	0,10000 g	100,3	✓

Graph der Messwerte

Statistik Gerät

100,3 ± 0

Statistik Auftrag

Richtigkeit: 0 % / 8 % ✓

Variationskoeffizient: 0 % / 3 % ✓

Mittelwert: 100,3 µl

Standardabweichung: 0 µl

Erweiterte Messunsicherheit: 0 µl

Richtigkeit: 0 %

Mittelwert: 100,3 µl

Standardabweichung der Mittelwerte: 0 µl

Variationskoeffizient der Richtigkeiten: 0 %

Mittelwert VK: 0 %

CPK: 0

- f. Die hellblaue Farbe im Bereich über der Tabelle zeigt, dass der Auftrag bearbeitet wird. Klicken Sie auf das Icon i um die erweiterten Zertifikatsinformationen ein- und wieder auszublenden.
- g. Geben Sie nochmals 0,1 als Messwert ein und achten Sie auf die Verlaufsanzeige über der Messwerttabelle.

BRAND - EASYCAL™ 5

2021-11-11-11-03-25-DI / ISO-69 - - 704780 BRAND GMBH + CO KG Transferpette® S Variabel 95 - 1000µl

Umgebungsdaten

21 °C 21 °C 40 %rH 960 mbar

☒ Umgebungsdaten anfordern

Soll-Wert
100 µl

Anzahl
9 / 10

Letzte Messungen:

0,1
1003,01106966
100,3
13:58:59

Neue Messung:

0,1
1003,01106966
100,3

Messwert übernehmen

Prüfmittel nicht verbunden

☐ Schnelles Messen
☐ Automatisches Drucken
☒ Auto-Tara
☐ Alle Messwerte erlauben
☐ Messwerte vor dem Eintragen überprüfen

Eintrag verwerfen Verwerfen rückgängig machen

Prüfmittel 2. TV 1. TV NV

Nummer	Zeitpunkt
2	11.11.2021 13:57:59
3	11.11.2021 13:58:05
4	11.11.2021 13:58:10
5	11.11.2021 13:58:15
6	11.11.2021 13:58:19
7	11.11.2021 13:58:23
8	11.11.2021 13:58:28
9	11.11.2021 13:58:59


Graph der Messwerte

Statistik Gerät

100,3 ± 0

92 100 108

- h. Mit Eingabe des 10. Messwertes sind alle geforderten Messungen für das Merkmal 2. TV durchgeführt. Das Merkmal erhält einen grünen Haken. Sie können weitere Messwerte eingeben, dies wird aber nicht gefordert.

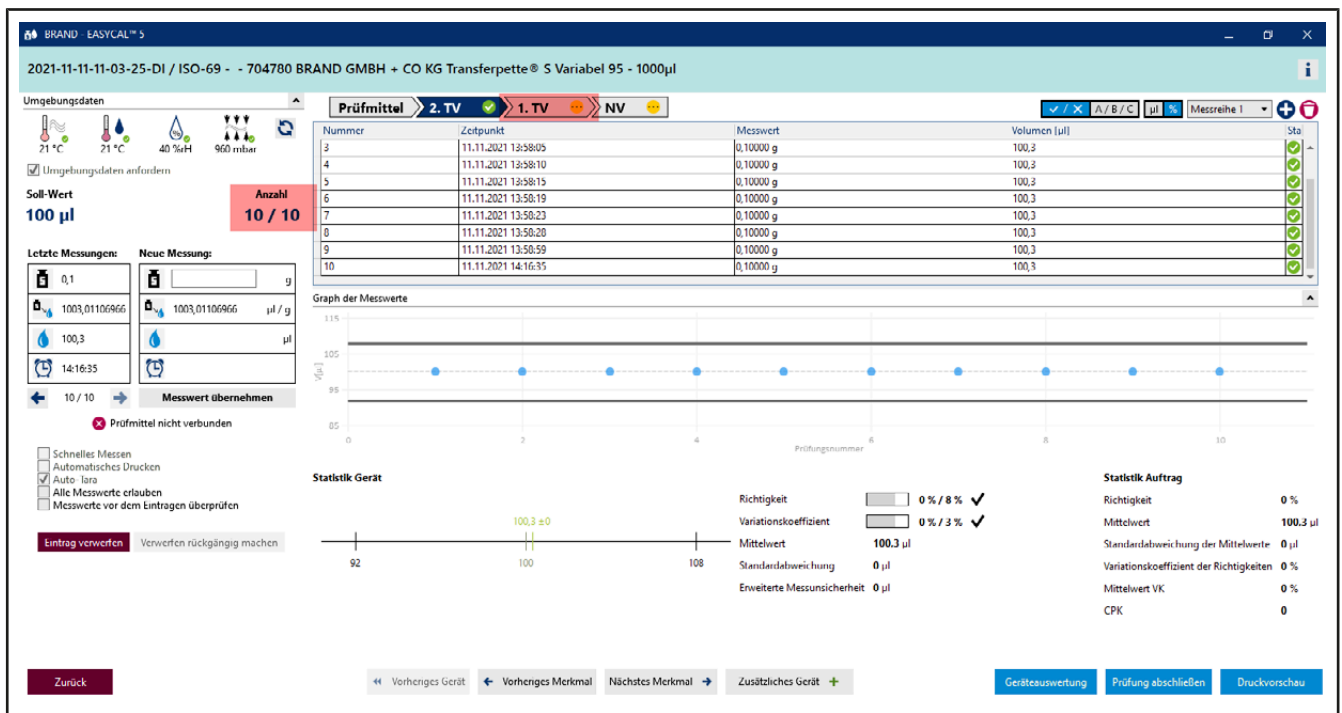

i. Klicken Sie in der Fortschrittsanzeige auf 1 . TV, um zum nächsten Merkmal zu springen.

j. Geben Sie bei Neue Messung nacheinander folgende Werte ein:


0,498

0,499


0,500

Wiederholen Sie dies 2 Mal.


➔ Sie sehen in der Anzeige Graph der Messwerte die Lage der einzelnen Messwerte in Bezug zu definierten Fehlergrenzen (durchgezogene Linien) und dem berechneten Mittelwert. Unter Statistik Gerät sehen Sie die berechneten Ist-Werte für Richtigkeit und Variationskoeffizient im Vergleich zu den definierten Grenzwerten.

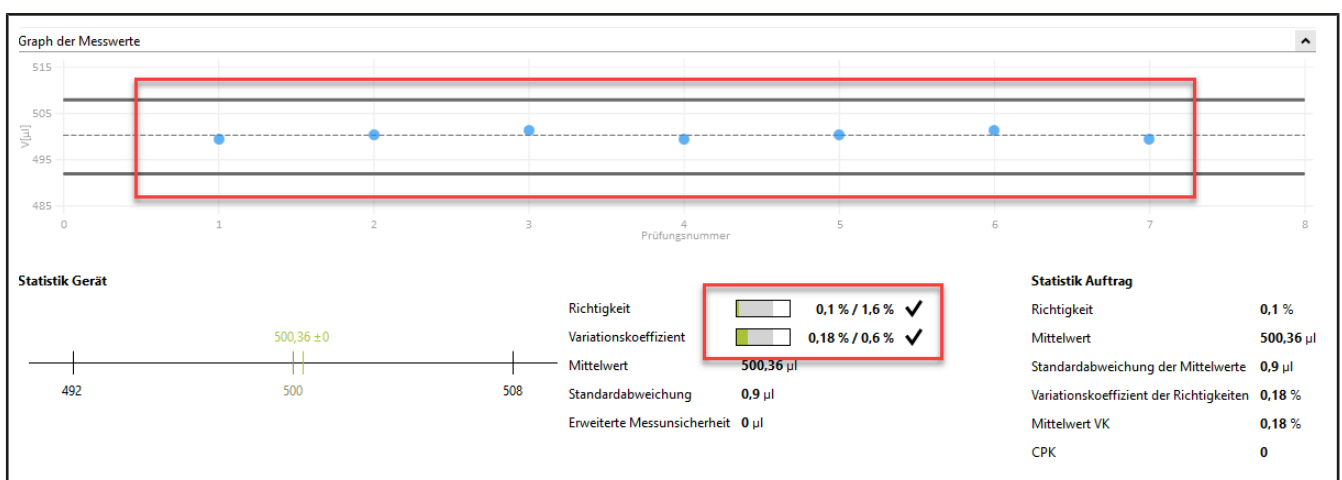

k. Geben Sie nochmals 0,498 als Messwert ein, bestätigen Sie die Umgebungsparameter und klicken Sie dann auf NV in der Fortschrittsanzeige. Dann geben Sie 1 als Messwert ein.

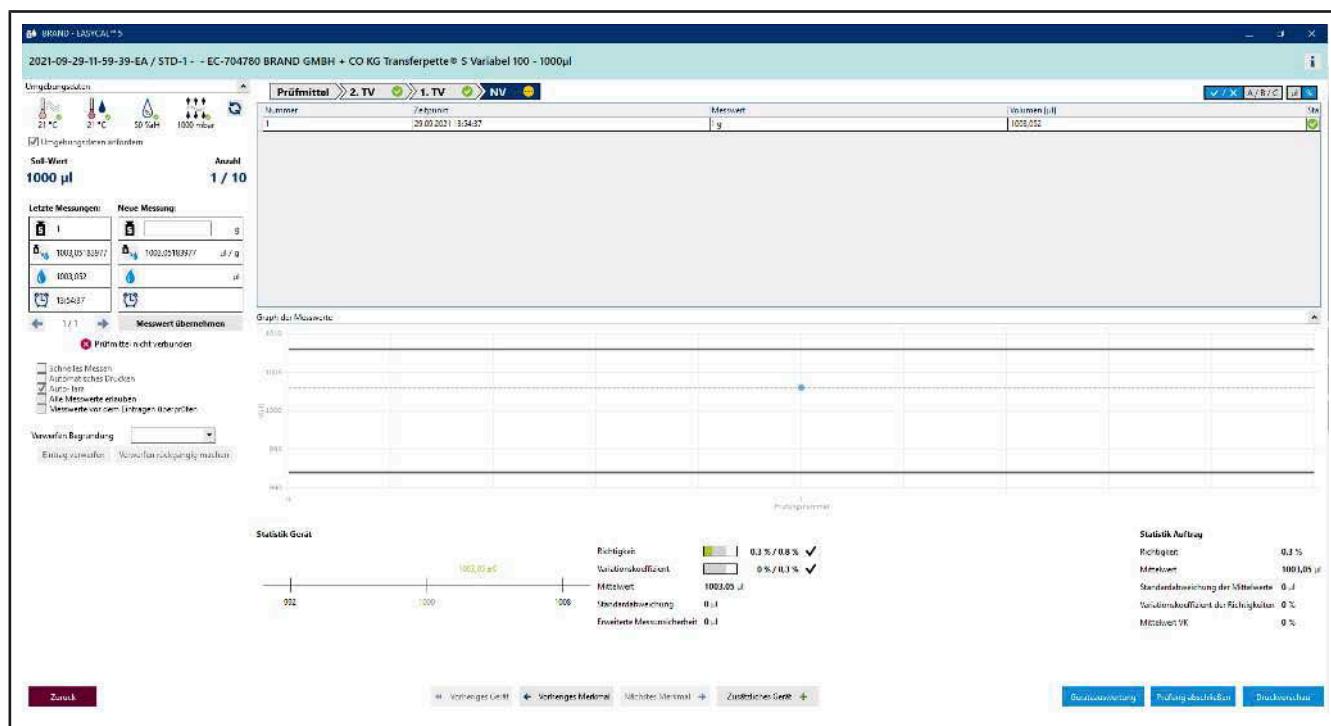


- l. Wir nehmen an, Sie haben sich vertippt. Geben Sie hierzu 1 , 1 als Messwert ein und bestätigen Sie die Umgebungsparameter. Es erscheint eine Warnung:

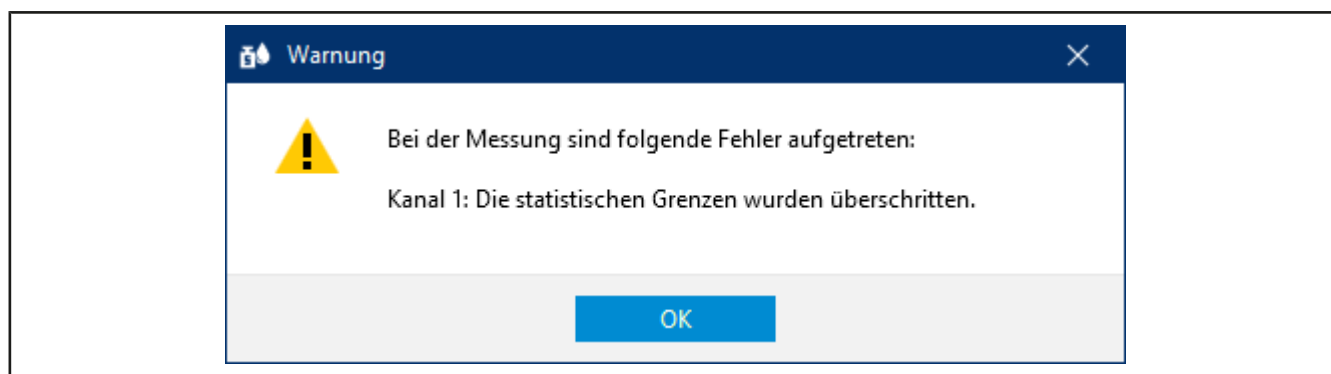

- m. Quittieren Sie diese Warnung mit Klick auf OK .

Sie sehen, dass die verschiedenen Bereiche der Eingabemaske entsprechend des neuen Messwertes reagieren. Löschen können Sie diesen Messwert nicht, aber Sie können ihn verwerfen. Der Wert bleibt sichtbar, wird aber nicht mehr für Statistik verwendet.

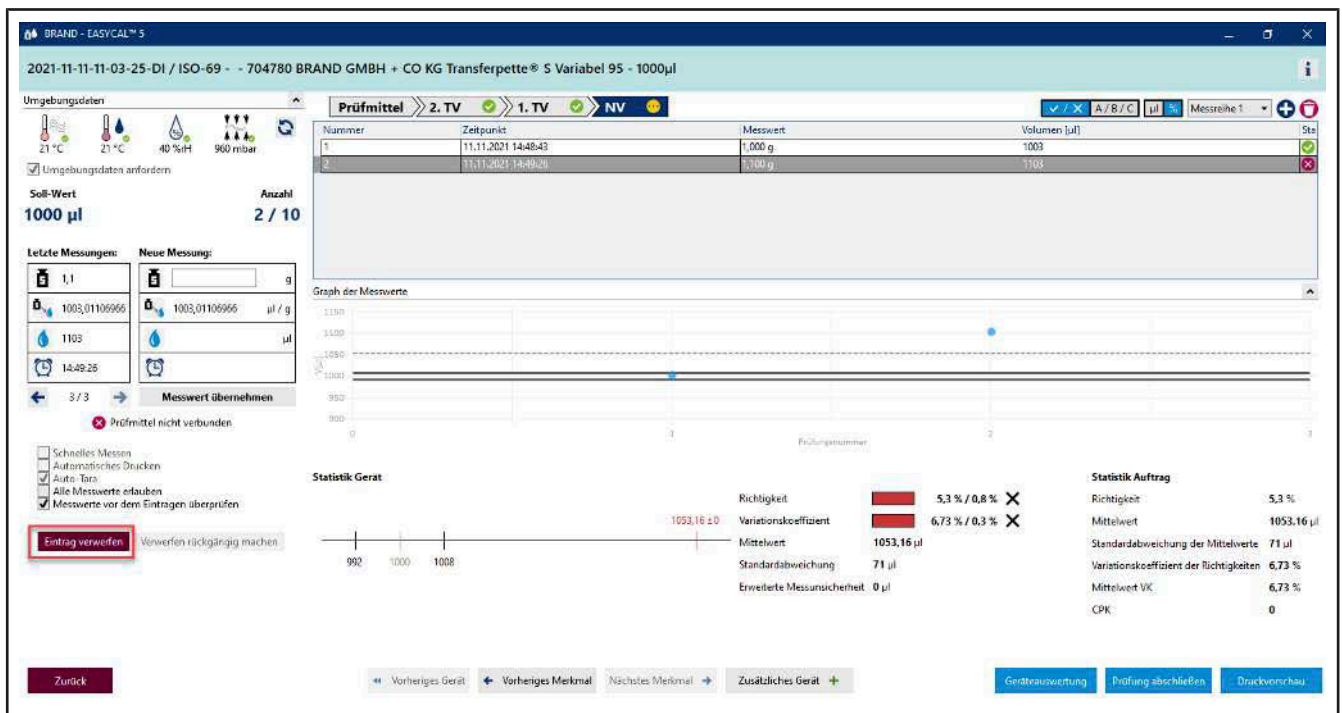

- n. Klicken Sie auf die Nummer der Messung in der Tabelle und anschließend klicken Sie auf Eintrag verwerfen.


Es erscheint ein Hinweis.

The screenshot shows a dialog box titled 'Messungen verwerfen' (Reject Measurements). The dialog box contains the following text:


Geben Sie einen Grund an, mit dem die ausgewählten Messungen verworfen werden sollen.

Below the text is a dropdown menu with the selected option 'Als Ausreißer identifiziert' (Identified as an outlier). At the bottom of the dialog box are two buttons: 'Abbrechen' (Cancel) and 'Weiter' (Next).

- o. Geben Sie einen Grund an, z. B. Als Ausreißer identifiziert. Alternativ können Sie aus dem Drop-Down-Menü eine Begründung auswählen. Diese Texte lassen sich in den Stammdaten nachpflegen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Klick auf Weiter.

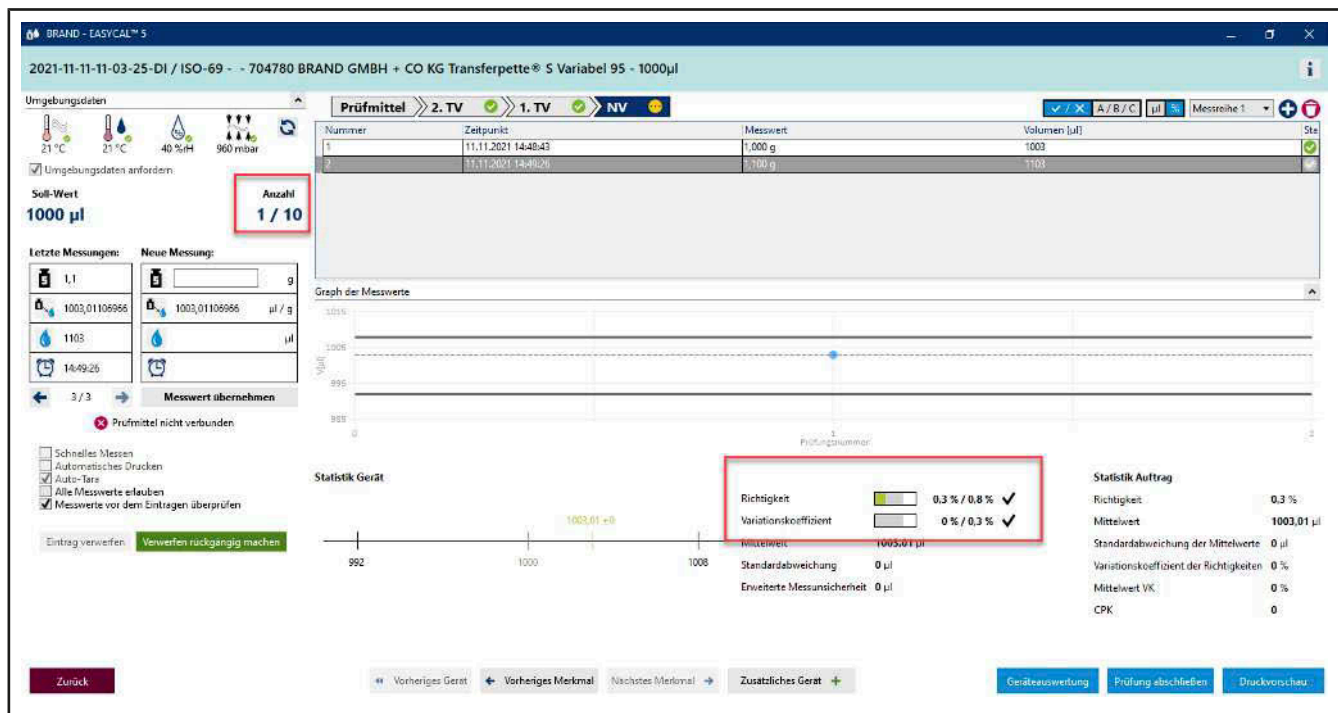


- p. Der Messwert 1, 1 wird in der Auswertung nicht weiter berücksichtigt.
- q. Fahren Sie mit der Eingabe von Messwerten fort bis bei Anzahl 10/10 steht. Mit Eingabe des letzten benötigten Messwertes ändert sich die Farbe im Bereich über der Tabelle von hellblau in Gelb. Das signalisiert Ihnen, dass der Auftrag abgeschlossen ist.

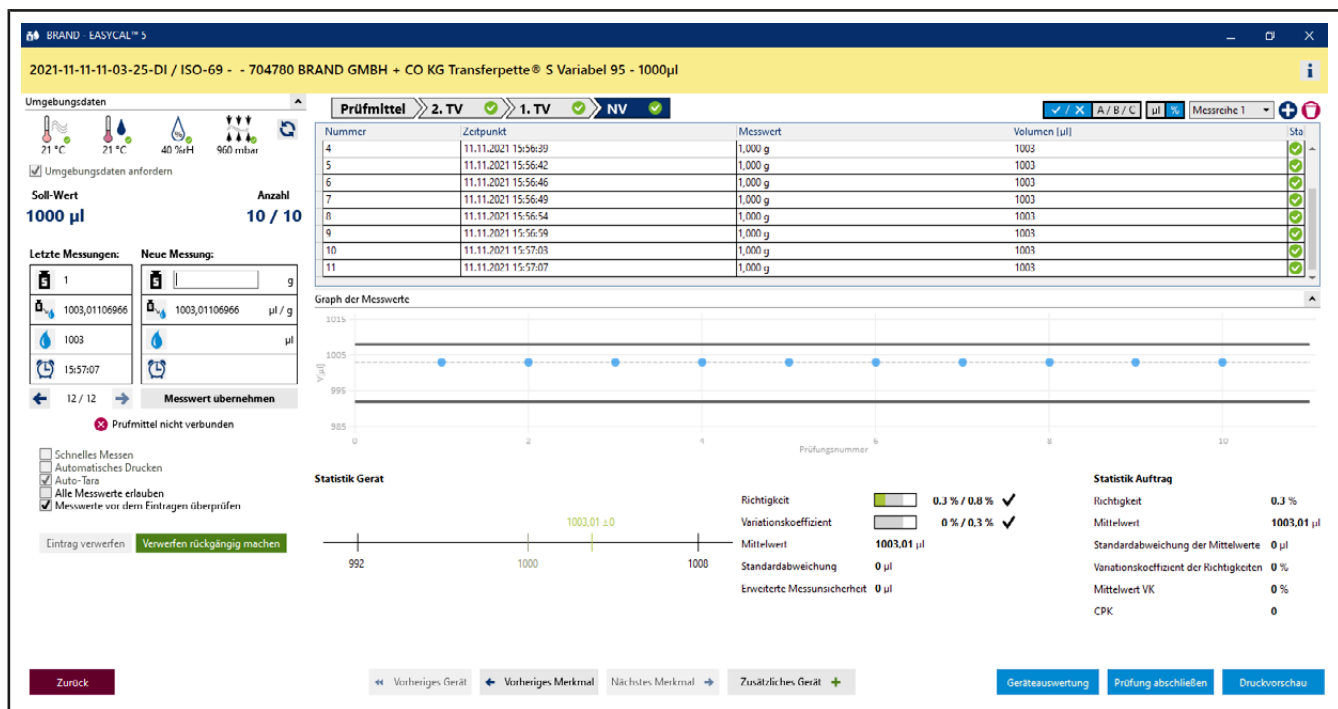


Weiterhin sind alle Merkmale in der Fortschrittsanzeige mit einem grünen Haken versehen. Der verworfene Messwert ist rosa hinterlegt.

3.1.5 Prüfung abschließen

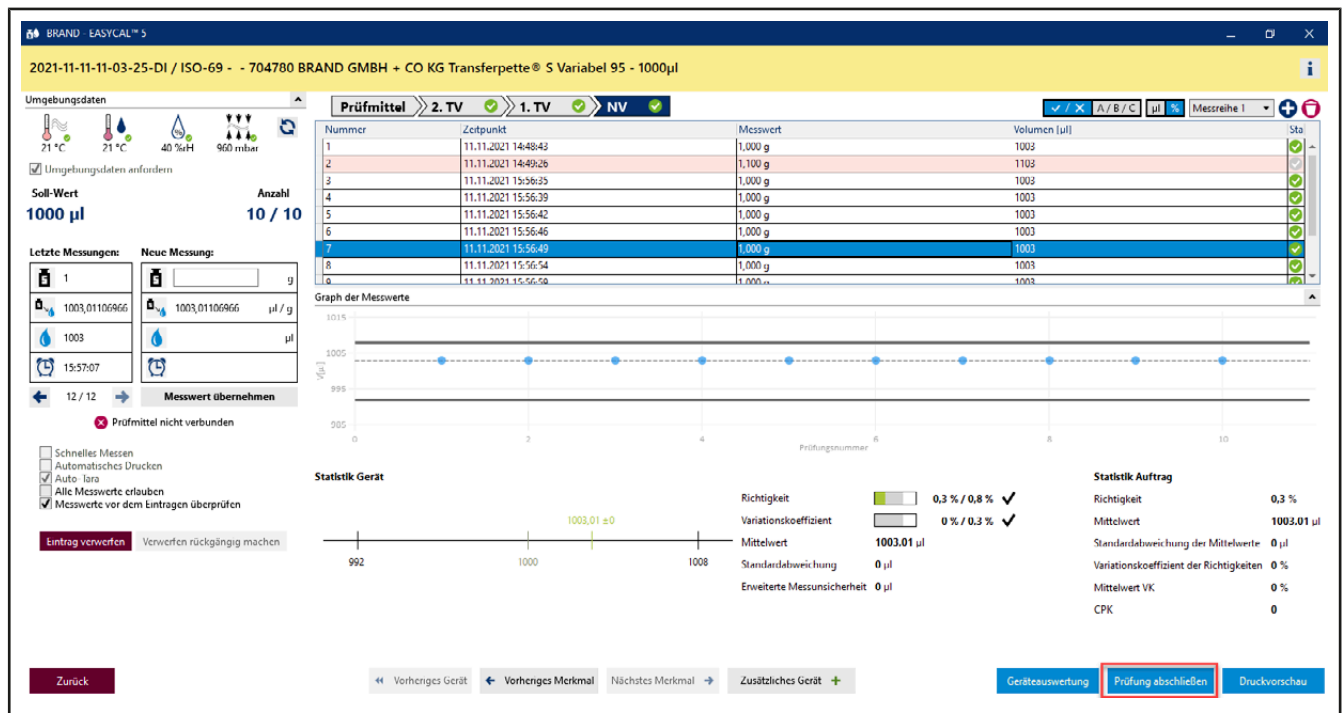

a. Klicken Sie auf Prüfung abschließen.

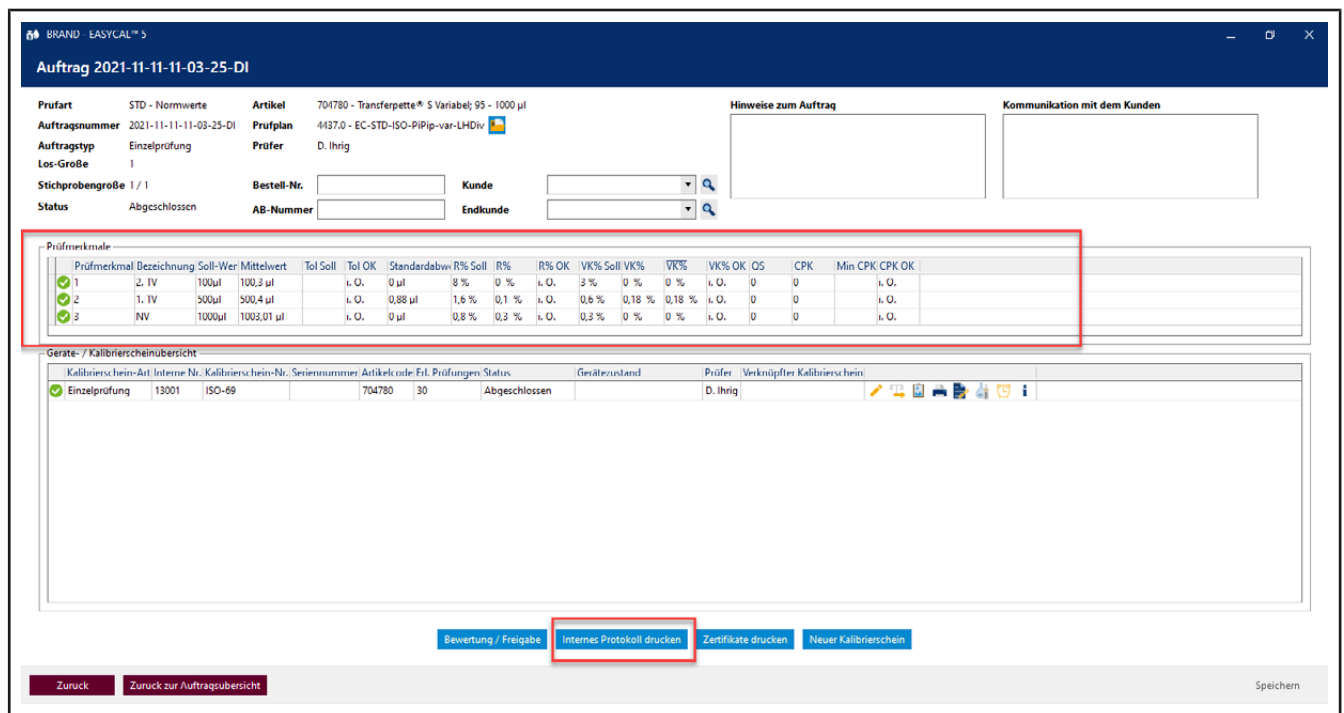

b. Sie sehen nun den Auftrag mit einer Zusammenfassung der Messungen bei den jeweiligen Prüfmerkmalen. Klicken Sie auf Internes Protokoll drucken.

BRAND - EASYCAL™ 5

Exportieren (2021-11-11-03-25-DI)

Inhalt

Kopfzeile

Inhalt

Ab Freitext Kopfzeile

Ab Freitext 1. Kopfdaten

Horizontale Linie

Ab Freitext 2. PA-Toleranzen

Horizontale Linie

Ab Freitext 3. PA-Status

Horizontale Linie

Ab Freitext 4. PA-Ergebnisse

Auftragsstatistik-Tabelle

Horizontale Linie

Ab Freitext 5. Geräte-Ergebnisse

Druckvorschau

EASYCAL - Ergebnisse Prüfauftrag

BRAND GMBH + CO KG Prüfer: Daniel Ihrig Datum: 2021-11-11

1. Kopfdaten: Charge: PA-Nr.: 2021-11-11-03-25-DI Losmenge: 1
 Prüfstoff: STD - Normwerte Artikel: 704/80 Transferpette® S Variabell 95 - 1000 µl

2. PA-Toleranzen: Fertigtoleranz [µl] : Richtigkeit [µl] : 8 Variationskoeffizient [µl] : 3,0
 CPK-Grenze: k-Wert: 0,00

3. PA-Status: **Abgeschlossen** verwendete Prüfmittel: Nr. 308400-05, Nr. 251000-71, Nr. 800029-10, Nr. 800013-05, Nr. 800100-03

4. PA-Ergebnisse:

Prüfmerkmal	n	Soll-Wert	MITTEL	STABW	R	VK	CPK	Q25-Zert
1	1	100 µl	100,30 µl	0,0 µl	0 %	0,0 %	0	0
2	1	500 µl	500,40 µl	0,88 µl	0,1 %	0,18 %	0	0
3	1	1000 µl	1003,01 µl	0,0 µl	0,3 %	0,00 %	0	0

5. Geräte-Ergebnisse: (mit Geräte-Toleranzen)

Geräte-Nr.	Prüfmerkmal	Soll-Wert	Soll-Richtigkeit	Soll-Variationskoeffizient	Mittelwert	Standardabweichung	Richtigkeit	Variationskoeffizient
1	100 µl	8 %	3,0 %	100,30 µl	0,0 µl	0 %	0,0 %	
2	500 µl	1,0 %	0,0 %	500,40 µl	0,88 µl	0,1 %	0,18 %	

Zoom: 100 %

Zurück Drucken Als PDF speichern Speichern und Drucken

Einstellungen

Verwendete Vorlagen

Gewähltes Master-Layout: DIN-A4-Hochkant-DIN-A5-Internes...

Gewählte Inhaltsstruktur: Internes Auftragsprotokoll

Exportsprachen

Primäre Sprache: Deutsch

Sekundäre Sprache: Englisch

Exportanmerkung

Tragen Sie eine Anmerkung ein:

Übernehmen

Elemente ausblenden

☒ Hintergrund ausblenden

☐ Primäre Konformitätsbewertung ausblenden

☐ Sekundäre Konformitätsbewertung ausblenden

c. Sie sehen den Zertifikatseditor im Ansichtsmodus. Hier können Sie das hinterlegte Protokoll ausdrucken oder exportieren.

d. Verlassen Sie den Zertifikatseditor mit Klick auf Zurück.

BRAND - EASYCAL™ 5

Auftrag 2021-11-11-03-25-DI

Prüfstoff: STD - Normwerte Artikel: 704/80 - Transferpette® S Variabell 95 - 1000 µl

Auftragsnummer: 2021-11-11-03-25-DI Prüfplan: 4437.0 - EC-STD-ISO-PIP-var-LHDIV

Auftragstyp: Einzelprüfung Prüfer: D. Ihrig

Los Größe: 1

Stichprobengröße: 1 / 1

Status: Abgeschlossen

Bestell Nr. Kunde: AB-Nummer Endkunde:

Hinweise zum Auftrag

Kommunikation mit dem Kunden

Prüfmerkmale

Prüfmerkmal	Bezeichnung	Soll-Wert	Mittelwert	Tol Soll	Tol OK	Standardabw	R% Soll	R% Ist	R% OK	VK% Soll	VK% Ist	VK% OK	OS	CPK	Min CPK	CPK OK
1	2. TV	100 µl	100,3 µl	i. O.	0 µl	8 %	0 %	i. O.	3 %	0 %	0 %	i. O.	0	0	i. O.	
2	1. TV	500 µl	500,4 µl	i. O.	0,88 µl	1,6 %	0,1 %	i. O.	0,6 %	0,18 %	0,18 %	i. O.	0	0	i. O.	
3	NV	1000 µl	1003,01 µl	i. O.	0 µl	0,8 %	0,3 %	i. O.	0,3 %	0 %	0 %	i. O.	0	0	i. O.	

Geräte / Kalibrierscheinübersicht

Kalibrierschein-Art	Interne Nr.	Kalibrierschein-Nr.	Seriennummer	Artikelcode	Erl. Prüfungen	Status	Gerätezustand	Prüfer	Verknüpfter Kalibrierschein
Einzelprüfung	13001	ISO 69		704/80	30	Abgeschlossen		D. Ihrig	

Bewertung / Freigabe Internes Protokoll drucken Zertifikate drucken Neuer Kalibrierschein

Zurück Zurück zur Auftragsübersicht Speichern

e. Klicken Sie auf Bewertung / Freigabe.

Bewertung / Freigabe
✕

Akt. Status Abgeschlossen

Neuer Status Freigegeben ▼

Bemerkungen

☒ **Für alle übernehmen**

Abbrechen
Speichern

f. Wählen Sie im sich öffnenden Fenster Freigegeben und quittieren Sie die Eingabe mit Speichern

BRAND EASYCAL™ 5
— □ ✕

Auftrag 2021-11-11-11-03-25-DI

Prüfart STD - Normwerte **Artikel** 704780 - Transferpette® S Variable; 95 - 1000 µl

Auftragsnummer 2021-11-11-11-03-25-DI **Prüfplan** 4437.0 - EC-STD-ISO-PI(p)-var-LHDIV

Auftragstyp Einzelprüfung **Prüfer** D. Ihrig

Los-Größe 1 **Bestell-Nr.** **Kunde**

Stichprobengröße 1 / 1 **AB-Nummer** **Endkunde**

Status Freigegeben

Hinweise zum Auftrag

Kommunikation mit dem Kunden

Prüfmerkmale

Prüfmerkmal	Bezeichnung	Soll-Wert	Mittelwert	Tol Soll	Tol OK	Standardabw	R% Soll	R% OK	R% OK	VK% Soll	VK% OK	VK% OK	VK% OK	OS	CPK	Min CPK	CPK OK
1	2. IV	100µl	100,3 µl		i. O.	0 µl	8 %	0 %	i. O.	3 %	0 %	0 %	i. O.	0	0		i. O.
2	1. IV	500µl	500,4 µl		i. O.	0,88 µl	1,6 %	0,1 %	i. O.	0,6 %	0,18 %	0,18 %	i. O.	0	0		i. O.
3	INV	1000µl	1003,01 µl		i. O.	0 µl	0,8 %	0,3 %	i. O.	0,3 %	0 %	0 %	i. O.	0	0		i. O.

Geräte- / Kalibrierscheinübersicht

Kalibrierschein-Art	Interne Nr.	Kalibrierschein-Nr.	Seriennummer	Artikelcode	Frü. Prüfungen	Status	Gerätezustand	Prüfer	Verknüpfter Kalibrierschein
Einzelprüfung	13001	ISO-69		704780	30	Freigegeben		D. Ihrig	


Bewertung / Freigabe
Internes Protokoll drucken
Zertifikate drucken
Neuer Kalibrierschein

Zurück
Zurück zur Auftragsübersicht
Speichern


g. Klicken Sie auf Zertifikate drucken .




h. Klicken Sie auf die Checkbox und dann auf Druckvorschau.

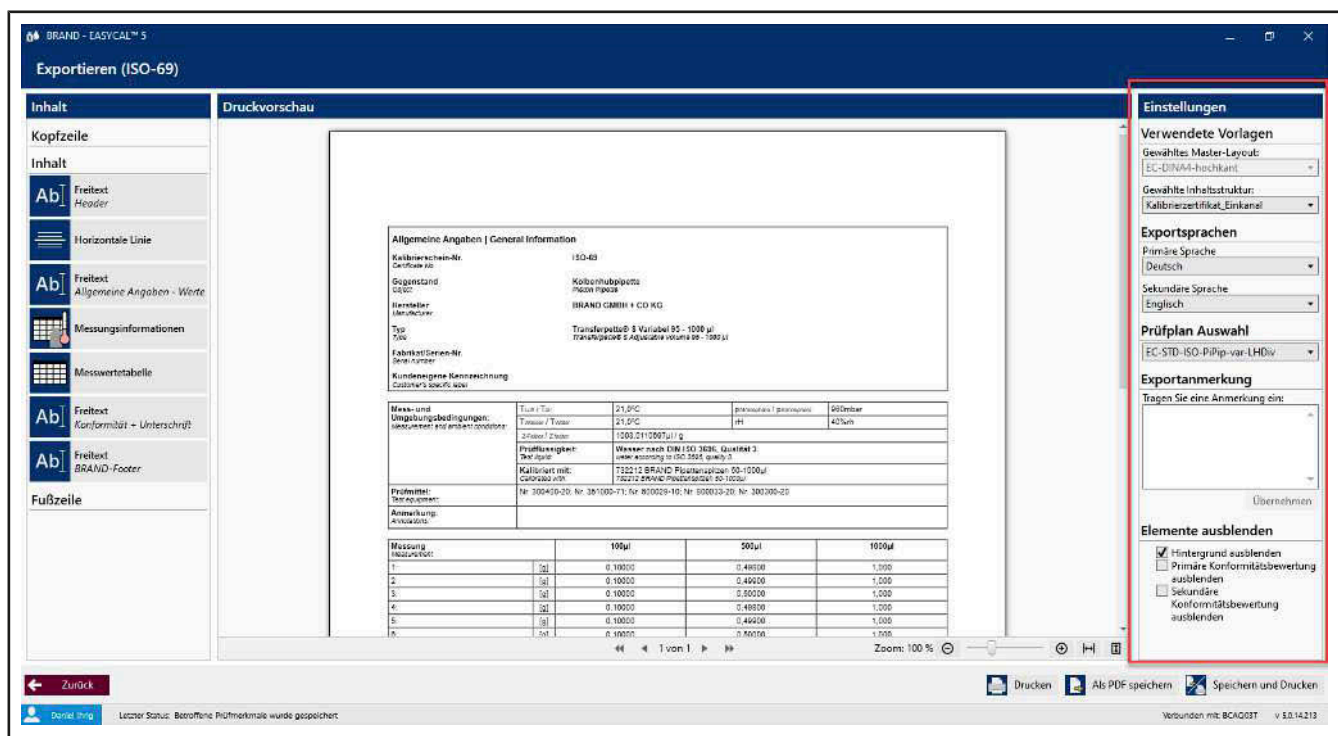


➔ Es öffnet sich der Zertifikatseditor im Modus Druckvorschau. Sie können im rechten Bereich noch Einstellungen vornehmen und je nach gewählter Inhaltsstruktur Exportanmerkungen eintragen.

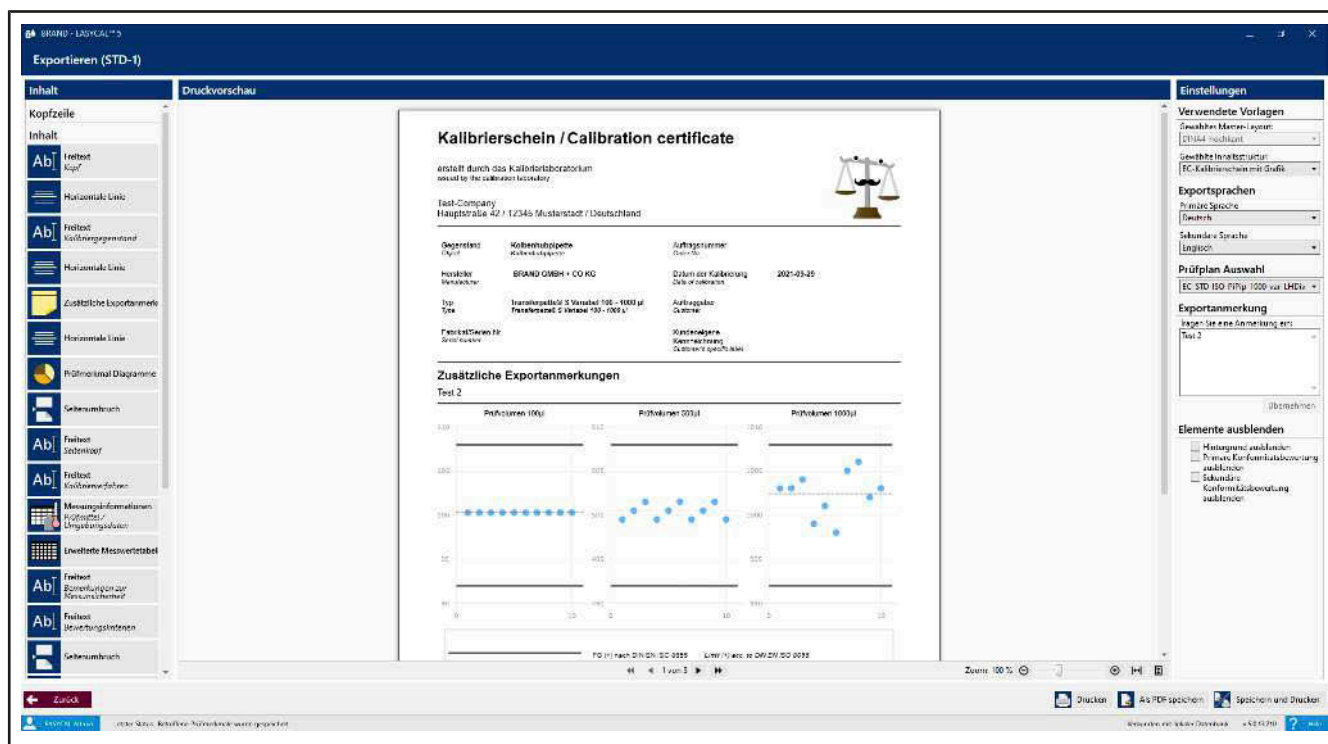

- i. Hier können Sie auch das Zertifikat als PDF exportieren oder auf Papier ausdrucken. Mit Zurück verlassen Sie die Druckvorschau.

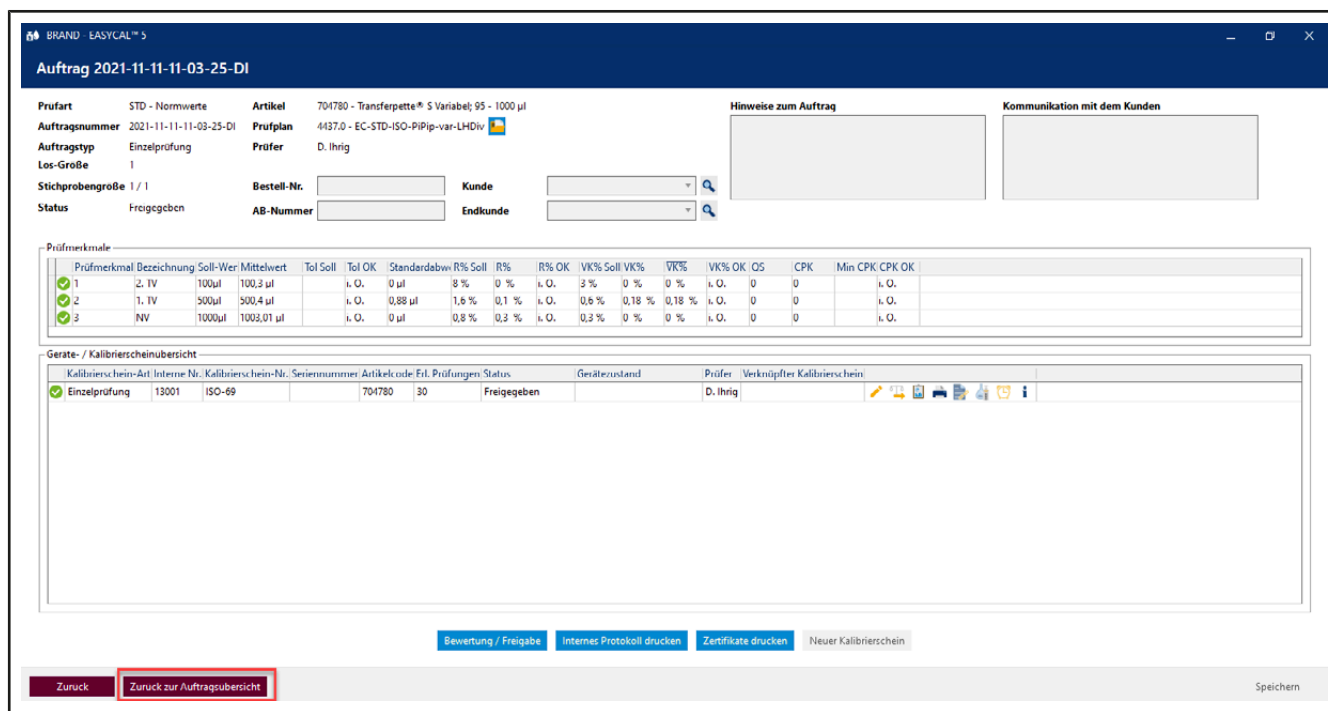

- j. Klicken Sie auf Zurück zur Auftragsübersicht
- k. Von hier aus können Sie weitere Aufträge anlegen und Prüfungen starten. Über Zurück kommen Sie ins Hauptmenü.

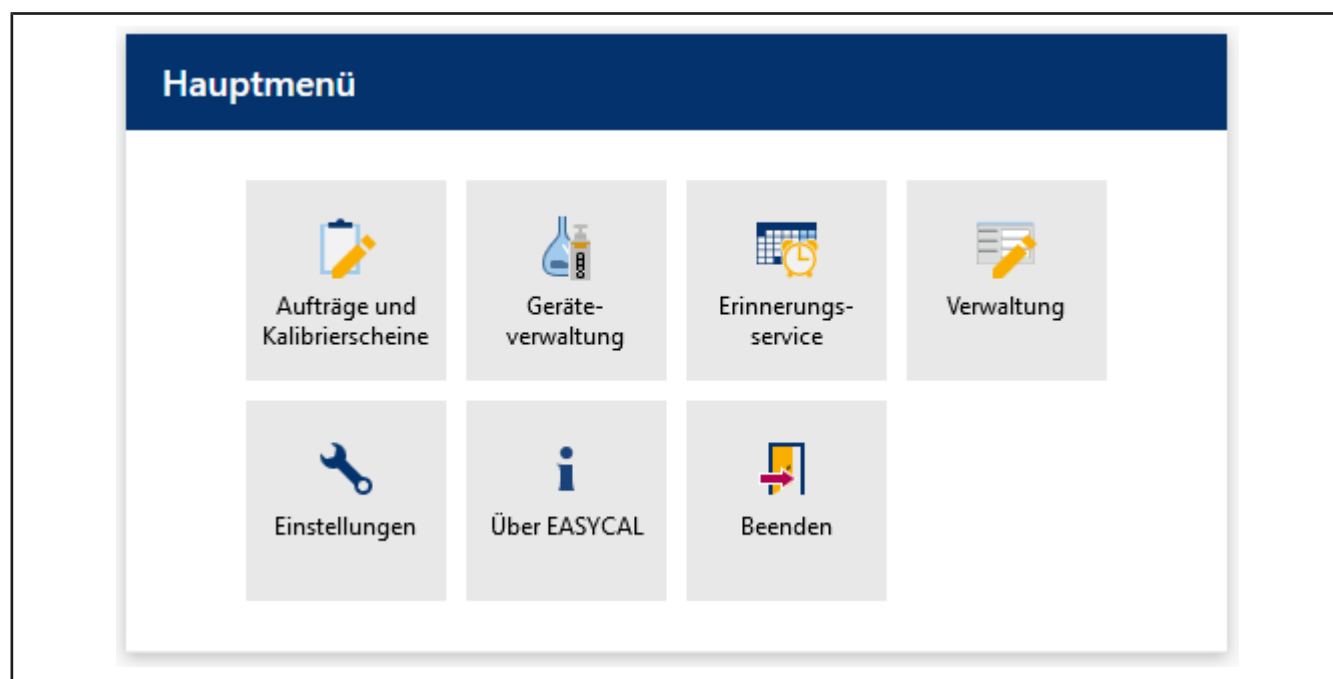

➔ Hier endet dieses Tutorial.

Imprint

BRAND GMBH + CO KG

Otto-Schott-Str. 25

97877 Wertheim (Germany)

T +49 9342 808 0

F +49 9342 808 98000

info@brand.de

www.brand.de

More operating manuals and translations?

Please refer to <http://www.brand.de/om> or use the following Quick Response Code:



The original operating manual is in German. Other languages are translations of the original operating manual.

Subject to technical changes, errors, and misprints.

Contents

- 1 Preliminary remarks 35**
- 2 Installation..... 36**
- 3 First steps in EASYCAL™ 5..... 45**
 - 3.1 Tutorial..... 45
 - 3.1.1 Set up balance as test equipment..... 45
 - 3.1.2 Creating order 45
 - 3.1.3 Determine test equipment 50
 - 3.1.4 Performing the test 50
 - 3.1.5 Complete test..... 58

1 Preliminary remarks


This tutorial is intended to make it easier for you to use EASYCAL™ 5 as part of the 30-day test period. Using an exemplary process, you will learn how to fill different areas of EASYCAL™ 5, how to carry out the first device test and how to print out a certificate.

Please note that in the course of this introduction, sample data will be generated in the database, which cannot be deleted later. We recommend coordinating this with the regulatory requirements of your quality management system.

2 Installation


Prerequisite:

- ✓ You have already received the EASYCAL™ 5 installation file, EasyCal-Setup.exe, from the BRAND home-page and saved it locally.
 - ✓ You have also received a test license (ticket) by E-mail.
 - ✓ You have local admin rights and an existing internet connection.
- a. Start the installation by opening the EasyCal-Setup.exe and follow the instructions in the installation wizard.

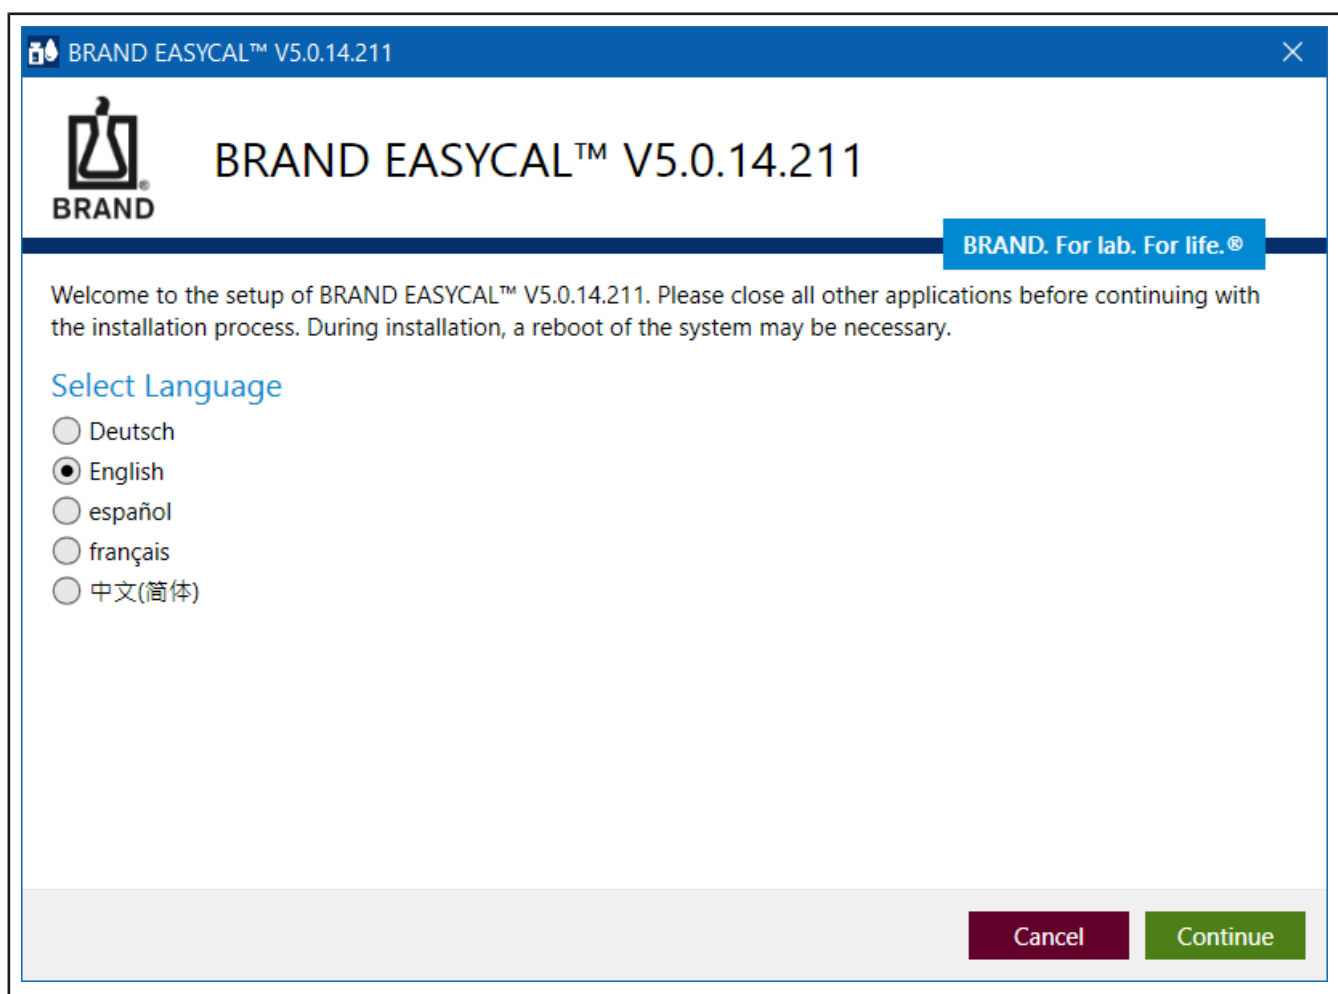


➔ EASYCAL™ 5 and all software components required for operation are installed on your PC.

- b. After completing the installation, start EASYCAL™ 5 by ticking the box and clicking on Complete.

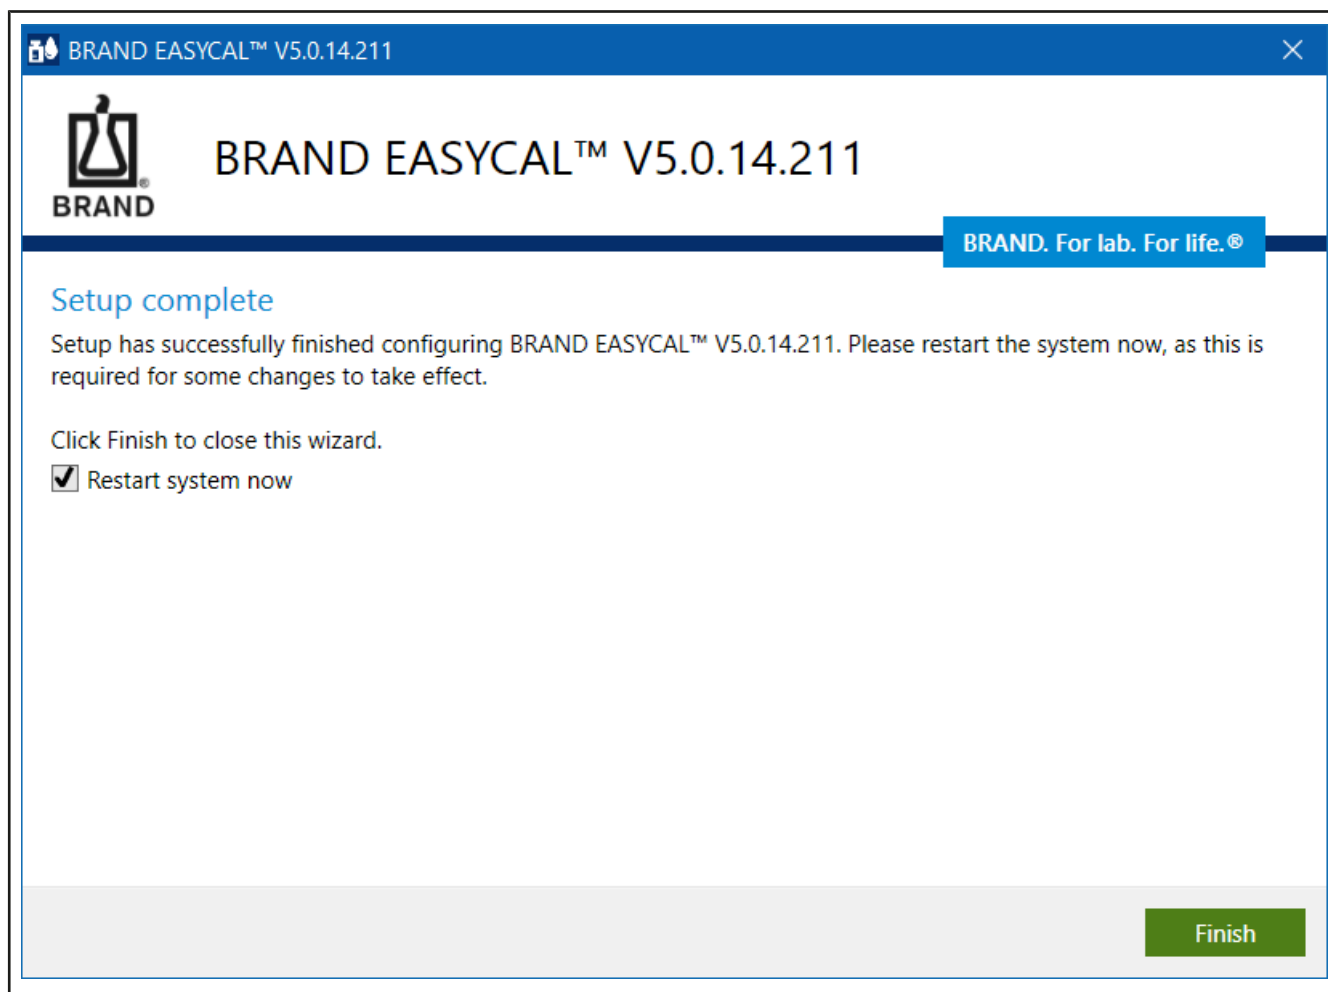


- c. You will be asked to activate EASYCAL™ 5.

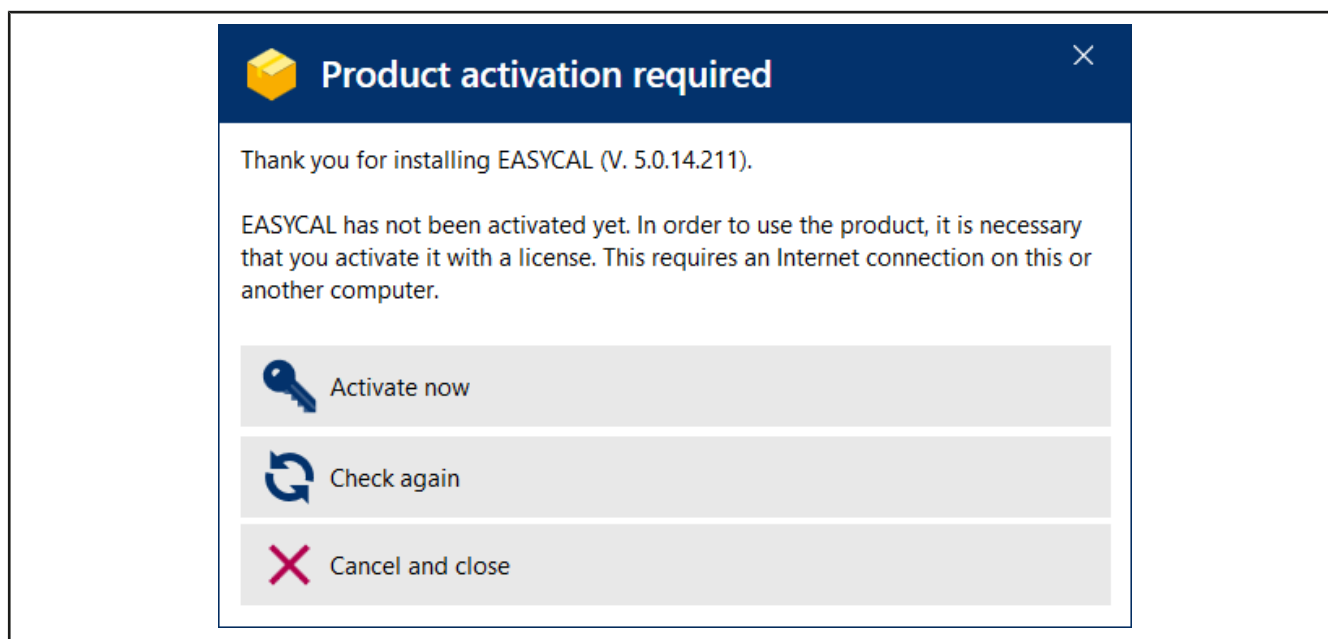

- d. Click on Activate now.

➔ Your standard web browser opens with the page <https://license.brand.de/index.php>.

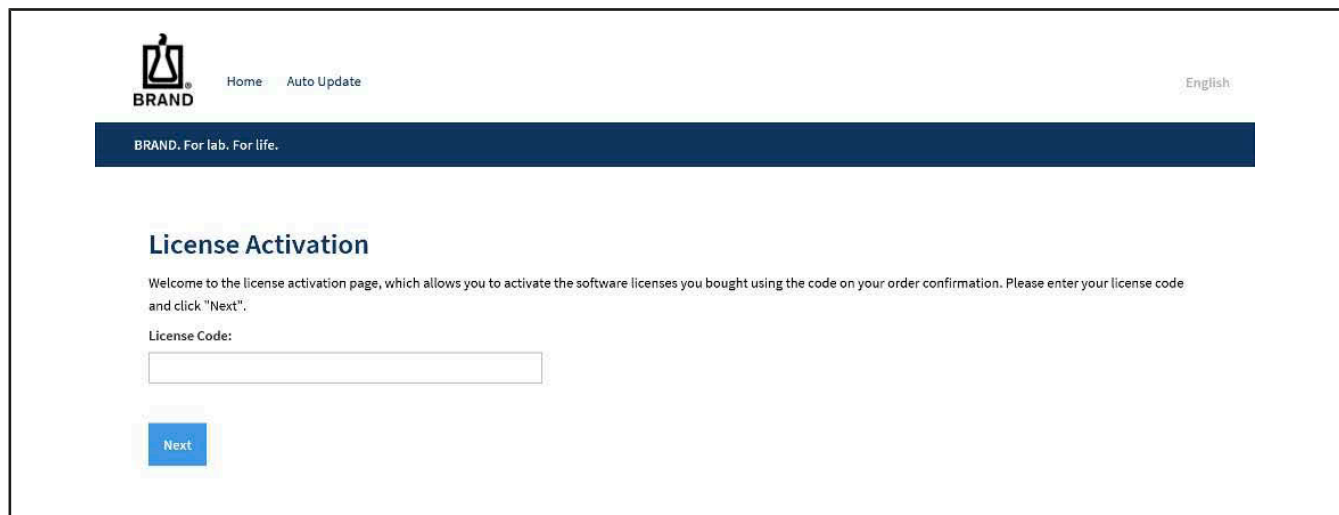

BRAND Home Auto Update English

BRAND. For lab. For life.


License Activation

Welcome to the license activation page, which allows you to activate the software licenses you bought using the code on your order confirmation. Please enter your license code and click "Next".

License Code:

Next

e. Enter your ticket (= license key) here.

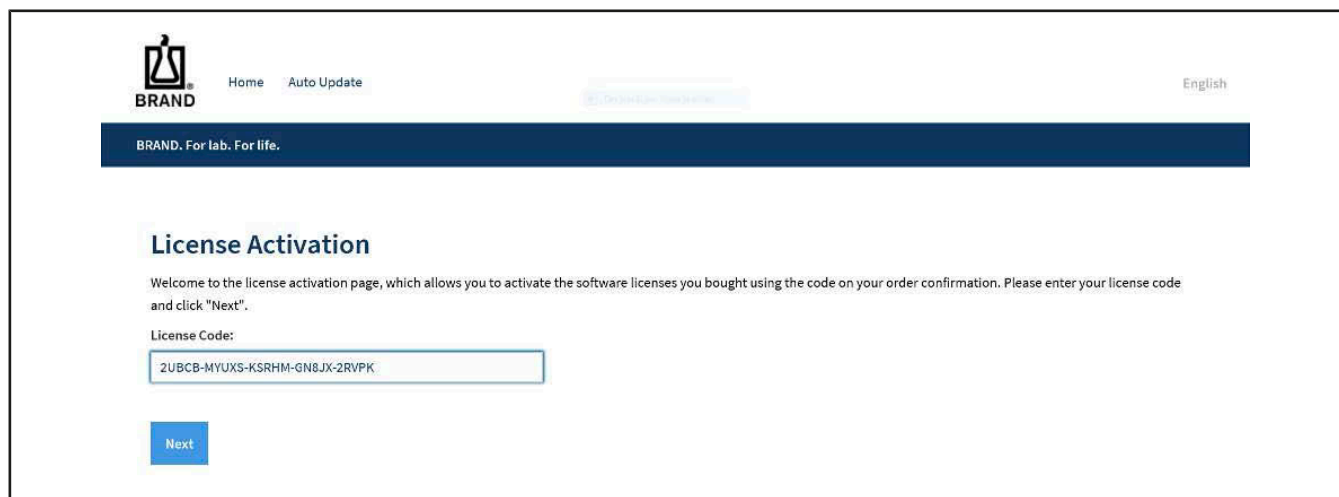

BRAND Home Auto Update English

BRAND. For lab. For life.


License Activation

Welcome to the license activation page, which allows you to activate the software licenses you bought using the code on your order confirmation. Please enter your license code and click "Next".

License Code:

Next

f. Click on Continue.

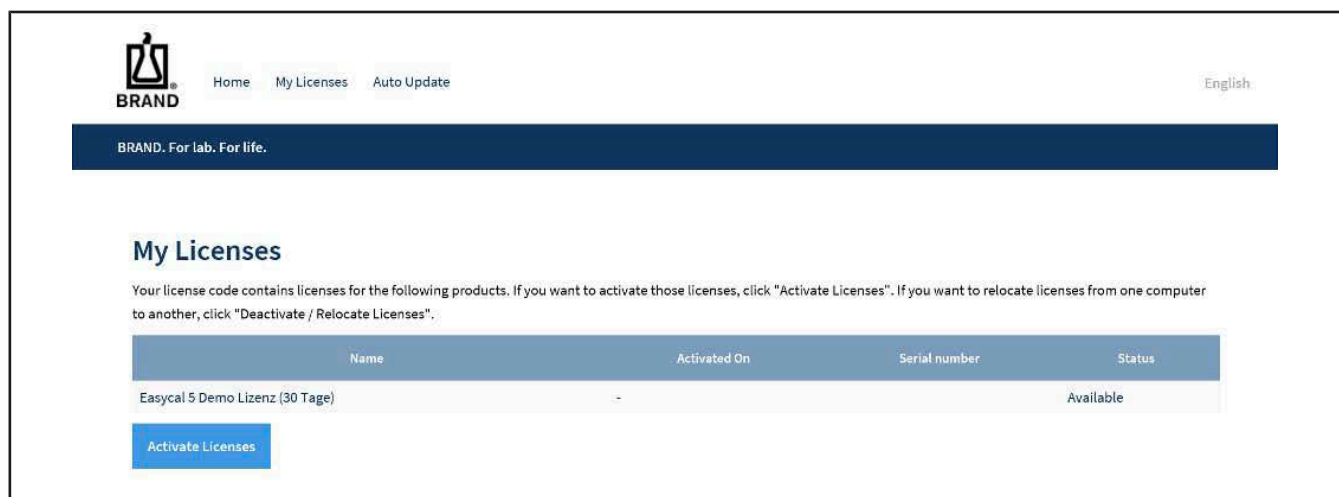

BRAND Home My Licenses Auto Update English

BRAND. For lab. For life.

My Licenses

Your license code contains licenses for the following products. If you want to activate those licenses, click "Activate Licenses". If you want to relocate licenses from one computer to another, click "Deactivate / Relocate Licenses".

Name	Activated On	Serial number	Status
Easycal 5 Demo Lizenz (30 Tage)	-		Available

Activate Licenses

g. Click on Activate License.

Activate Licenses

To activate your licenses:

1. Select the licenses you want to activate.
2. Select a license file to load the licenses into.
3. Click "Activate Selected Licenses Now".

☒	Name	Activated On	Serial number	Status
☒	EasyCal 5 Demo Lizenz (30 Tage)			Available

Select license file

select / create automatically

[Manual license transfer](#)

[Activate Selected Licenses Now](#)

h. If you do not change any of the settings, click on Activate Selected Licenses Now.

→ The online license transfer is carried out.


Online License Transfer

Starting license transfer.
 Downloading license template.
 Registering license template.
 Creating license request.
 Downloading license update.
 Importing license update into target.
 Creating receipt.
 Uploading receipt.

☒ License transfer completed successfully!


[OK](#)

- i. Click on OK.

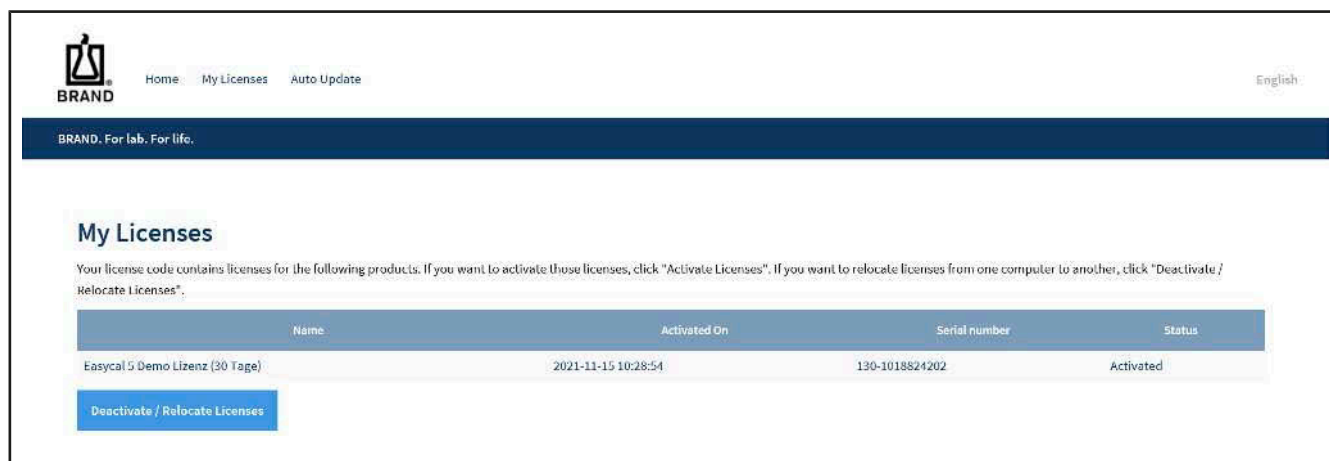


- j. The license is now activated. You can close the browser window.


- k. Go to the product activation window.

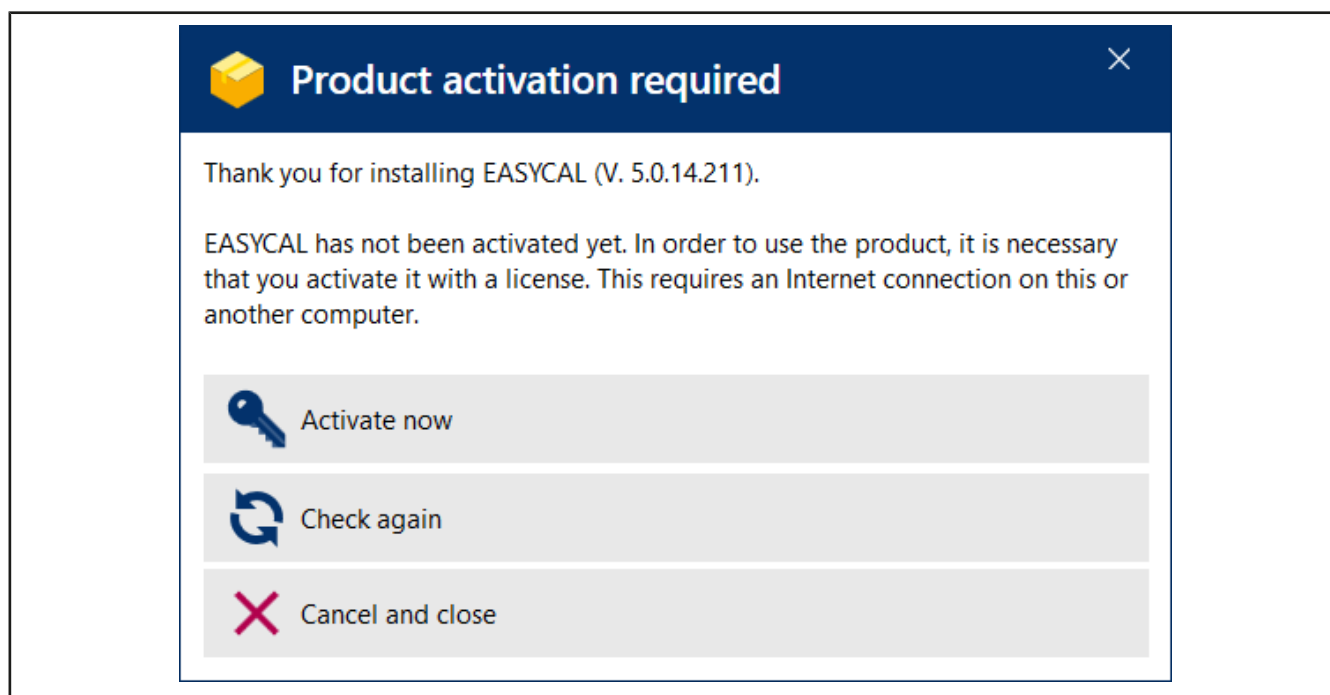


- l. Click "Check Again".

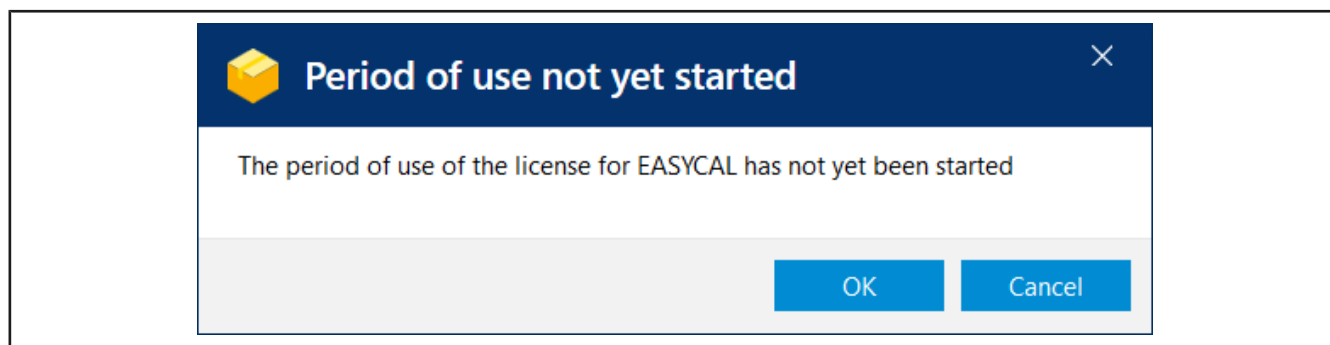


- m. Click on OK to start the usage period. An information window appears.

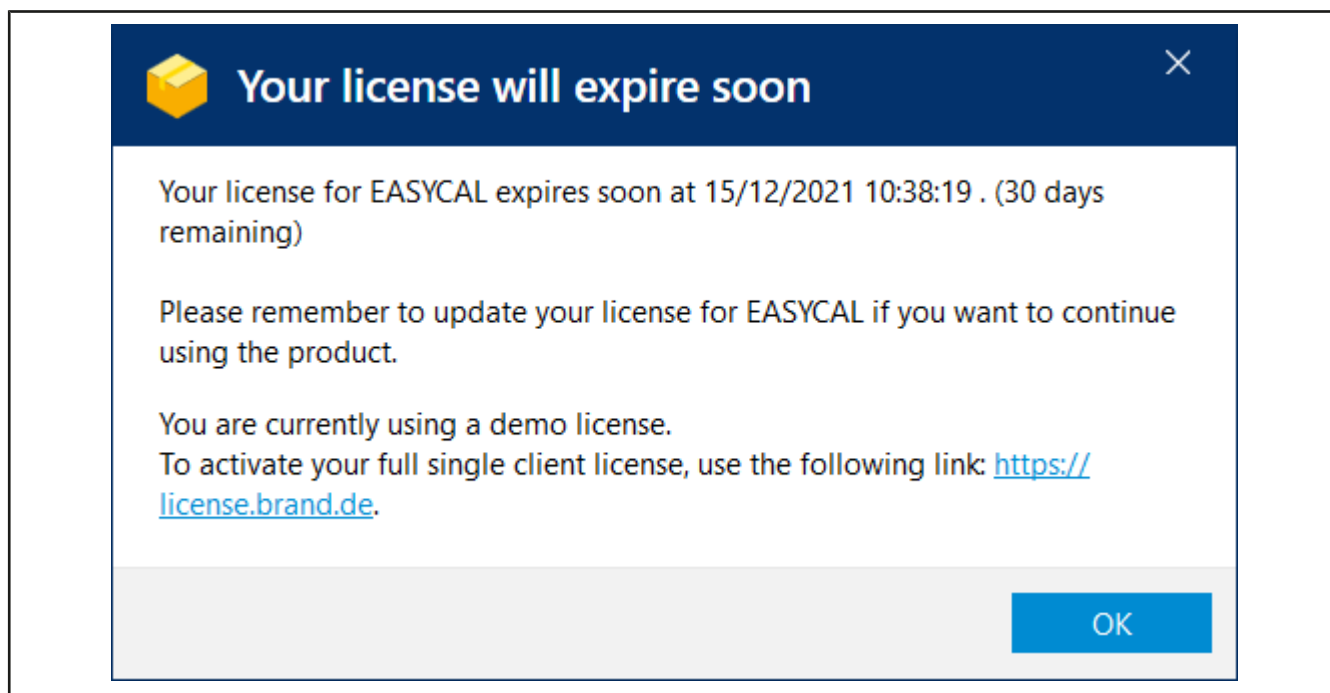


- n. Click on OK.
- o. At the same time, EASYCAL™ 5 is started and a notification appears.

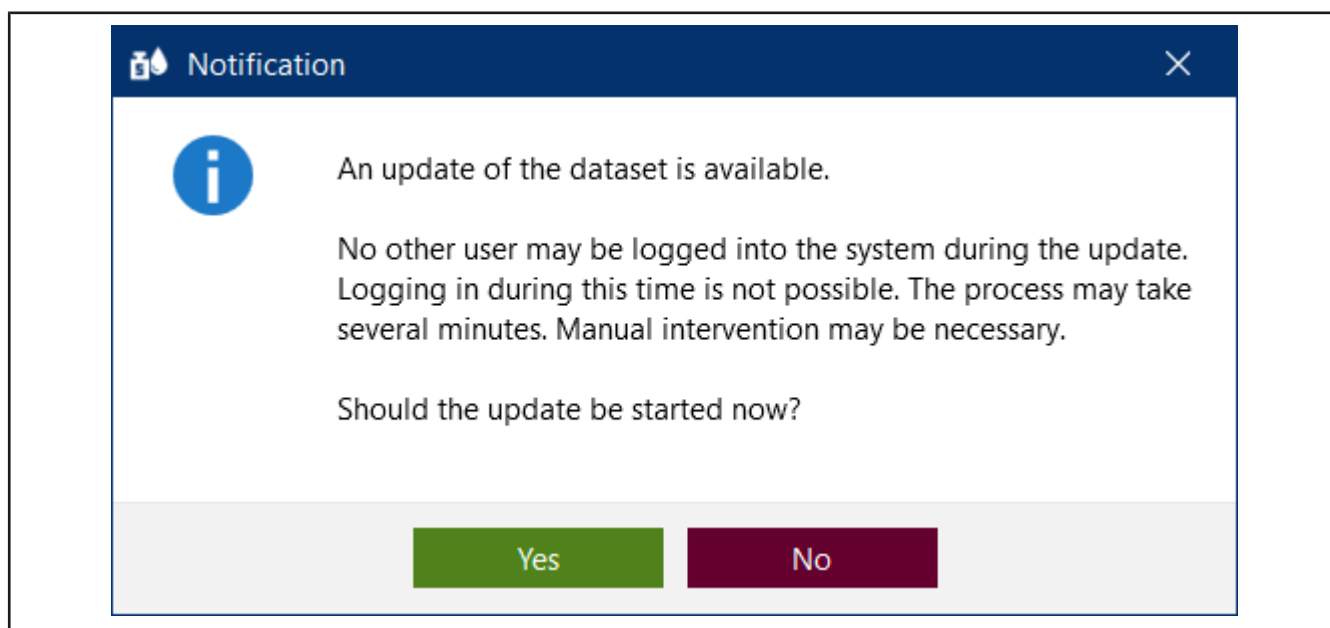


- p. Acknowledge the notification by clicking Yes so that the database is initially filled.
- q. A notification will appear after a short time.

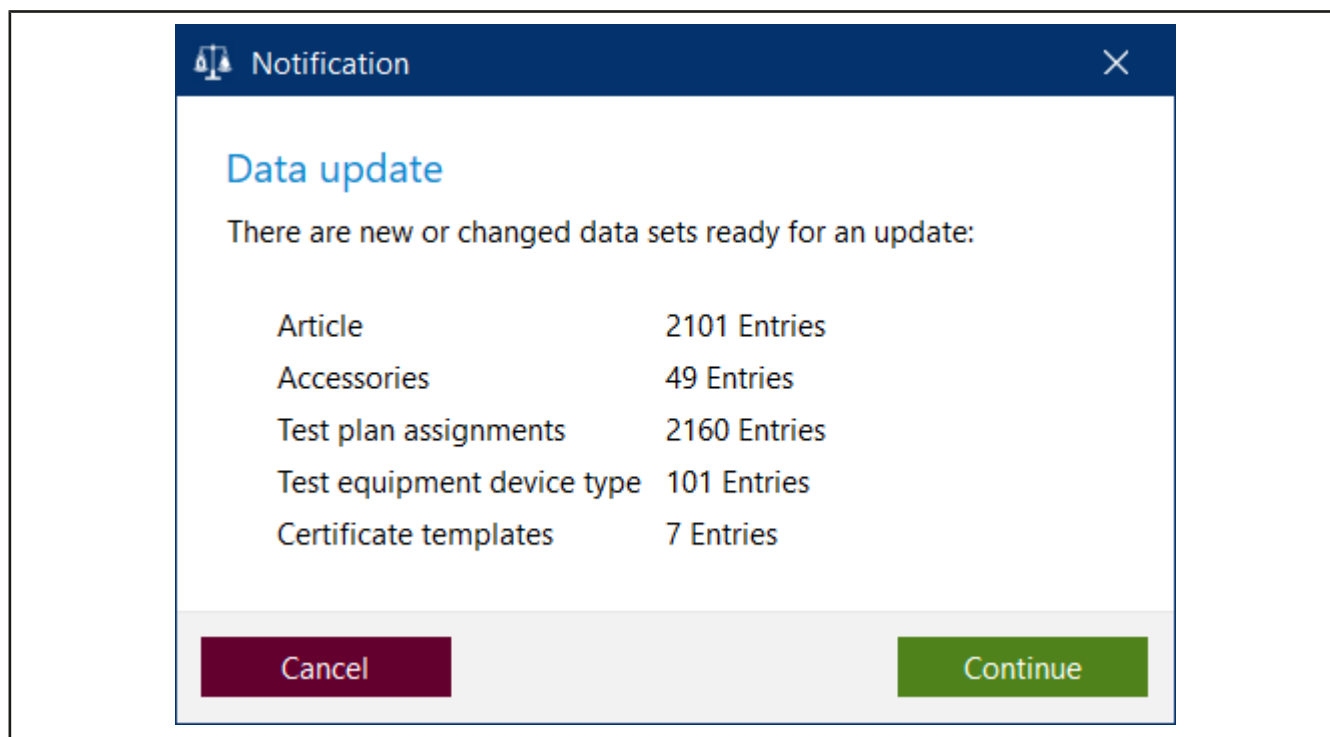


r. Close your entries by clicking Continue.

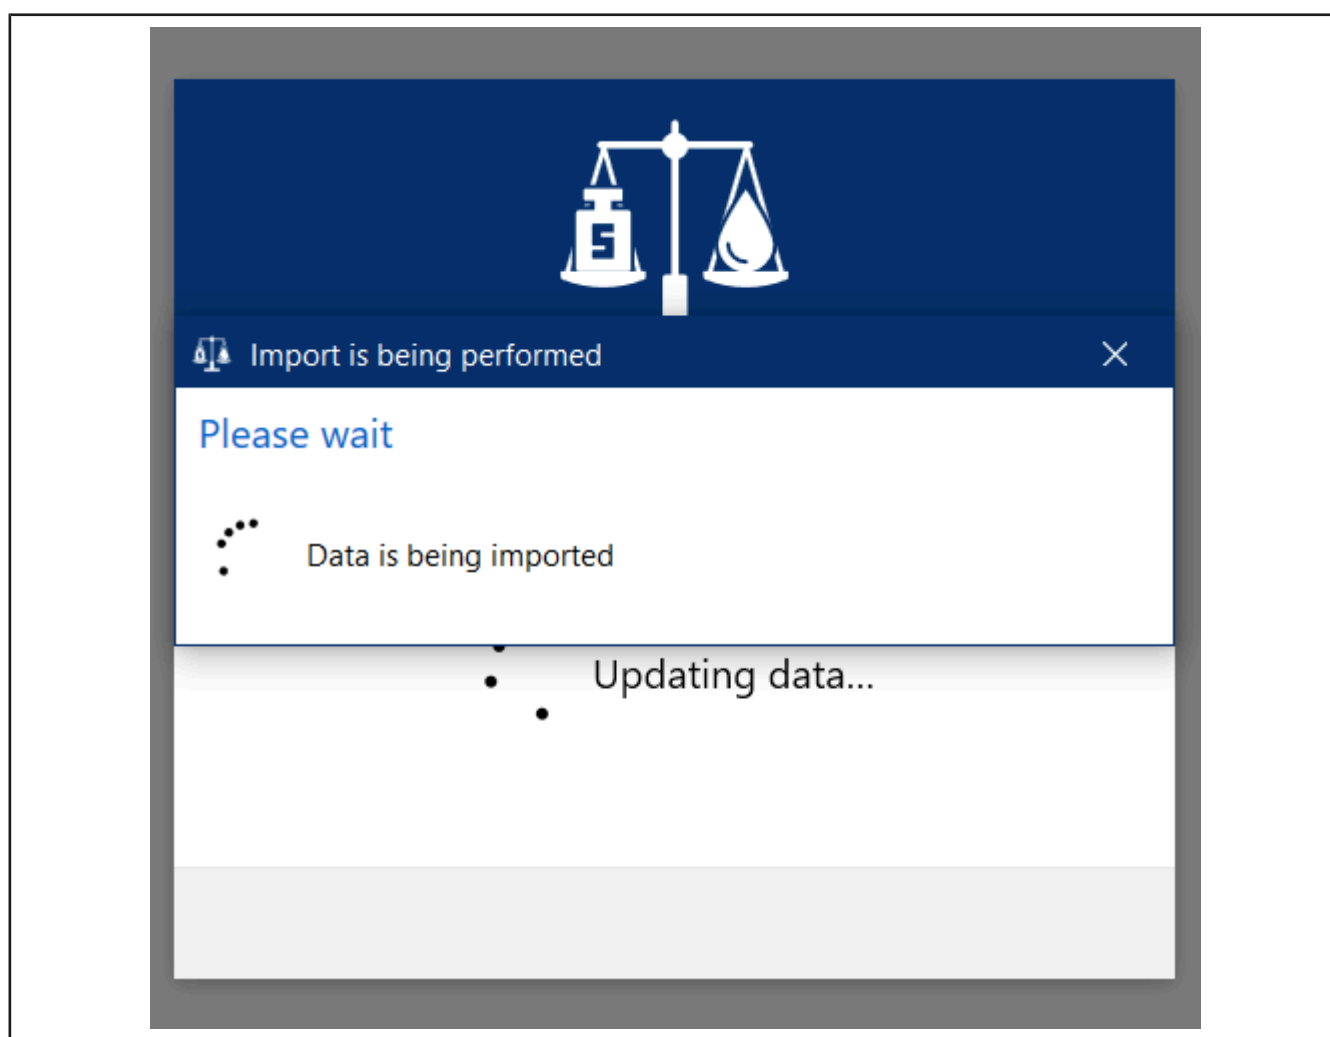

- s. The new data is imported and the progress is displayed.

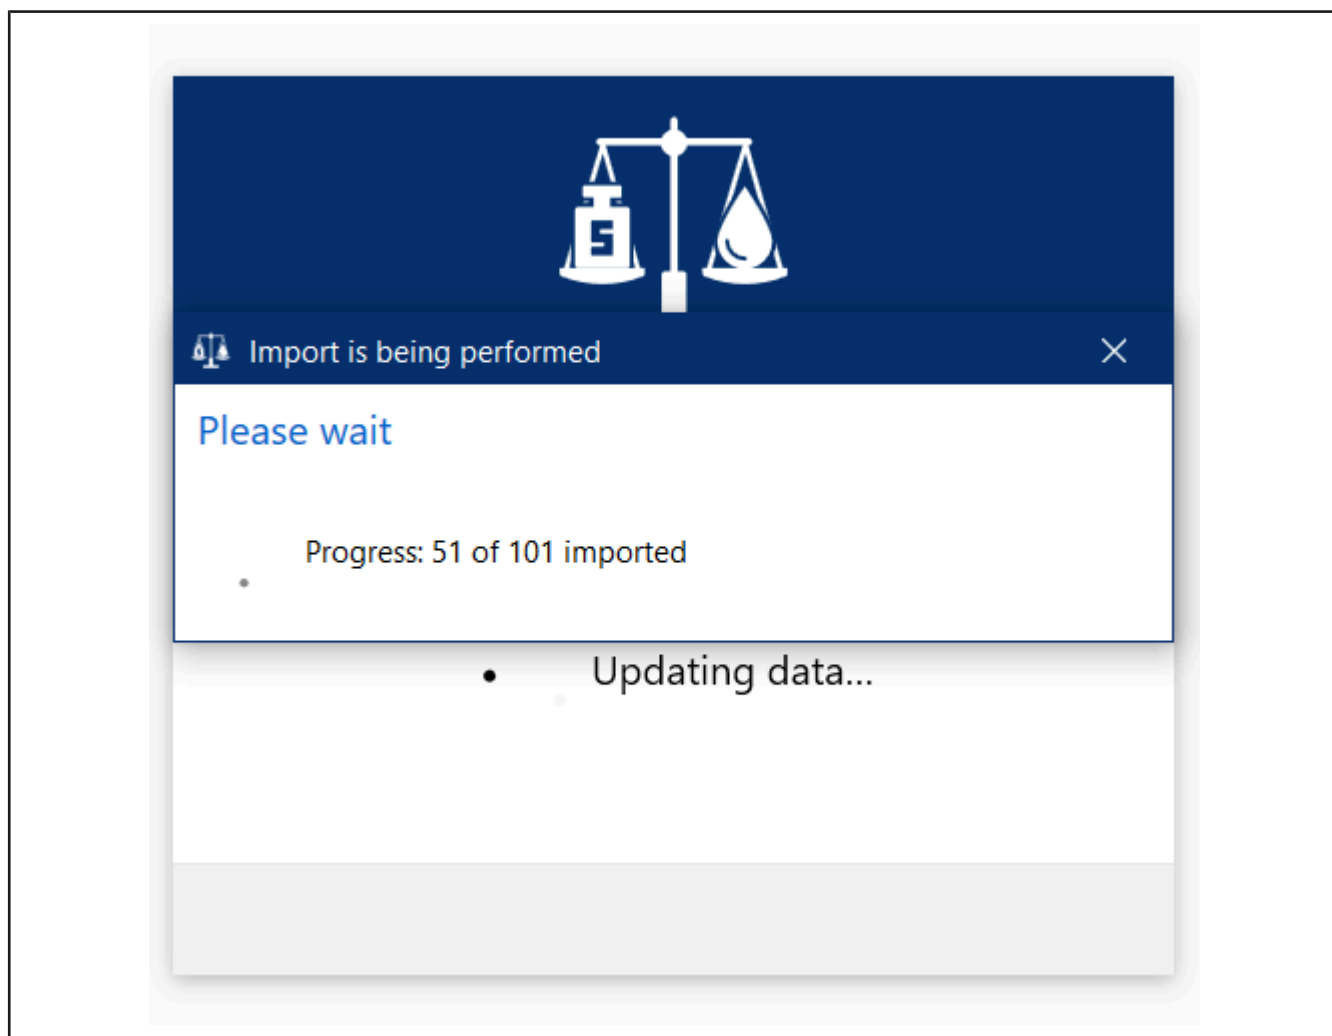


- After a while, a notification will appear that the update is complete.

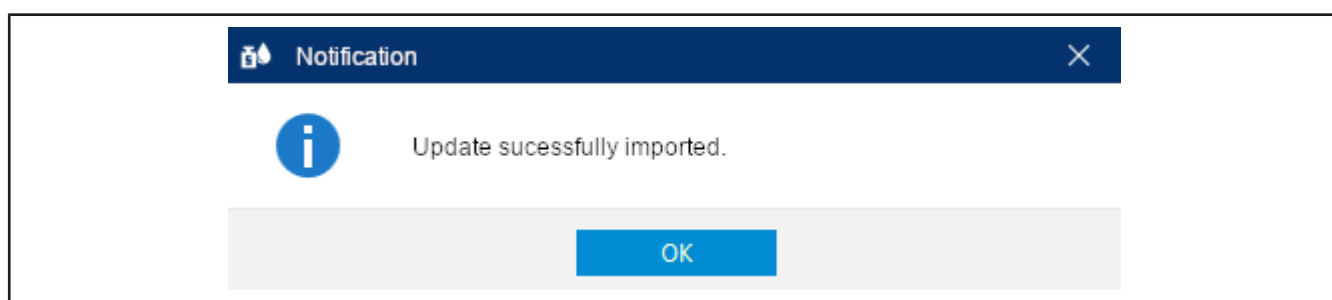

- t. Acknowledge these by clicking on OK.

- EASYCAL™ 5 will start. Various messages will appear to show the progress.

- A warning appears that you are using a demo version. Read the notes.

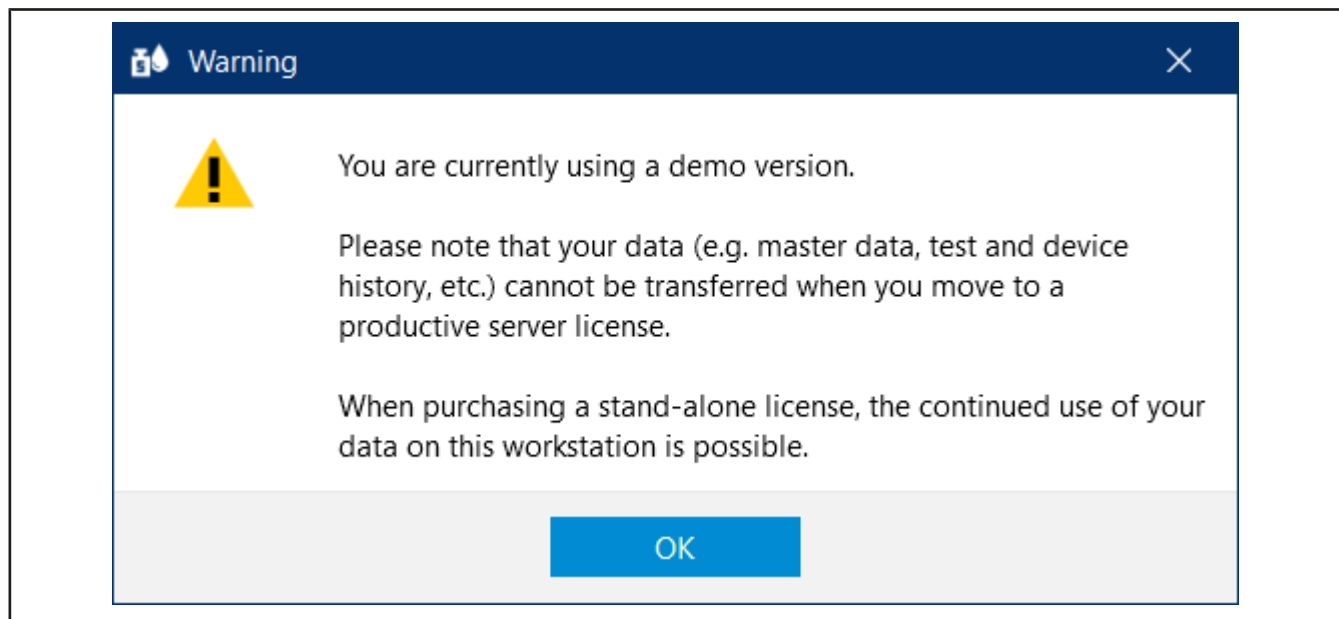

- u. After you acknowledged the warning you can now test EASYCAL™ 5.
- You will be automatically logged in as "EASYCAL Admin". Note that EASYCAL™ 5 will always start in single user mode after installation. You can change this later in the "Global Settings", but shouldn't do so at this point in time.

3 First steps in EASYCAL™ 5.

3.1 Tutorial

This example shows the process of a test – from the creation of an order to the test to the printing of the certificate. The section refers to master data available in the demo license and serves as a first introduction to the program.

Login

If the program EASYCAL™ 5 is started, a log-in dialog appears. Here, the user logs in with user name and password.

3.1.1 Set up balance as test equipment

In order set up a balance as a piece of test equipment, proceed as follows. The set-up is always done in the order: Set up test equipment in the master data, set up test equipment at the workstation, and select test equipment for the orders.

Prerequisite:

- ✓ You have connected a balance to the workstation.
 - ✓ You know the connection parameters of the balance.
 - ✓ You know to which COM port the balance is connected at the workstation.
- a. Name balance (see Administration > Master data maintenance > Test equipment > Test equipment).
 - b. Set up location for test equipment (if not already done).
 - c. Configure the balance as a test equipment (see Test equipment device type). In doing so, you specify both the function and the connection of the balance to the workstation (see Measuring function, Communication).
- Exit this menu. Change to the Settings menu.
- d. Register the balance as test equipment at the workstation (see Settings > Workstation settings > Test equipment).
 - e. Select balance and the connection for the workstation. You can also test the connection to the balance.
- Exit this menu. Change to the Orders and calibration slips menu.
- f. You can select the connected balance in the order when selecting the test equipment. In the tutorial (see Determine test equipment, p. 50), in the user manual under Select test equipment for the test.

3.1.2 Creating order

- a. Navigate from Main menu to Orders and calibration slips.

Orders and calibration slips

Test type filter Not specified
Search
from 1/11/2022 to 1/26/2022

Order overview
Calibration slips

Order I	Test typ	Order number	Article	Status
2	SPEC	2022-01-25-15-2	EC-12484 - Burette BLAUBRAND®, straight stopcock, Schilling, class AS; 0.02 - 10 ml	Created
1	STD	123456	EC-704106 - Transferpette® Fixed volume; 5 µl	Finished

Back
Individual device test
Create order
Open

b. Click on Create order.

Select order type

Batch test

Use when testing random samples (of any size). Batch certificates are issued.

Individual test

Use for 100% test or test of a single device.

Each device receives its own certificate.

Back

c. Click on Individual test.

d. For Test type, select the value STD – Standard values.

Test types organize your test procedures. You cannot create additional test types; instead, you must choose from the test types already stored. The test plans are linked to the test type as well as the certificate templates. In the user administration, the user must be given the respective access right for the corresponding test type. Because you are currently logged in as Global Admin, you have access to all data.

Individual test - Create order

Test type: **STD - standard values** | Number of devices: **1** | Customer: [dropdown]

Order no.: [input] | Order no.: [input]

Article code: [input] | OC-Number: [input]

Article: [input]

☐ Prepare calibration slips

☐ Pre- and post-test required

Notes on the order: [text area]

End customer: [dropdown]

Volume ranges: [input]

Test plan: [dropdown]

Back | **Start test**

e. Click on the button at Item code in order to display already created articles.

Individual test - Create order

Test type: **STD - standard values** | Number of devices: **1** | Customer: [dropdown]

Order no.: [input] | Order no.: [input]

Article code: [input] | OC-Number: [input]

Article: [input]

☐ Prepare calibration slips

☐ Pre- and post-test required

Notes on the order: [text area]

End customer: [dropdown]

Volume ranges: [input]

Test plan: [dropdown]

Back | **Start test**

Select article

Search: [input]

Article code	Vei	Manufacturer	Product	Product variation	Volume range	Status
10_copy	1	BRAND GMBH I + CO KG	Dispensette® S Organic	Fixed volume, Special fixed volume	0.05 - 5 ml	Released
10002	0	BRAND GMBH I + CO KG	Burette	SILBERBRAND, ohne I lahn, class B, Economy	0.1 - 25 ml	Released
10012	0	BRAND GMBH I + CO KG	Compact Burette	SILBERBRAND, class B, Economy	0.1 - 25 ml	Released
100710	6	Eppendorf AG	Research® plus	Fixed volume, medium grey	10 µl	Released
100711	7	Eppendorf AG	Research® plus	Fixed volume, light grey	20 µl	Released
100711_copy	0	Eppendorf AG	Research® plus	Fixed volume, light grey	20 µl	Released
100212	6	Eppendorf AG	Research® plus	Fixed volume, yellow	10 µl	Released
100212_copy	0	Eppendorf AG	Research® plus	Fixed volume, yellow	10 µl	Released
100213	6	Eppendorf AG	Research® plus	Fixed volume, yellow	20 µl	Released
100214	7	Eppendorf AG	Comforpette®	Fixed volume	20 µl	Released
100215	6	Eppendorf AG	Research® plus	Fixed volume, yellow	50 µl	Released
100216	6	Eppendorf AG	Research® plus	Fixed volume, yellow	100 µl	Released
100217	6	Eppendorf AG	Research® plus	Fixed volume, yellow	200 µl	Released
100218	6	Eppendorf AG	Research® plus	Fixed volume, blue	200 µl	Released
100219	6	Eppendorf AG	Research® plus	Fixed volume, blue	250 µl	Released
100220	6	Eppendorf AG	Research® plus	Fixed volume, blue	500 µl	Released
100221	6	Eppendorf AG	Research® plus	Fixed volume, blue	1000 µl	Released
100310	6	Eppendorf AG	Research® plus	Adjustable volume, dark grey	0.1 - 2.5 µl	Released
100311	8	Eppendorf AG	Research® plus	Adjustable volume, dark grey	0.5 - 10 µl	Released

© Daniel Iking | Last status: The application is prepared

f. Enter Transferpette® S 1000 in the search field. As you type, you will see the article selection change. This behavior is the same in all search fields of EASYCAL™ 5. We recommend always using the search function first because EASYCAL™ 5 comes with an extensive master database.

The prefix EC- indicates that it is a prefabricated and unchangeable data set. If you would like to change

these records, copy the record, and edit and save it under a different name. For more information, see “Help” in EASYCAL™ 5.

Individual test - Create order

Test type: **STD - standard values** | Number of devices: **1** | Customer:

Order no.: | Order no.: | OC-Number:

Article code: | Article:

Volume ranges:

Test plan:

Select article

Search:

Article code	Vei	Manufacturer	Product	Product variation	Volume range	Status
700762	2	Treff AG	TreffLab-Transferpette®	Fixed volume	1000 µl	Released
700700	2	Treff AG	TreffLab-Transferpette®	Adjustable volume	100 - 1000	Released
700784	2	Treff AG	TreffLab-Transferpette®	Adjustable volume	1000 - 1000	Released
700791	0	Treff AG	TreffLab-Transferpette®	Adjustable volume	100 - 1000	Released
700793	0	Treff AG	TreffLab-Transferpette®	Adjustable volume	1000 - 1000	Released
700965	0	BRAND GMBH + CO KG	Transferpette® α	1.0 ml, 1-Stop	1000 µl	Released
700966	0	BRAND GMBH + CO KG	Transferpette® α	100 - 1000 µl, 1-Stop	100 - 1000	Released
704162	3	BRAND GMBH + CO KG	Transferpette®	Fixed volume	1000 µl	Released
704180	4	BRAND GMBH + CO KG	Transferpette®	Adjustable volume	100 - 1000	Released
704762	5	BRAND GMBH + CO KG	Transferpette® S	Fixed volume	1000 µl	Released
704780	6	BRAND GMBH + CO KG	Transferpette® S	Adjustable volume	95 - 1000	Released
704780-4711	0	BRAND GMBH + CO KG	Transferpette® S	Adjustable volume	100 - 1000	Released
704780-4712	0	BRAND GMBH + CO KG	Transferpette® S	Adjustable volume	100 - 1000	Released
704780-4713	0	BRAND GMBH + CO KG	Transferpette® S	Adjustable volume	100 - 1000	Released
704784	4	BRAND GMBH + CO KG	Transferpette® S	Adjustable volume	1000 - 1000	Released
704941	2	BRAND GMBH + CO KG	Transferpette® S	1.0 ml, 1-Stop	1000 µl	Released
704945	2	BRAND GMBH + CO KG	Transferpette® S	100 - 1000 µl, 1-Stop	100 - 1000	Released
704980	5	BRAND GMBH + CO KG	Transferpette® α	Adjustable volume	100 - 1000	Released
704984	5	BRAND GMBH + CO KG	Transferpette® α	Adjustable volume	1000 - 1000	Released

Back

Daniel Ivrig | Last status: The application is prepared

- g. Select the article code EC-704780. Confirm your selection with a double click.
- h. For Test plan, select the appropriate test plan. As a rule, you will find 1–2 entries here.
- i. The general conditions for the test as well as the defect limits of the assigned article are stored in the test plan.

Individual test - Create order

Test type: **STD - standard values** | Number of devices: **1** | Customer:

Order no.: | Order no.: | OC-Number:

Article code: **704780** | Article: **Transferpette® S**
Adjustable volume
BRAND GMBH + CO KG

Volume ranges: **1000µl (95 - 1000)**

Test plan: **4437.0 - EC-STD-ISO-PiPip-var-LHDiv**

Notes on the order:

End customer:

Back | **Start test**


- j. Click on Start test.

A notification that no order number has been assigned appears.


If there are specifications in your company/quality management process for organizing tests, select no, and assign an order number.

If there are no specifications for organizing tests, select Yes and EASYCAL™ 5 will assign a unique order number

We recommend deciding on a uniform approach at an early stage.

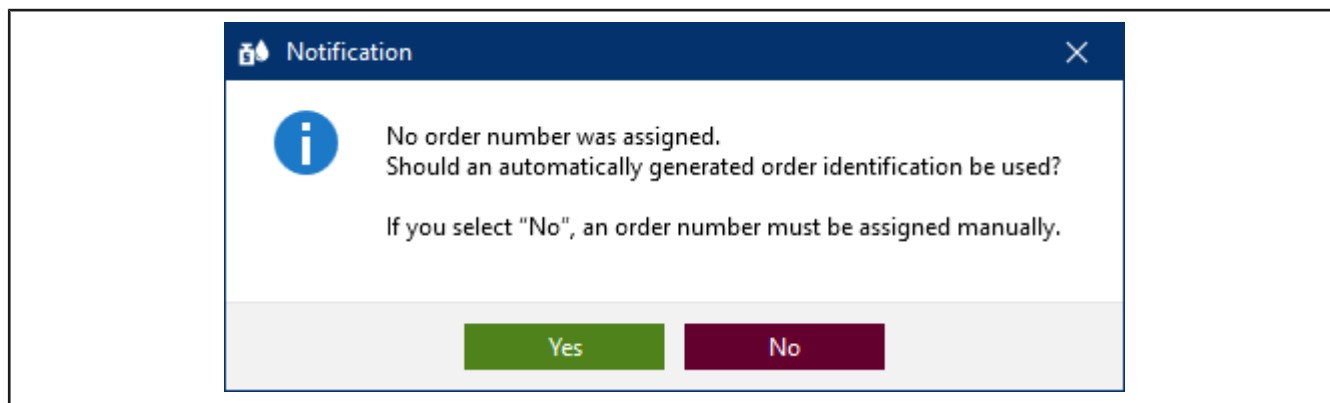

k. Continue the tutorial by clicking on Yes. The job number is created based on the current time stamp.

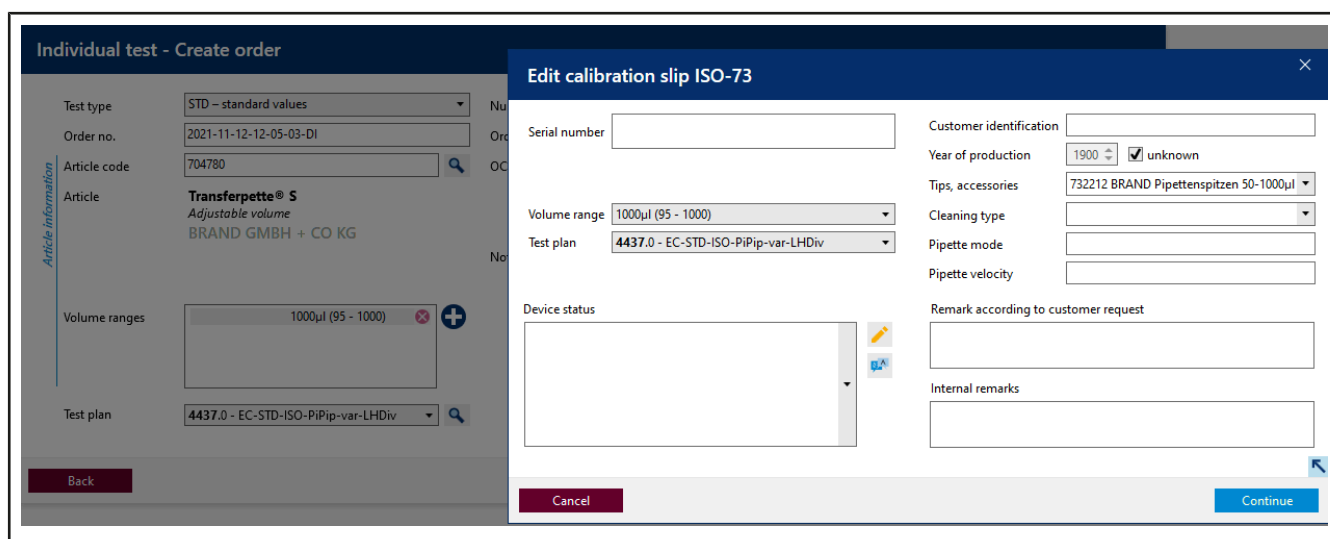

l. You can enter a serial number for the identification of the device. This is necessary for real tests. However, it is not necessary for the tutorial.

m. Click on Continue. The test order has been created.

The window for starting the actual test will open.

3.1.3 Determine test equipment

BRAND EASYCAL™ 5

2021-11-12-12-05-03-DI / ISO-73 - - 704780 BRAND GMBH + CO KG Transferpette® S Adjustable volume 95 - 1000µl

Test equipment > 2. TV > 1. TV > NV

✓ / ✗ A / B / C Measurement + i

Air temperature	Thermometer		351000-71
Temperature of the medium	Thermometer		351000-71
Relative humidity	Hygrometer		600029-10
Air pressure	Barometer		600029-10
Weight	Single-channel balance	Calibrate now	20210708-RZ-01
Weight	Single-channel balance	Calibrate now	20210708-RZ-01
Weight	Single-channel balance	Calibrate now	20210708-RZ-01

Back

Previous device Previous characteristic Next characteristic Additional device

Device evaluation Complete test Print preview

Prerequisite:

- ✓ The order is created.
- a. The necessary parameters as well as the test equipment type and the test equipment (test equipment number) are preselected for the test equipment. Because only one piece of test equipment is created, we leave it at this selection.

3.1.4 Performing the test

- a. Continue by clicking on Next characteristic.

You see the central input screen of the measurement functionality of EASYCAL™ 5.

BRAND - EASYCAL™ 5

2021-11-12-12-05-03-DI / ISO-73 - - 704780 BRAND GMBH + CO KG Transferpette® S Adjustable volume 95 - 1000µl

Ambient data

Request ambient data

Target value: 100 µl

Number: 0 / 10

Test equipment: 2. TV, 1. TV, NV

Graph of the measured values

Statistics of device

Statistics of order

Back, Previous device, Previous characteristic, Next characteristic, Additional device, Device evaluation, Complete test, Print preview

- b. Enter fictitious weight values for Neue Messung. Start with 0, 1, and click on “Apply measured value”. A window in which you must enter or complete the measured values appears.

The selection of the separator (comma or dot) is done via the language selection in the software.

Enter measured values

Temperature difference	0.00 °C	0.5 °C	
Weight	0.1 g		☒ Manual
Air temperature	0 °C	(20°C - 25°C)	☒ Manual
Temperature of the medium	0 °C	(20°C - 25°C)	☒ Manual
Relative humidity	0 %rh	(40%rh - 65%rh)	☒ Manual
Air pressure	0 mbar	(960mbar - 1025mbar)	☒ Manual

Cancel Apply

- c. Enter fictitious values for the environment parameters as follows:

Enter measured values

Temperature difference	0.00 °C	0.5 °C	
Weight	0.1	g	☒ Manual
Air temperature	21	°C	(20°C - 25°C) ☒ Manual
Temperature of the medium	21	°C	(20°C - 25°C) ☒ Manual
Relative humidity	40	%rh	(40%rh - 65%rh) ☒ Manual
Air pressure	961	mbar	(960mbar - 1025mbar) ☒ Manual

Cancel
Apply

- d. Click on Apply. The first measurement is hereby completed. The measured value and the volume calculated from it appear in the table.

Test equipment > 2. TV > 1. TV > NV				
Number	Time	Measured value	Volume [µl]	Sta
1	11/12/2021 2:06:42 PM	0.10000 g	100.3	✓

- e. Now enter the value 0.1 g as the measured value eight times in the same way. The table is filled up.

2021-11-12-14-10-58-DI / ISO-74 - - 704780 BRAND GMBH + CO KG Transferpette® S Adjustable volume 95 - 1000µl

Ambient data: 21 °C, 21 °C, 40 %rh, 961 mbar

Request ambient data

Target value: 100 µl

Number: 9 / 10

Letzte Messung: 0.1 g, 1003.01211312 µl/g, 100.3 µl, 2:13:39 PM

Neue Messung: g, µl/g, µl

Apply measured value

Test equipment disconnected

Fast measurement, Automatic printing, Automatic tare, Allow all measured values, Check measured values before entering

Discard entry, Undo discard

Test equipment > 2. TV > 1. TV > NV

Number	Time	Measured value	Volume [µl]	Sta
2	11/12/2021 2:13:27 PM	0.10000 g	100.3	✓
3	11/12/2021 2:13:29 PM	0.10000 g	100.3	✓
4	11/12/2021 2:13:30 PM	0.10000 g	100.3	✓
5	11/12/2021 2:13:32 PM	0.10000 g	100.3	✓
6	11/12/2021 2:13:34 PM	0.10000 g	100.3	✓
7	11/12/2021 2:13:35 PM	0.10000 g	100.3	✓
8	11/12/2021 2:13:37 PM	0.10000 g	100.3	✓
9	11/12/2021 2:13:39 PM	0.10000 g	100.3	✓

Graph of the measured values

Statistics of device

100.3 ± 0

Accuracy: 0 % / 8 % ✓

Coefficient of variation: 0 % / 3 % ✓

Mean: 100.3 µl

Standard deviation: 0 µl

Expanded measurement uncertainty: 0 µl

Statistics of order

Accuracy: 0 %

Mean: 100.3 µl

Standard deviation of the mean: 0 µl


Coefficient of variation of accuracy: 0 %

Mean value CV: 0 %


CPK: 0

Back, Previous device, Previous characteristic, Next characteristic, Additional device, Device evaluation, Complete test, Print preview

- f. The light blue color in the section above the table shows that the order is being processed. Click the icon in order show and hide the extended certificate information.
- g. Enter 0.1 again as the measured value, and pay attention to the progression display above the measured value table.

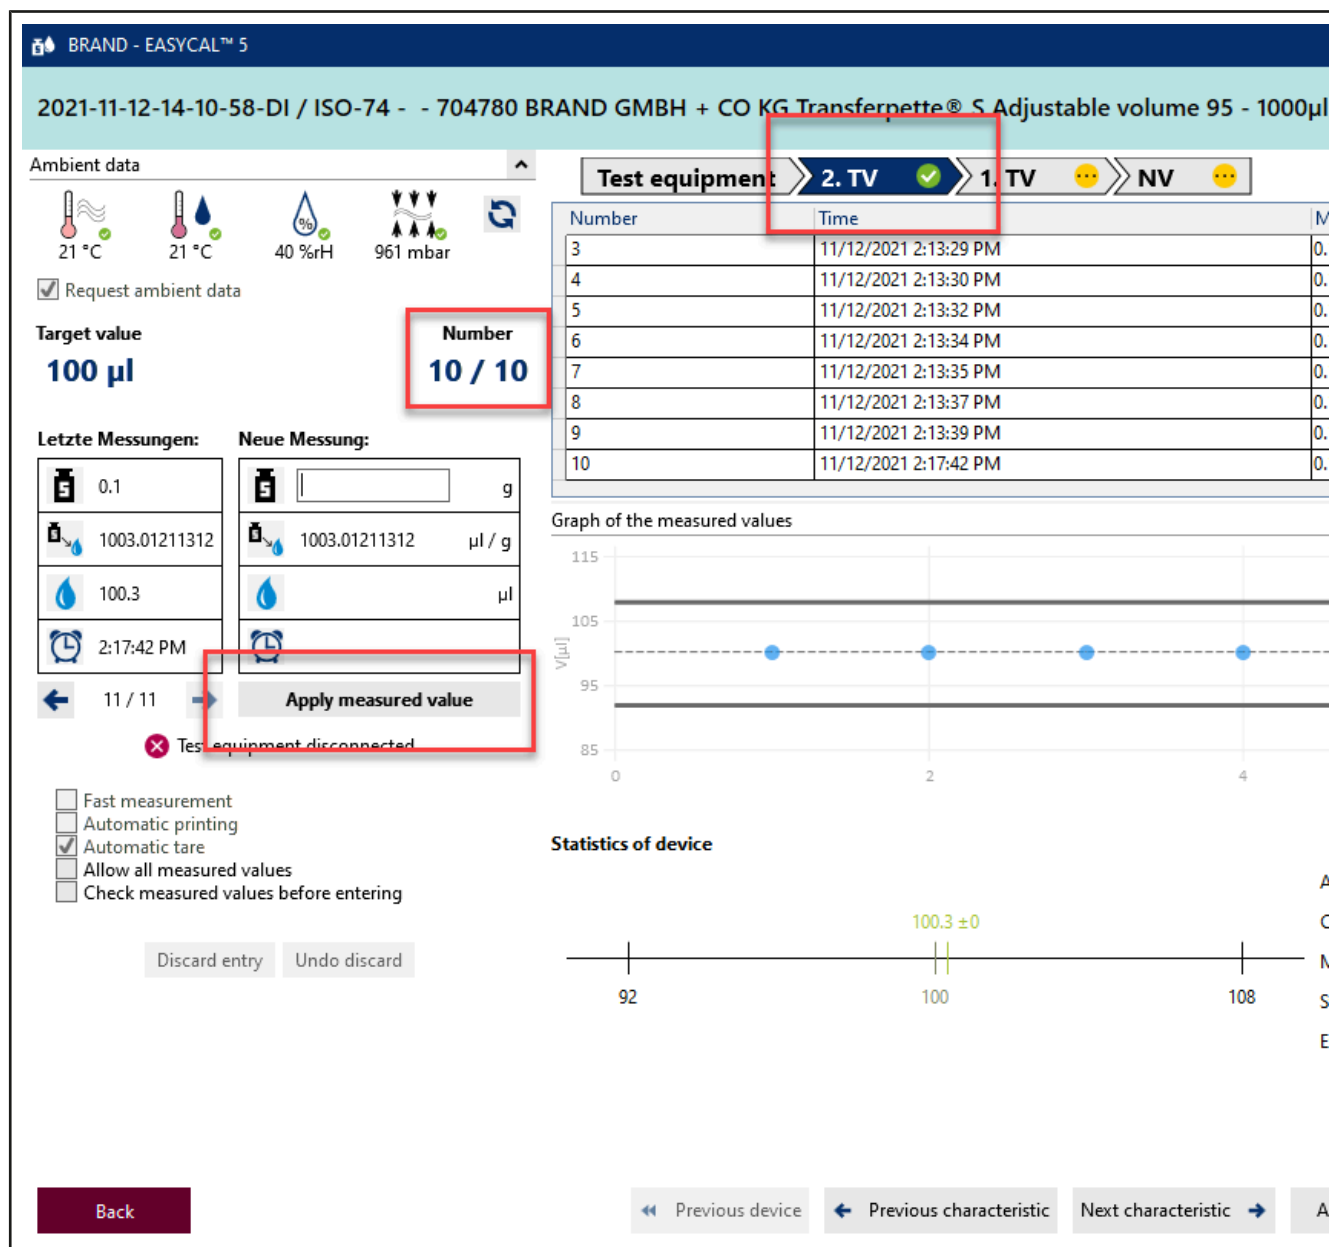

- h. With input of the 10th measured value, all required measurements for characteristic 2 . TV have been performed. The characteristic gets a green check. You can enter further measured values; however, this is not required.

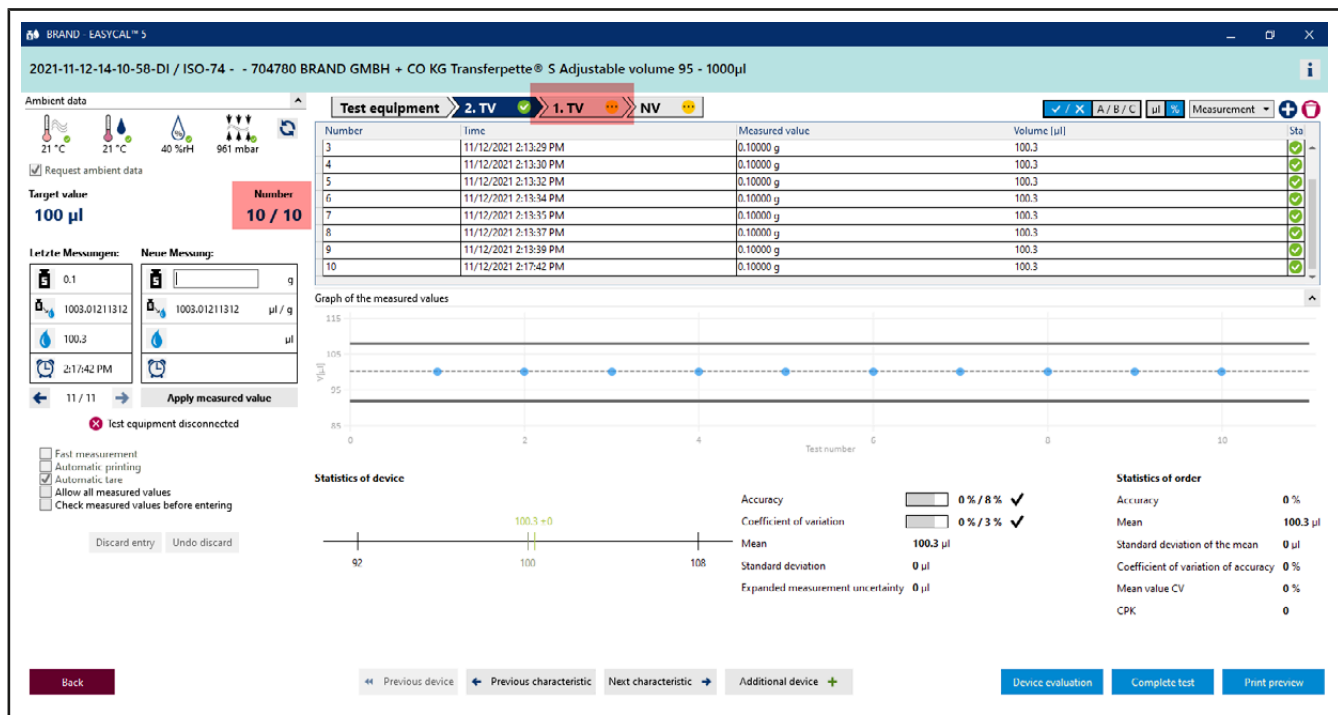


i. Click on 1. TV in the progress bar in order to jump to the next characteristic.

j. For Neue Messung, enter the following values in sequence:


0.498
0.499
0.500

Repeat twice.


➔ You can see the position of the individual measured values in relation to defined error limits (solid lines) and the calculated mean value in the display Graph of the measured values. Under Statistics of device, you can see the calculated actual values for accuracy and coefficient of variation compared with the defined limits.

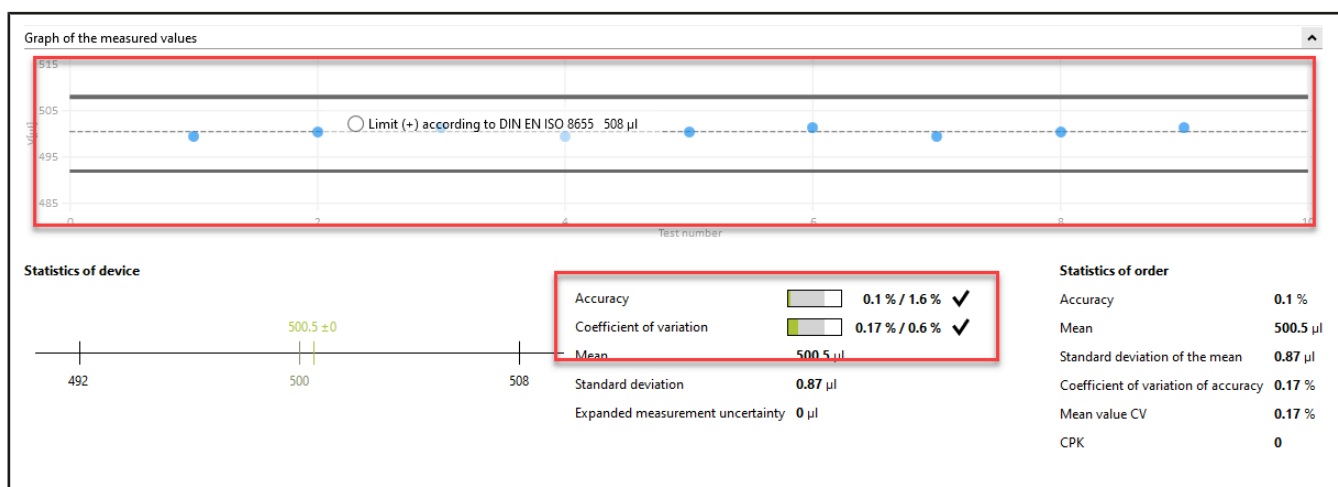

- k. Enter 0.498 again as the measured value, confirm the environmental parameters, and click NV in the progress display. Then enter 1 as the measured value.

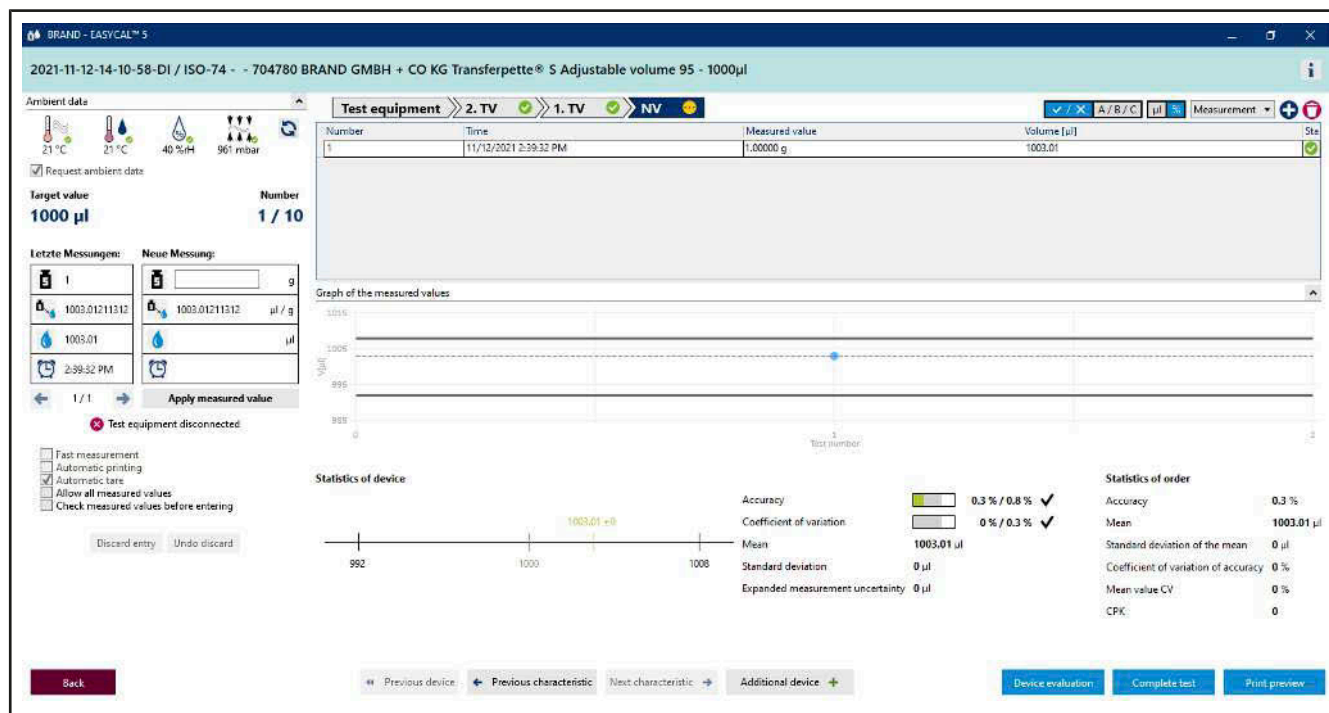

- l. We assume that you have made a typing error. To do this, enter 1.1 as the measured value, and confirm the environmental parameters. The following warning appears:

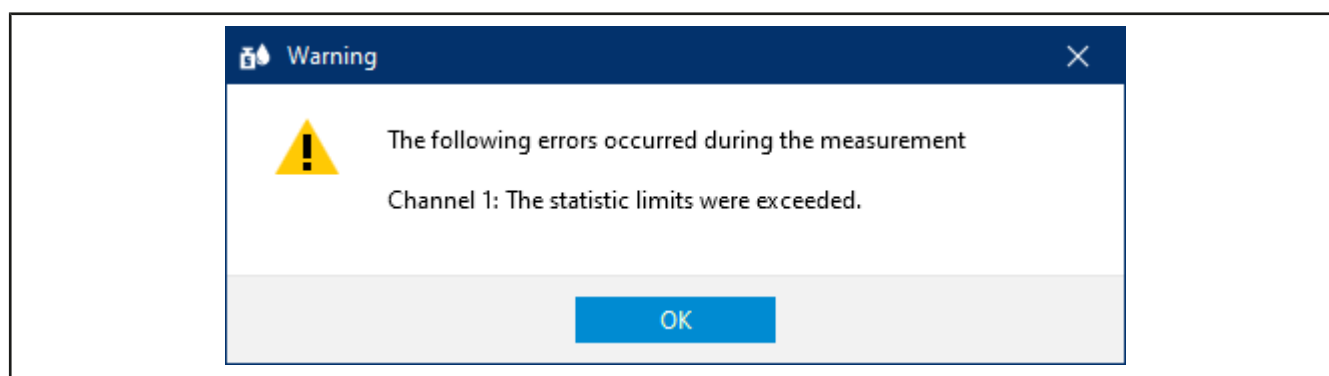

- m. Acknowledge this warning by clicking OK.

You can see that the different areas of the input screen react according to the new measured value. You cannot delete this measured value; however, you can discard it. The value remains visible but is no longer used for statistics.


The screenshot shows the EASYCAL 5 software interface. At the top, it displays the date and time: 2021-11-12-14-10-58-DI / ISO-74 - 704780 BRAND GMBH + CO KG Transferpette® S Adjustable volume 95 - 1000µl. Below this, there are tabs for 'Test equipment' (2. TV, 1. TV, NV) and a 'Measurement' dropdown menu. A table lists measurements with columns for Number, Time, Measured value, and Volume [µl]. The first measurement is 1, 11/12/2021 2:39:37 PM, 1.00000 g, 1003.01 µl. The second measurement is 2, 11/12/2021 2:40:16 PM, 1.10000 g, 1103.31 µl. Below the table, there is a 'Graph of the measured values' showing a line graph with two data points. To the left of the graph, there are checkboxes for 'Fast measurement', 'Automatic printing', 'Automatic tare', 'Allow all measured values', and 'Check measured values before entering'. A 'Discard entry' button is highlighted with a red box. To the right of the graph, there are 'Statistics of device' and 'Statistics of order' sections. The 'Statistics of device' section shows a mean value of 1053.16 µl and a standard deviation of 71 µl. The 'Statistics of order' section shows an accuracy of 5.3 % and a coefficient of variation of 6.73 %.

- n. Click on the number of the measurement in the table, and then click on “Discard entry”.

A message appears.


The screenshot shows a 'Discard measurements' dialog box. The dialog box has a title bar with a close button (X). The main text says 'Specify a reason to discard the selected measurements.' Below this text is a drop-down menu with the option 'identified as outliers' selected. At the bottom of the dialog box, there are two buttons: 'Cancel' and 'Continue'.

- o. Specify a reason (e.g., Identified as outliers.). You can also select a reason from the drop-down menu. These texts can be maintained in the master data. Confirm your selection by clicking on Continue.

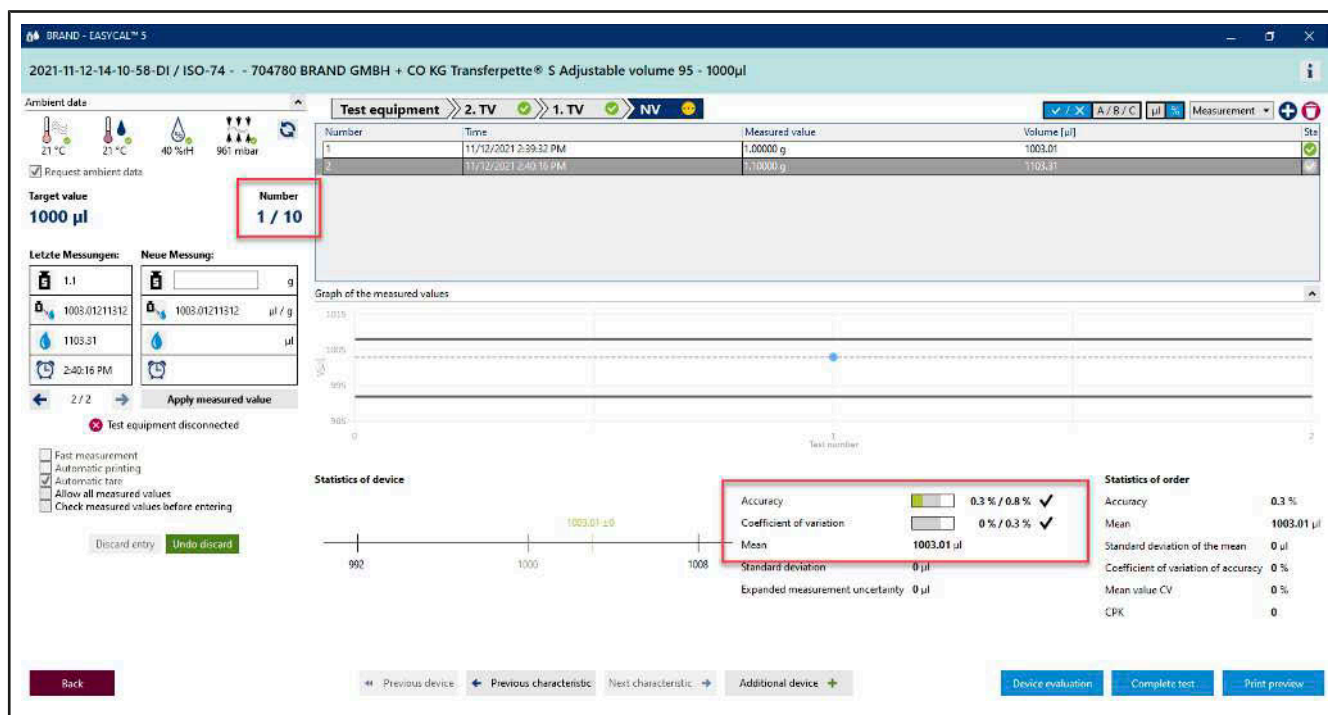

p. The measured value 1.1 is not considered further in the evaluation.

q. Continue entering measured values until 10/10 is displayed for “Number”. When the last required measured value is entered, the color in the section above the table changes from light blue to yellow. This signals to you that the order is complete.

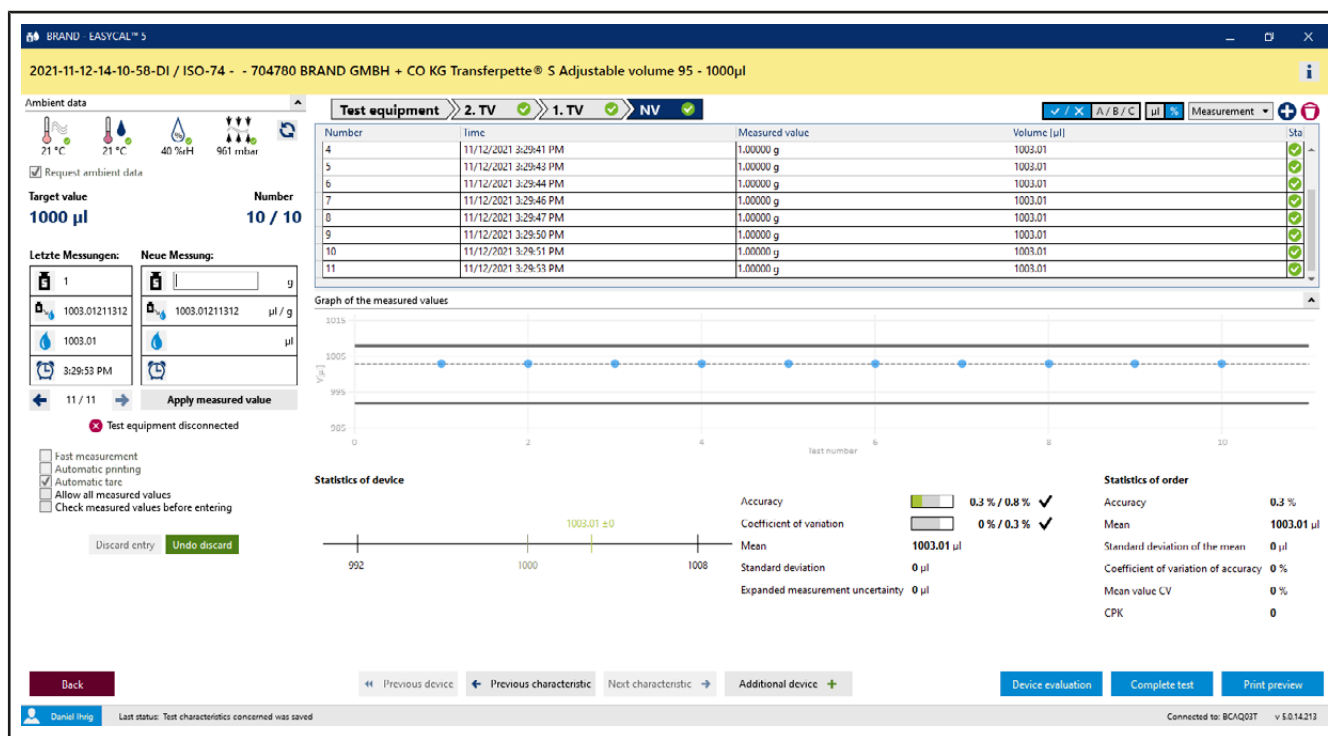

Furthermore, all characteristics in the progress bar are marked with a green check. The discarded measured value is highlighted in pink.

3.1.5 Complete test

The screenshot shows the EASYCAL™ 5 software interface. At the top, the title bar reads 'BRAND EASYCAL™ 5'. Below it, the header displays '2021-11-12-14-10-58-DI / ISO-74 - 704780 BRAND GMBH + CO KG Transferpette® S Adjustable volume 95 - 1000µl'. The main area is divided into several sections:

- Ambient data:** Shows temperature (21 °C), humidity (40 %rH), and pressure (961 mbar).
- Test equipment:** Displays '2. TV', '1. TV', and 'NV' with status indicators.
- Target value:** Set to '1000 µl'.
- Number:** Set to '10 / 10'.
- Letzte Messungen:** Shows the last measurement with a value of 1003.01 µl.
- Neue Messung:** Shows the new measurement with a value of 1003.01 µl.
- Table of measured values:** A table with columns for Number, Time, Measured value, and Volume [µl]. It lists 10 measurements, all with a measured value of 1003.01 µl.
- Graph of the measured values:** A line graph showing the measured values over time, with a mean value of 1003.01 µl.
- Statistics of device:** Shows accuracy (0.3 % / 0.8 %), coefficient of variation (0 % / 0.3 %), mean (1003.01 µl), standard deviation (0 µl), and expanded measurement uncertainty (0 µl).
- Statistics of order:** Shows accuracy (0.3 %), mean (1003.01 µl), standard deviation of the mean (0 µl), coefficient of variation of accuracy (0 %), mean value CV (0 %), and CPK (0).
- Buttons:** Includes 'Back', 'Previous device', 'Previous characteristic', 'Next characteristic', 'Additional device', 'Device evaluation', 'Complete test' (highlighted in red), and 'Print preview'.

a. Click on Complete test.

The screenshot shows the EASYCAL™ 5 software interface after clicking 'Complete test'. The title bar reads 'BRAND EASYCAL™ 5'. The header displays 'Order 2021-11-12-14-10-58-DI'. The main area is divided into several sections:

- Test type:** STD - standard values.
- Article:** 704780 - Transferpette® S Adjustable volume: 95 - 1000 µl.
- Order no.:** 2021-11-12-14-10-58-DI.
- Test plan:** 4437.0 - EC-STD-ISO-PIPip-var-LHDIV.
- Order type:** Individual test.
- Tester:** D. Ihrig.
- Lot size:** 1.
- Random sample size:** 1 / 1.
- Status:** Finished.
- Order no.:** [Empty field]
- Customer:** [Empty field]
- OC Number:** [Empty field]
- End customer:** [Empty field]
- Notes on the order:** [Empty field]
- Communication with the customer:** [Empty field]
- Test characteristic:** A table with columns for Test characteristic, Description, Target value, Mean, Tol target, Tol OK, Standard devi, A % target, A %, A % OK, CV % target, CV %, CV % OK, QS, CPK, Min CPK, and CPK OK. It lists 3 test characteristics: 1. TV, 1. TV, and NV.
- Device/calibration slip overview:** A table with columns for Calibration slip type, Internal no., Calibration slip no., Serial number, Article code, Conducted tests, Status, Device status, Tester, and Linked calibration slip. It lists 1 individual test with a status of 'Finished'.
- Buttons:** Includes 'Evaluation/release', 'Print internal log' (highlighted in red), 'Print certificates', 'New calibration slip', 'Back', 'Back to the order overview', and 'Save'.

b. You will now see the order with a summary of the measurements for the respective test characteristics. Click on Print internal log.

EASYCAL - Ergebnisse Prüfauftrag

BRAND GMBH + CO KG

Profil: Daniel Ihrig
Datum: 2021-11-12

1. Kopfdaten: Charge: PA-Nr: 2021-11-12-14-10-58-DI Losmenge: 1
Protart: STD - standard values
Artikel: 704780 Transferpette S Variabel 95 - 1000 µl

2. PA-Toleranzen: Fehlergrenze [µl] : Richtigkeit [µl] : 0 Variationskoeffizient [µl] : 3.0
CPK-Grenze: k-Wert: 0.00

3. PA-Status: **Finished** Version des Prüfbefehls: Nr. 20210708-RZ-01; Nr. 381000-11; Nr. 800028-12; Nr. 800030-15

4. PA-Ergebnisse:

Test characterist	n	Target value	MEAN	STDEV	A	CV	CPK	QR value
1	1	100 µl	100.30 µl	0.2 µl	0.1 %	0.0 %	0	0
2	1	500 µl	500.40 µl	0.10 µl	0.1 %	0.10 %	0	0
3	1	1000 µl	1000.01 µl	0.0 µl	0.2 %	0.20 %	0	0

5. Geräte-Ergebnisse: (mit Geräte-Toleranzen)

Device no.	Test characterist	Target value	Target accuracy	Target coefficient of variation	Mean	Standard deviation	Accuracy	Coefficient of variation
1	1	100 µl	5 %	3.0 %	100.30 µl	0.2 µl	0.1 %	0.0 %
2	2	500 µl	1.6 %	0.6 %	500.40 µl	0.10 µl	0.1 %	0.10 %

Back

c. You will see the certificate editor in view mode. Here you can print or export the stored report.

d. Exit the certificate editor by clicking Back.

Order 2021-11-12-14-10-58-DI

Test type: STD - standard values Article: 704780 - Transferpette S Adjustable volume: 95 - 1000 µl

Order no.: 2021-11-12-14-10-58-DI Test plan: 4437.0 - EC-STD-ISO-PIP-var-LHDIV

Order type: Individual test Tester: D. Ihrig

Lot size: 1

Random sample size: 1 / 1

Status: Finished

Order no.: Customer: OC-Number: End customer:

Notes on the order: Communication with the customer:

Test characteristic:

Test characteristic	Description	Target va	Mean	Tol target	Tol OK	Standard devi	A% targ	A% OK	CV% targ	CV% OK	CV% OK OS	CPK	Min CPK	CPK OK
1	2. TV	100 µl	100.3 µl	OK	0 µl	0.2 µl	0.1 %	0.1 %	0.3 %	0.0 %	0.0 %	0	0	OK
2	1. TV	500 µl	500.4 µl	OK	0.80 µl	1.6 %	0.1 %	0.1 %	0.6 %	0.10 %	0.10 %	0	0	OK
3	NV	1000 µl	1000.01 µl	OK	0 µl	0.0 %	0.3 %	0.2 %	0.3 %	0.0 %	0.0 %	0	0	OK

Device/calibration slip overview

Calibration slip type	Internal no.	Calibration slip no.	Serial number	Article code	Conducted tests	Status	Device status	Tester	Linked calibration slip
Individual test	13014	ISO / 74	704780	30	Finished			D. Ihrig	

Evaluation/release Print internal log Print certificates New calibration slip

Back Back to the order overview Save

e. Click on Evaluation/release.

Evaluation/release

Current status

Finished

New status

Released

Remarks

☒ Apply to all

Cancel

Save

f. In the window that opens, select Released, and confirm the entry with Saving....

BRAND EASYCAL™ 5

Order 2021-11-12-14-10-58-DI

Test type

STD – standard values

Article

704780 - Transferpette® 5 /adjustable volume; 95 - 1000 µl

Notes on the order

Communication with the customer

Order no.

2021-11-12-14-10-58-DI

Test plan

4437.0 - EC-STD-ISO-PIpip-var-LHDiv

Order type

Individual test

Tester

D. Ihrig

Lot size

1

Random sample size

1 / 1

Order no.

Customer

Status

Released

OC-Number

End customer

Test characteristic

Test characteristic	Description	Target	Mean	Tol target	Tol OK	Standard devi	A% target	A% OK	CV% target	CV% OK	CV% OK	OS	CPK	Min CPK	CPK OK
1	2. IV	100µl	100.3 µl		OK	0 µl	8 %	0 %	OK	3 %	0 %	0 %	OK	0	OK
2	1. IV	500µl	500.4 µl		OK	0.88 µl	1.6 %	0.1 %	OK	0.6 %	0.18 %	0.18 %	OK	0	OK
3	NV	1000µl	1003.01 µl		OK	0 µl	0.8 %	0.3 %	OK	0.3 %	0 %	0 %	OK	0	OK

Device/calibration slip overview

Calibration slip type	Internal no.	Calibration slip no.	Serial number	Article code	Conducted tests	Status	Device status	Tester	Linked calibration slip
Individual test	13014	ISO-74		704780	30	Released		D. Ihrig	

Evaluation/release

Print internal log

Print certificates


New calibration slip

Back


Back to the order overview

Save

g. Click on Print certificates.

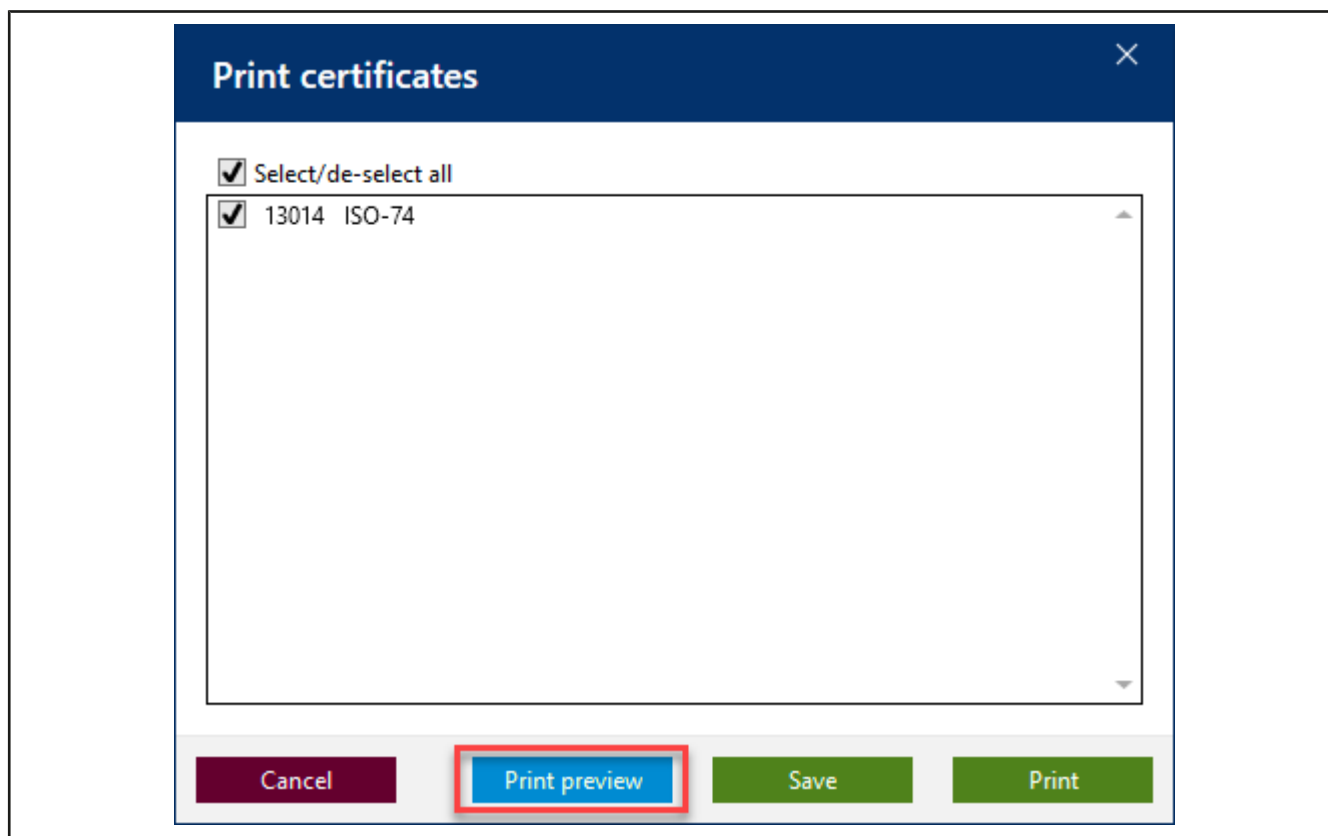


h. Click the check-box, and then click Print preview.

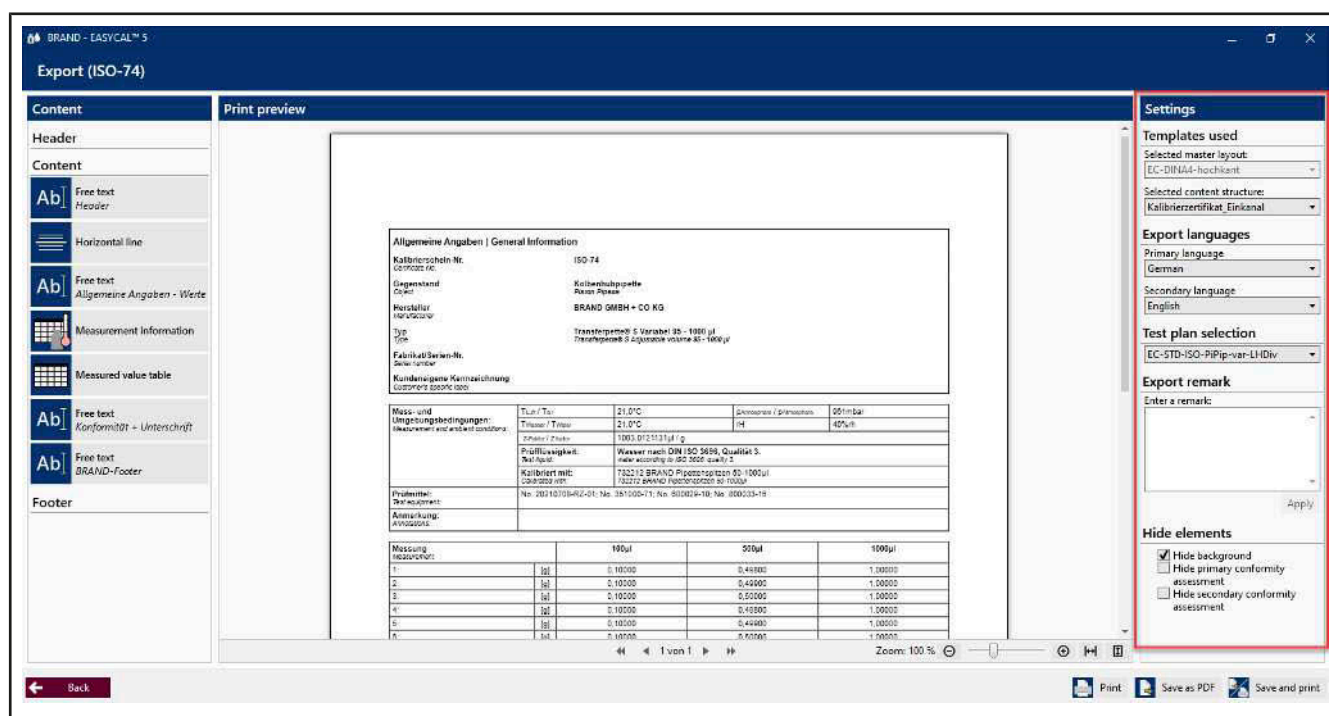

➤ The certificate editor opens in Print preview mode. You can still make settings in the right section and enter export annotations depending on the selected content structure.




- i. Here you can also export the certificate as a PDF or print a hard copy. By clicking on Back, you leave the Print preview.

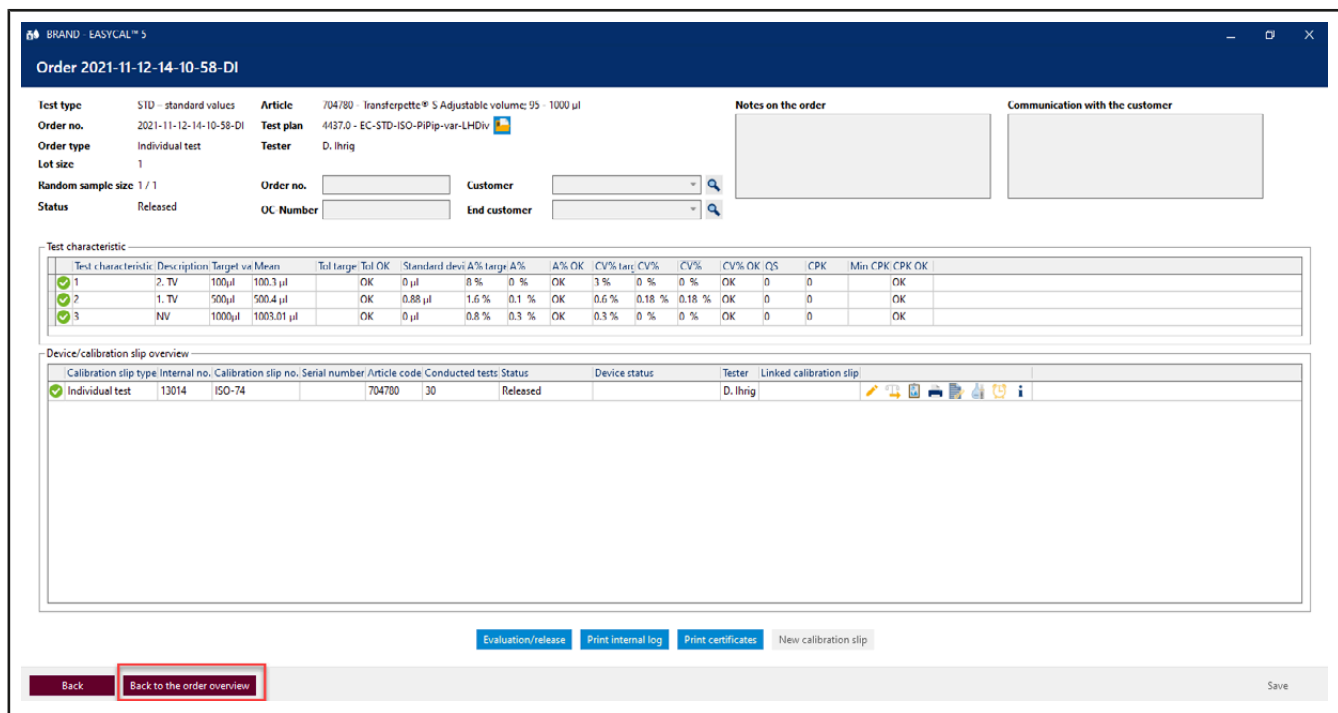

- j. Click on Back to the order overview

- k. From here you can create additional jobs and start tests. By clicking on Back, you can return to the main menu.

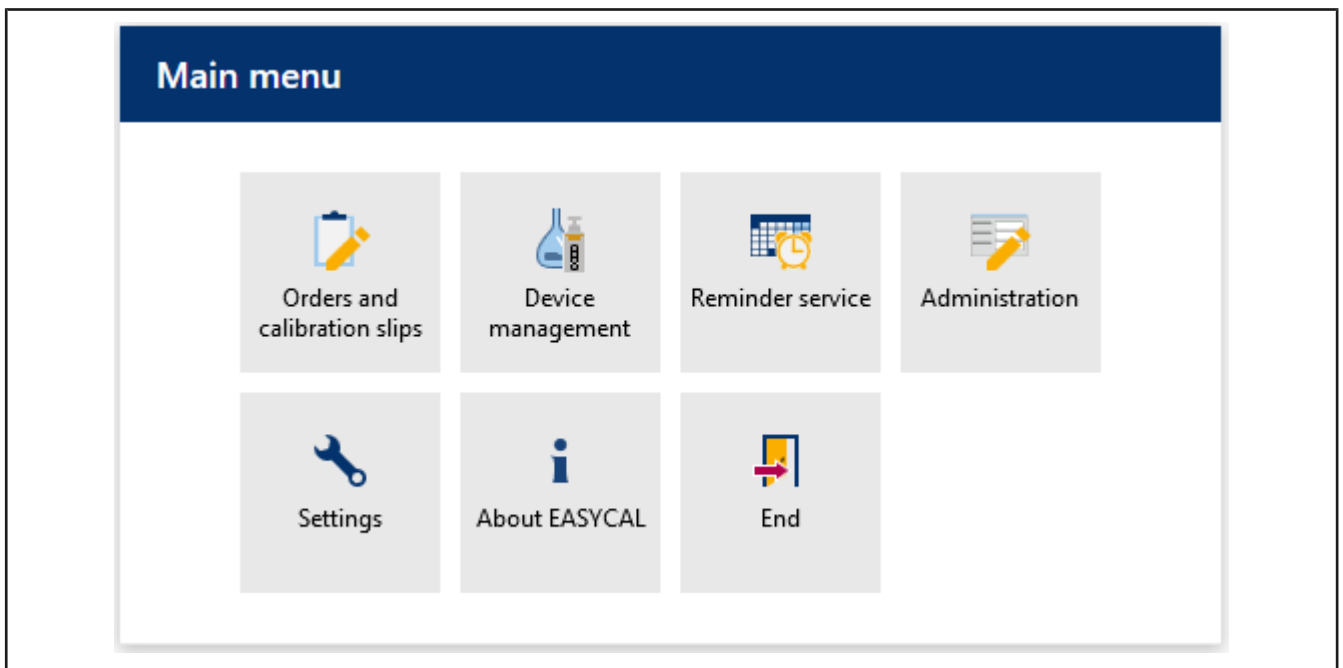

➤ This is where this tutorial ends.

Mentions légales

BRAND GMBH + CO KG

Otto-Schott-Str. 25

97877 Wertheim (Germany)

T +49 9342 808 0

F +49 9342 808 98000

info@brand.de

www.brand.de

Do you need more operating manuals and translations?

Please refer to <http://www.brand.de/om> or use the following Quick

Response Code:



The original operating manual is in German. Les autres langues sont des traductions du mode d'emploi original.

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression.

Table des matières

1	Remarques préliminaires.....	66
2	Installation.....	67
3	Mise en route dans EASYCAL™ 5	77
3.1	Tutoriel.....	77
3.1.1	Configurer la balance comme moyen de contrôle	77
3.1.2	Créer un ordre	78
3.1.3	Définir le moyen de contrôle	82
3.1.4	Réalisation du contrôle.....	82
3.1.5	Terminer le contrôle	90

1 Remarques préliminaires


Ce tutoriel est conçu pour vous aider à utiliser EASYCAL™ 5 pendant votre période d'essai de 30 jours. Ici, vous apprendrez comment remplir différentes zones de EASYCAL™ 5, effectuer le premier test de l'appareil et imprimer un certificat en utilisant une procédure exemplaire.

Veuillez noter qu'au cours de cette introduction, des exemples de données seront générés dans la base de données et ne pourront pas être supprimés ultérieurement. Nous vous recommandons de coordonner cela avec les exigences réglementaires de votre système de gestion de la qualité.

2 Installation


Prérequis:

- ✓ Vous avez déjà reçu le fichier d'installation de EASYCAL™ 5, EasyCal-Setup.exe, de la page d'accueil DE LA MARQUE et l'avez enregistré localement.
 - ✓ Vous avez reçu une licence de démonstration (ticket) par email.
 - ✓ Vous disposez des droits d'administrateur local et disposez d'une connexion Internet existante.
- a. Démarrez l'installation en ouvrant EasyCal-Setup.exe et suivez les instructions de l'assistant d'installation.

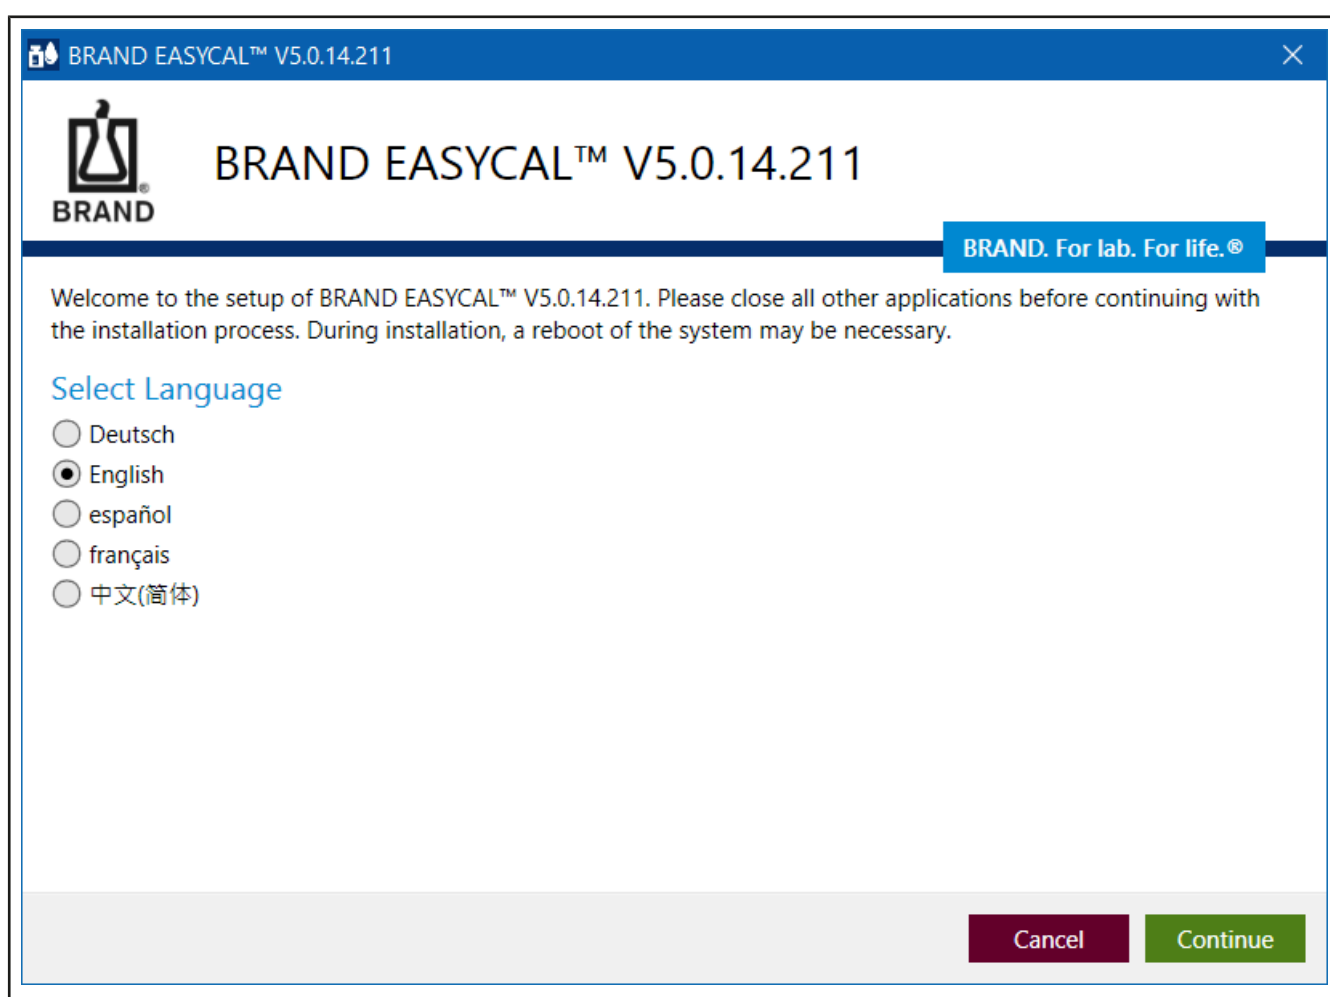


➔ EASYCAL™ 5 et tous les composants logiciels nécessaires au fonctionnement sont installés sur votre PC.

b. Une fois l'installation terminée, commencez EASYCAL™ 5 par cocher la case et Terminer cliquez sur.

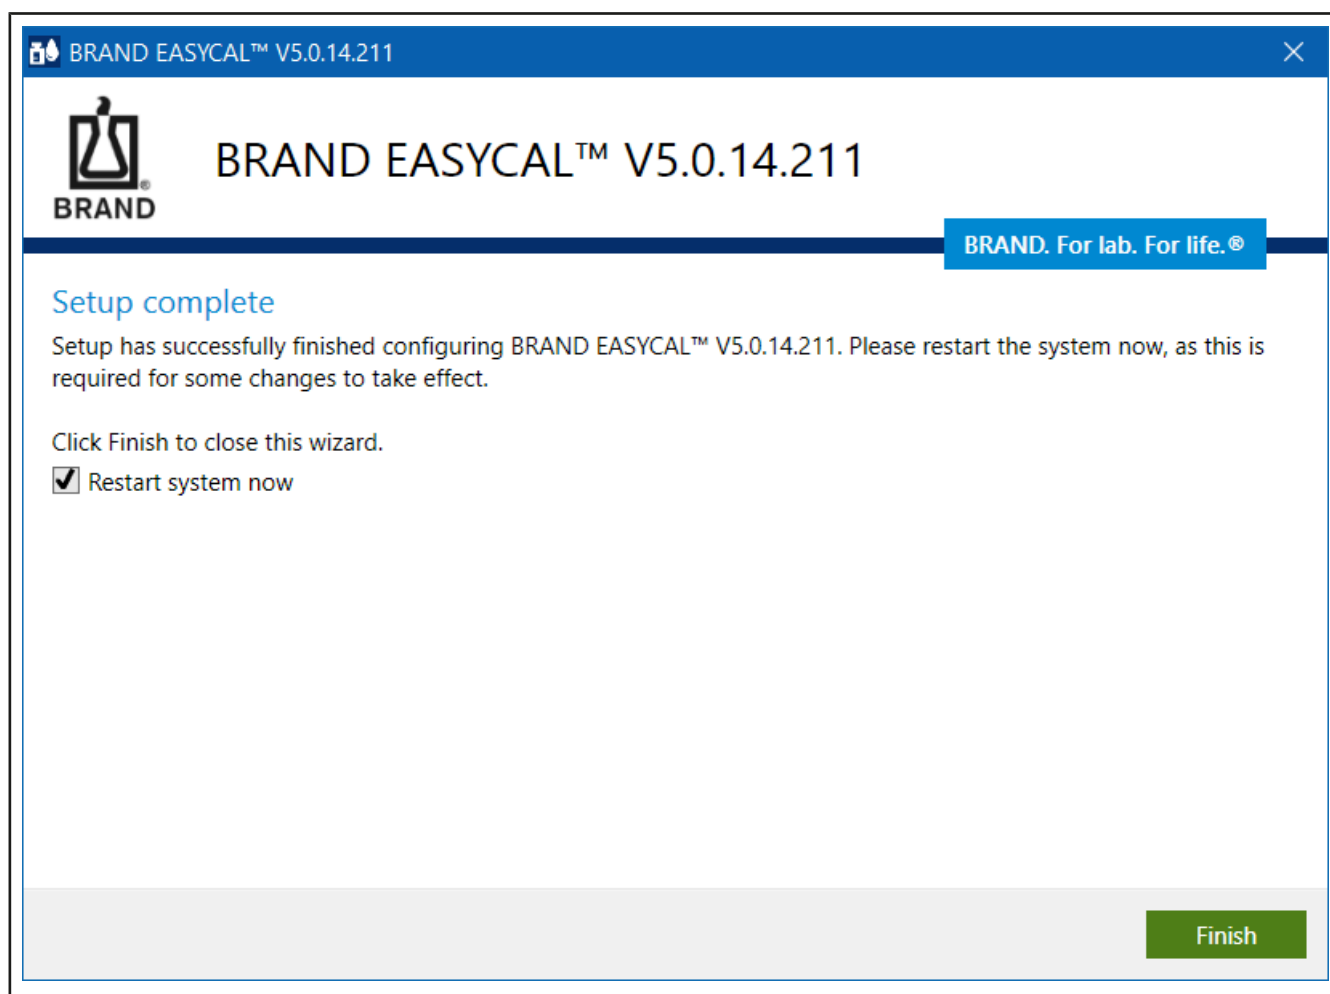


c. Vous êtes invité à EASYCAL™ 5 activer.

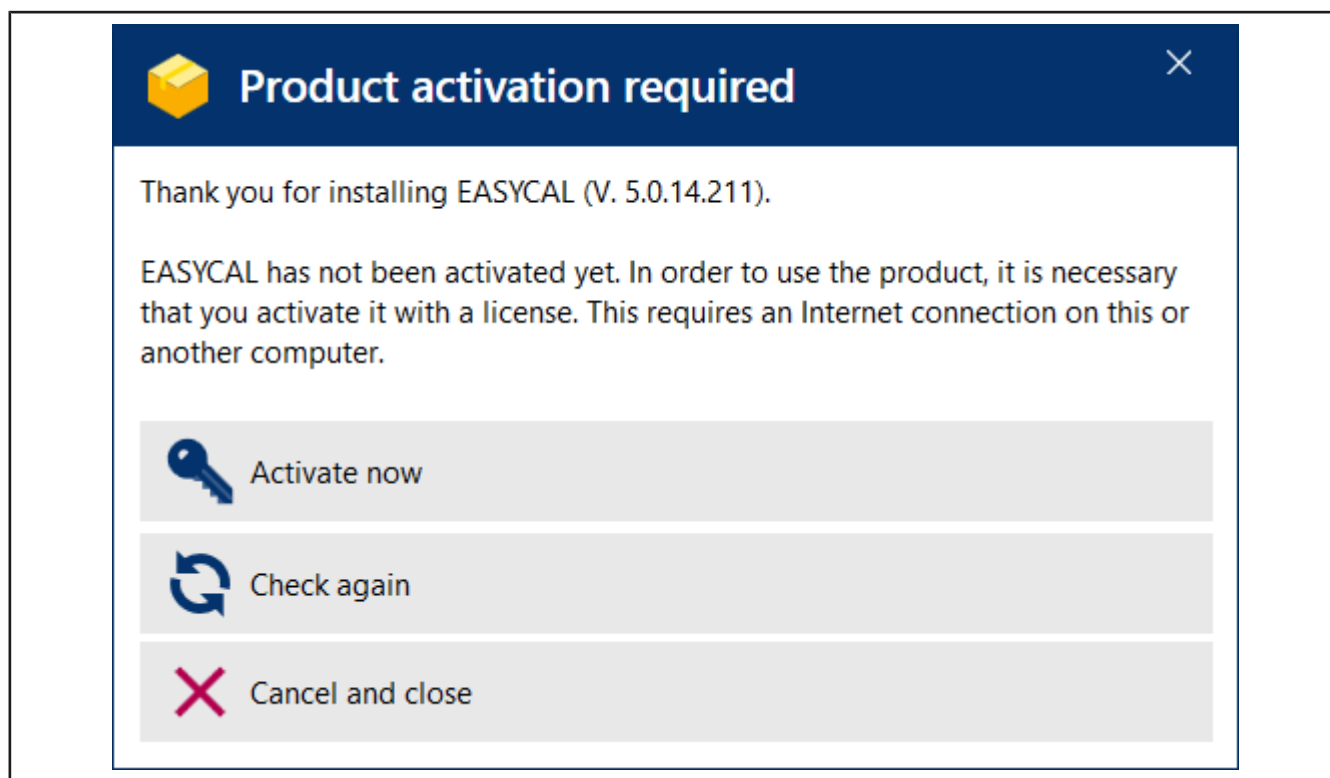

d. Cliquez sur Activer maintenant.

→ Votre navigateur Web par défaut s'ouvre avec la page <https://license.brand.de/index.php>.

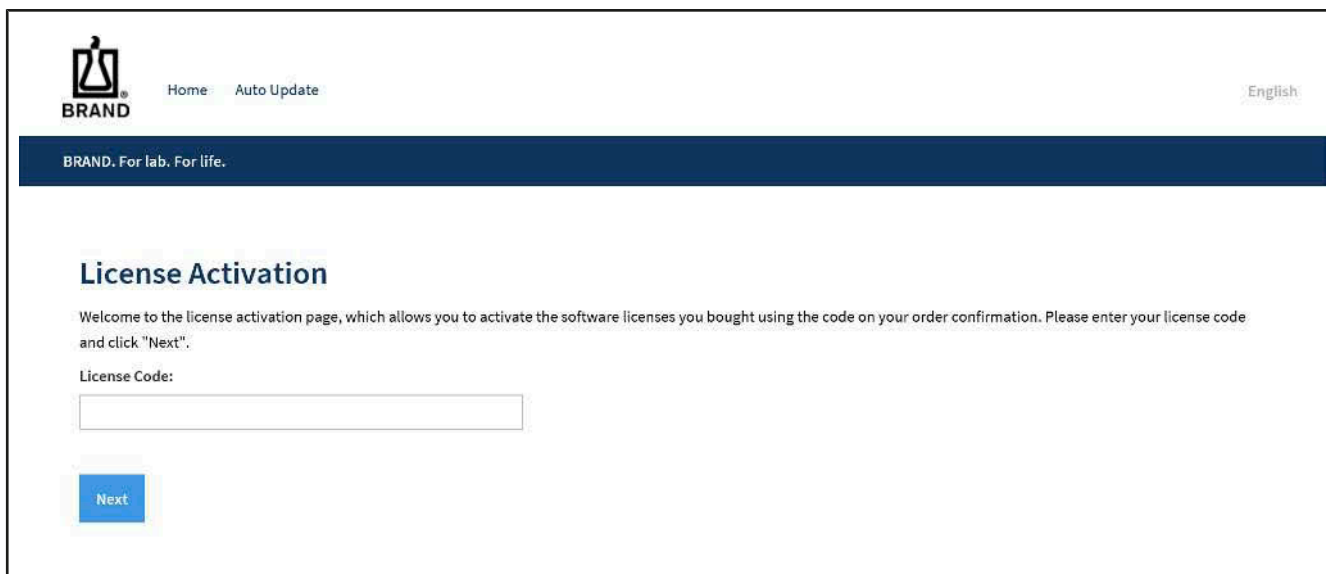

BRAND Home Auto Update English

BRAND. For lab. For life.


License Activation

Welcome to the license activation page, which allows you to activate the software licenses you bought using the code on your order confirmation. Please enter your license code and click "Next".

License Code:

Next

e. Saisissez votre ticket (= clé de licence) ici.

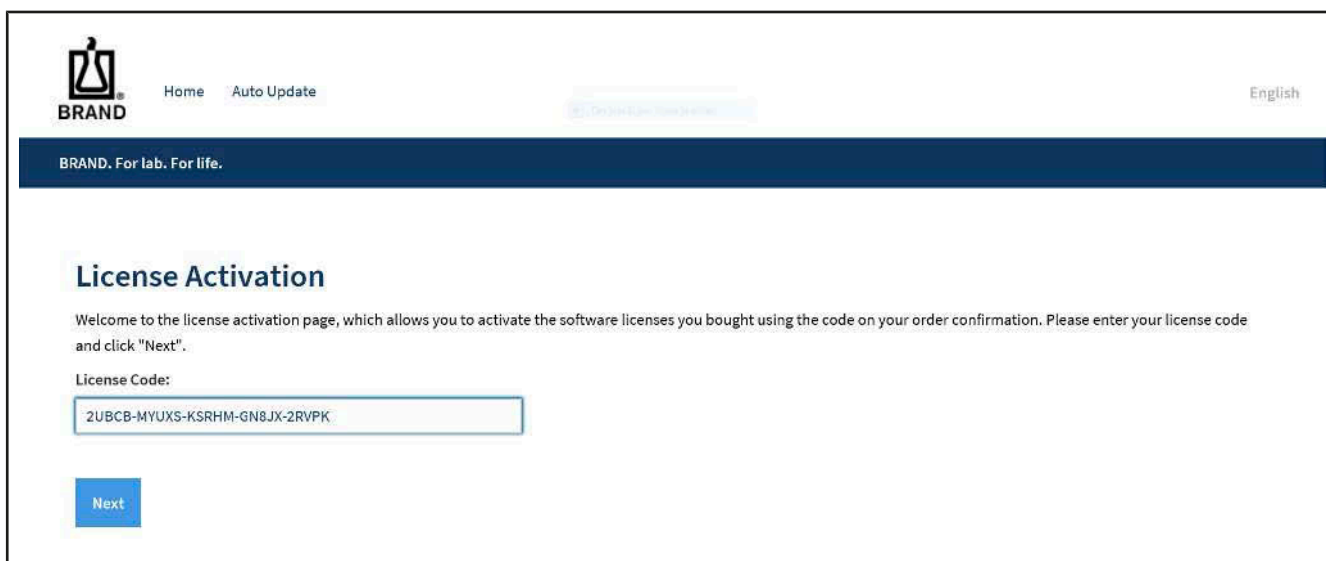

BRAND Home Auto Update English

BRAND. For lab. For life.


License Activation

Welcome to the license activation page, which allows you to activate the software licenses you bought using the code on your order confirmation. Please enter your license code and click "Next".


License Code:

Next

f. Cliquez sur Continuer.

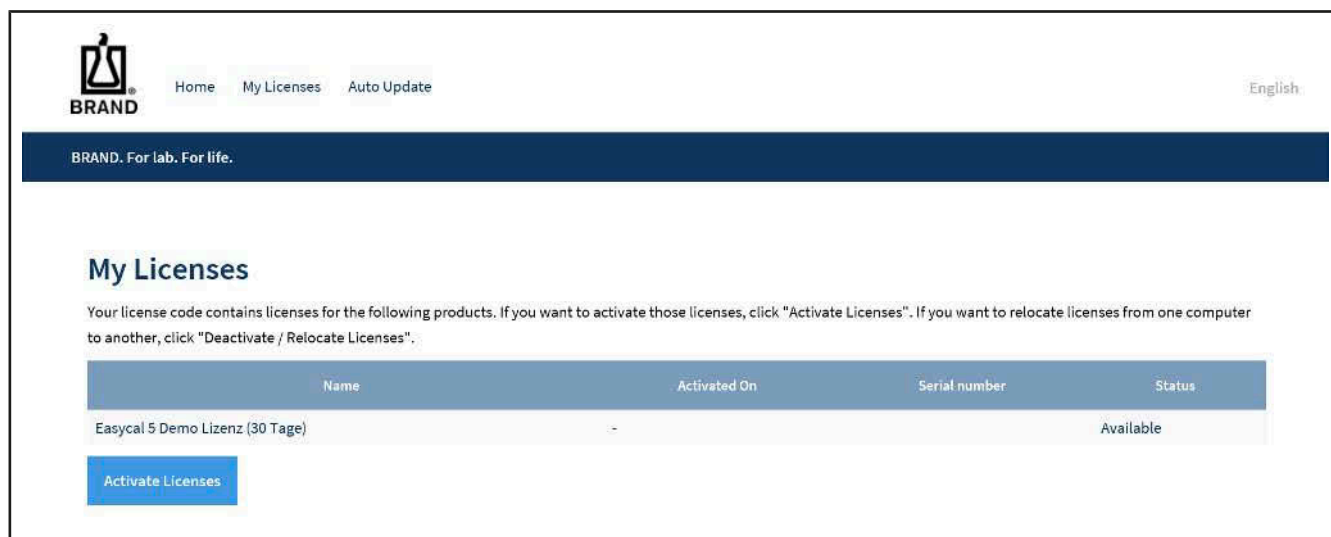

g. Cliquez sur Activer la licence.

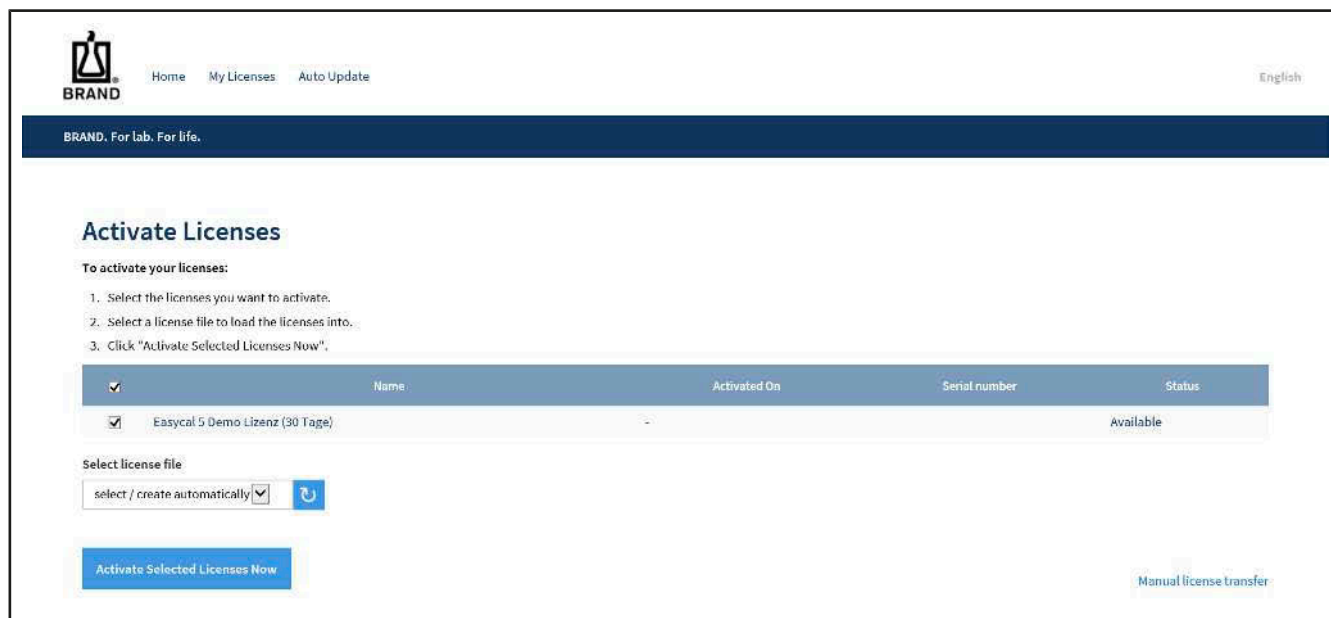

h. Ne modifiez aucun des paramètres, cliquez sur Activer maintenant les licences sélectionnées.

↪ Le transfert de licence en ligne est en cours.

Online License Transfer

Starting license transfer.
 Downloading license template.
 Registering license template.
 Creating license request.
 Downloading license update.
 Importing license update into target.
 Creating receipt.
 Uploading receipt.



License transfer completed successfully!

OK

i. Cliquez sur OK.



Home My Licenses Auto Update

English

BRAND. For lab. For life.

My Licenses


Your license code contains licenses for the following products. If you want to activate those licenses, click "Activate Licenses". If you want to relocate licenses from one computer to another, click "Deactivate / Relocate Licenses".

Name	Activated On	Serial number	Status
Easycal 5 Demo Lizenz (30 Tage)	2021-11-15 10:28:54	130-1018824202	Activated


Deactivate / Relocate Licenses

j. La licence est activée. Vous pouvez fermer la fenêtre du navigateur.


k. Accédez à la fenêtre activation du produit.

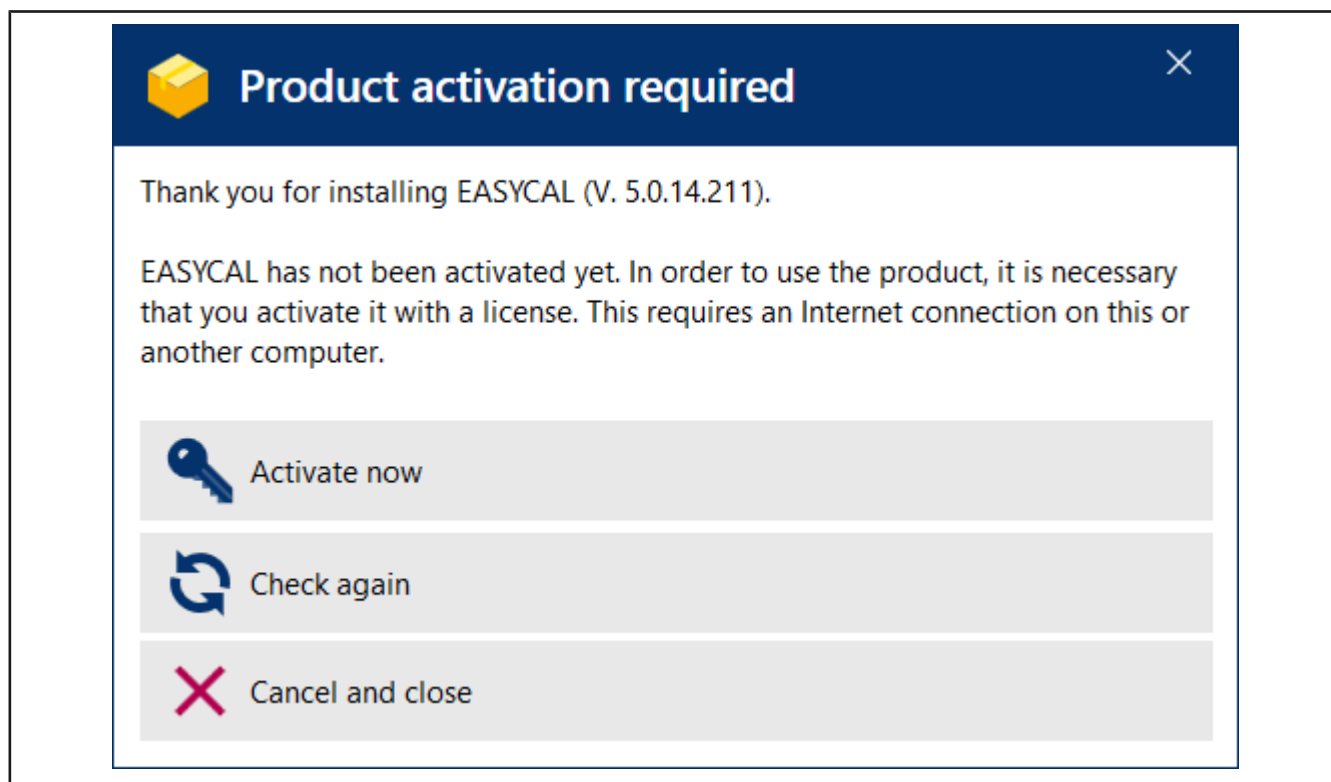


l. Cliquez sur « revérifier ».

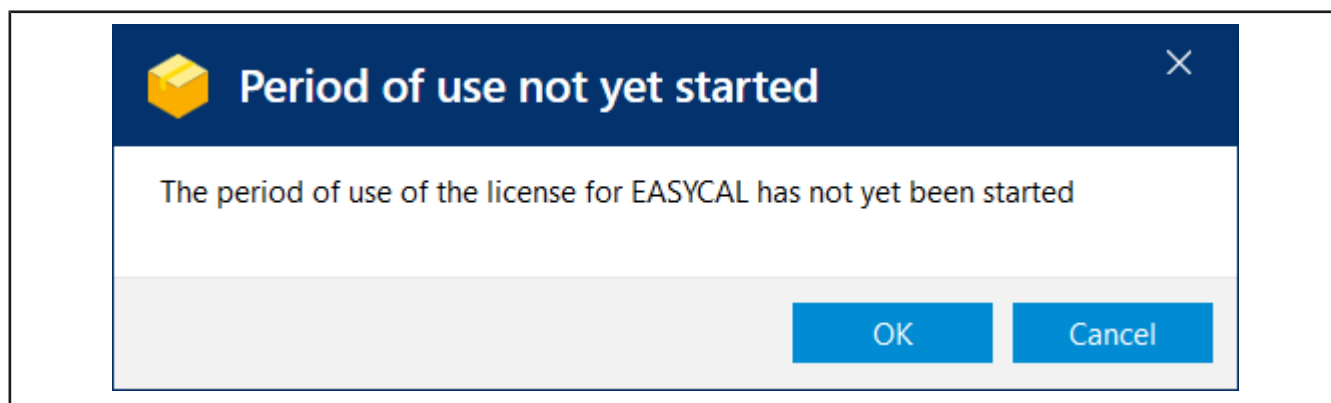


m. Cliquez sur pour OKdémarrer la période d'utilisation. Un message apparaît.

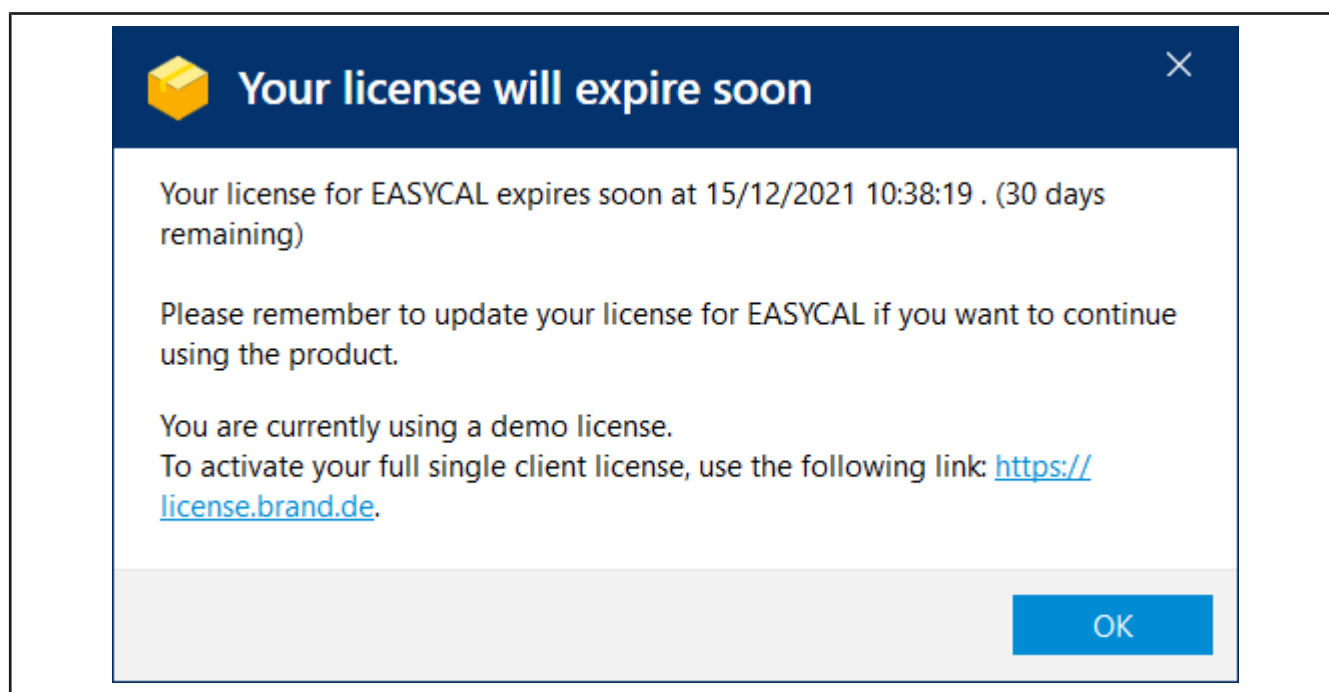


- n. Cliquez sur OK.
- o. Parallèle EASYCAL™ 5 et une notification s'affiche.

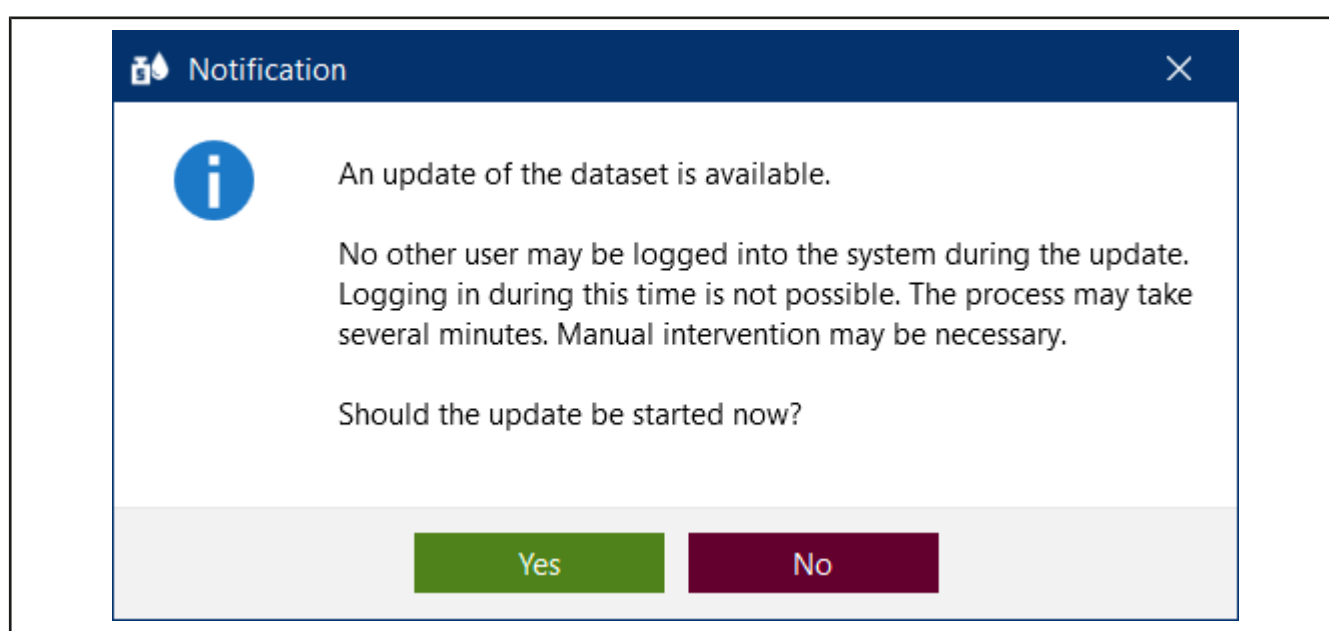


- p. Accuser réception de la notification en cliquant sur Oui pour que la base de données soit initialement remplie.
- q. Une notification apparaîtra après un court laps de temps.

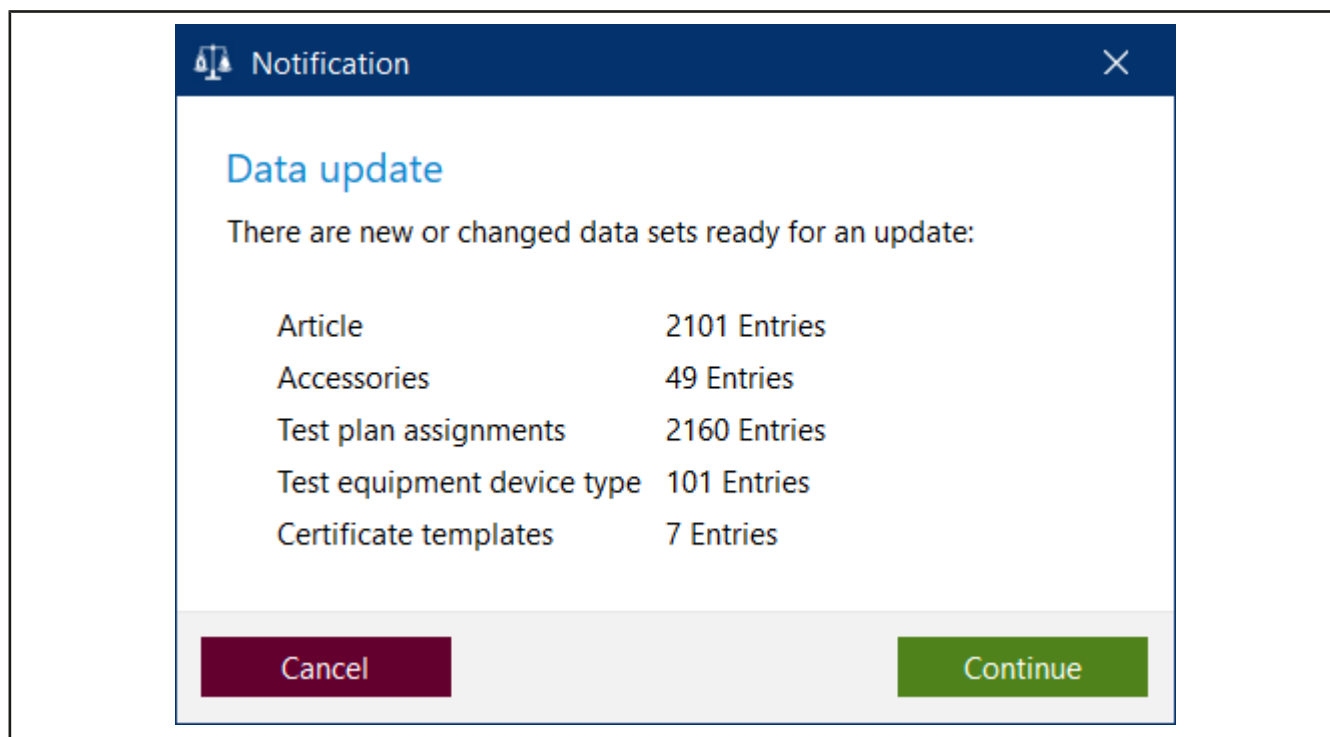


r. Acquiescez notification en cliquant sur Continuer.

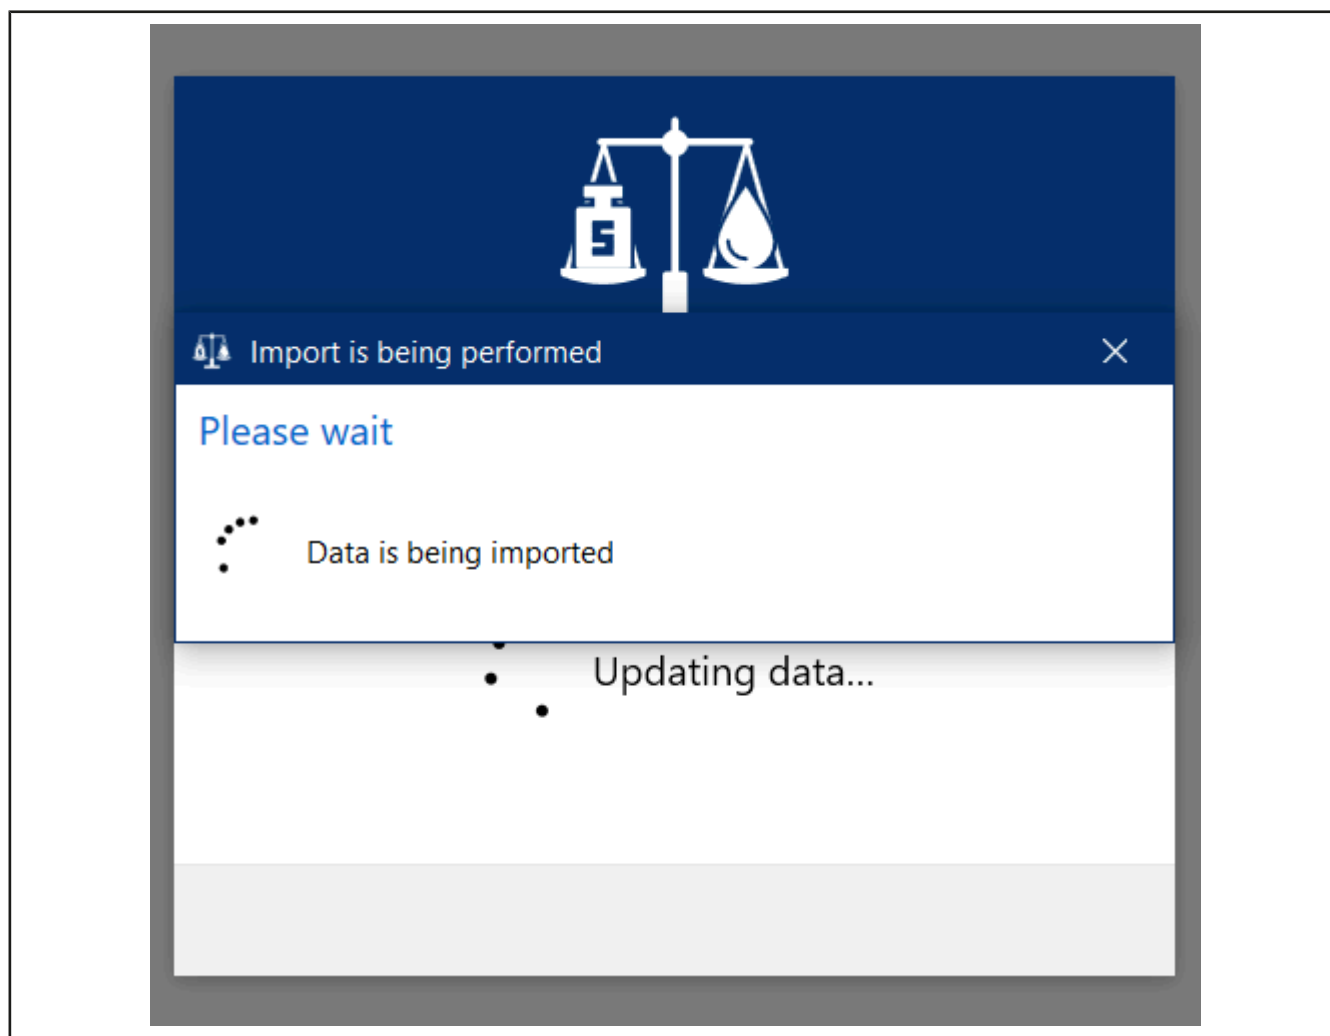

- s. Les nouvelles données sont importées et la progression est affichée.

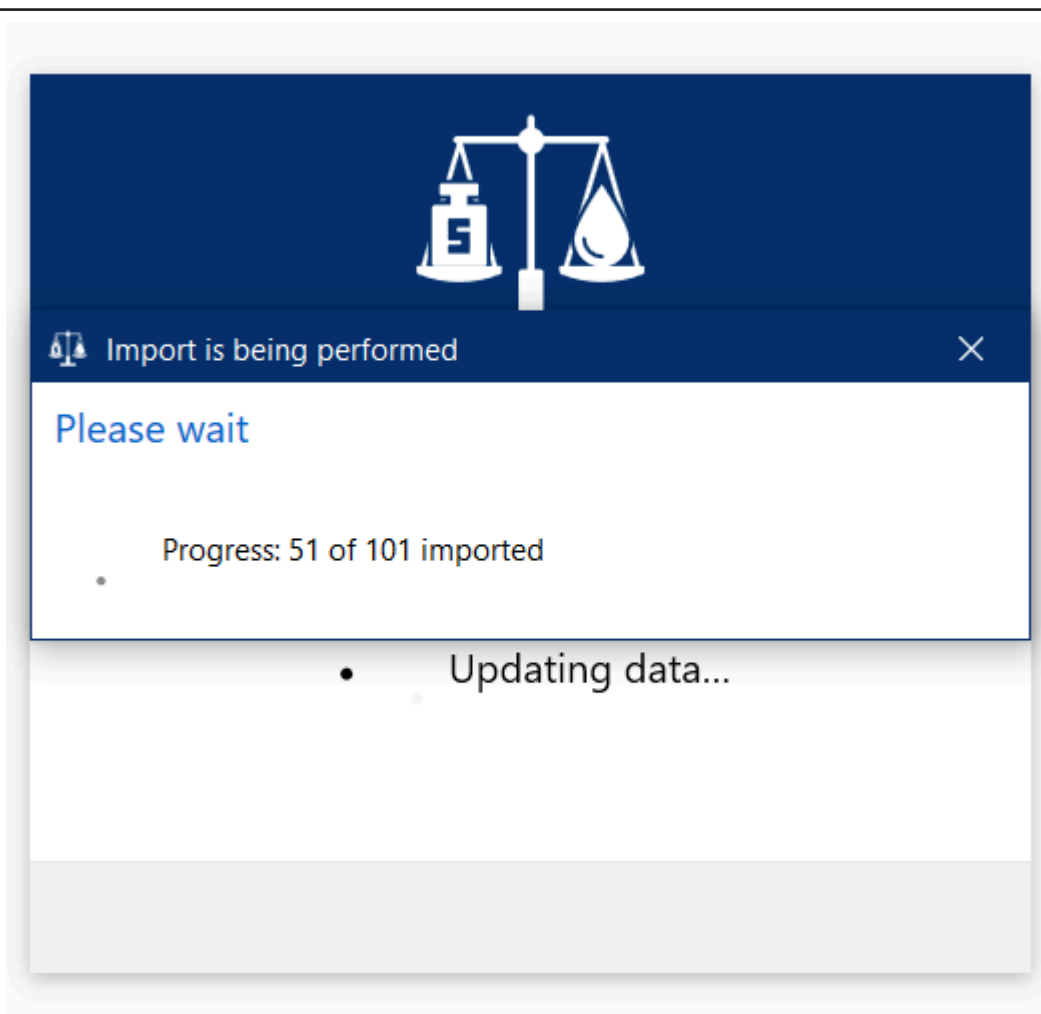


- Après un certain temps, une notification apparaît indiquant que la mise à jour est terminée.

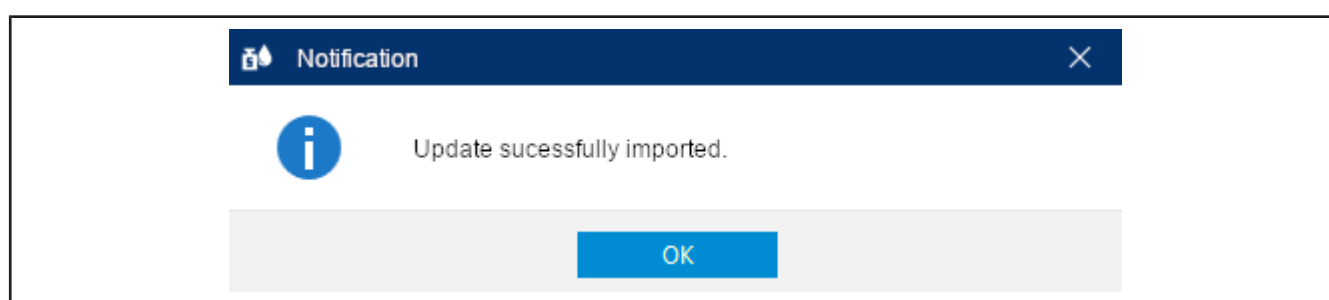

- t. Acquittez notification en cliquant sur OK.

- EASYCAL™ 5 démarrage. Plusieurs messages s'affichent pour indiquer la progression.

- Un avertissement s'affiche indiquant que vous utilisez une version de démonstration. Lisez les notes.

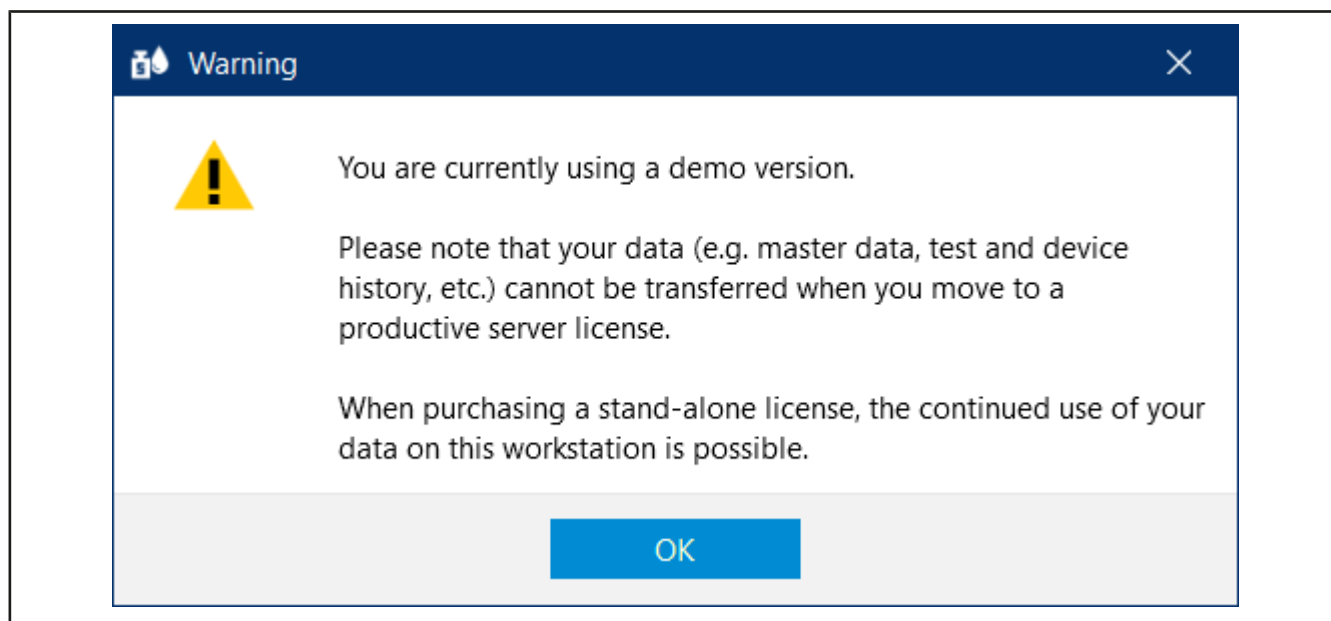

- u. Après avoir accusé réception de l'avertissement, vous êtes EASYCAL™ 5 prêt à tester.
- ➔ Vous serez automatiquement connecté en tant que "EASYCAL Admin". Notez que les EASYCAL™ 5 démarre toujours en mode mono-utilisateur après l'installation. Vous pouvez modifier cela plus tard dans les "Paramètres globaux", mais vous ne devriez pas le faire pour le moment.

3 Mise en route dans EASYCAL™ 5

3.1 Tutoriel

Cet exemple montre le déroulement d'un examen - de la création d'un ordre à l'impression du certificat, en passant par le contrôle. Cette section se réfère aux données de base disponibles dans la licence de démonstration et sert de première introduction au programme.

Inscription

Si le programme EASYCAL™ 5 est lancé, une boîte de dialogue de connexion apparaît. C'est ici que l'utilisateur se connecte avec son nom d'utilisateur et son mot de passe.

3.1.1 Configurer la balance comme moyen de contrôle

Pour configurer une balance comme moyen de contrôle, procédez comme suit. La configuration s'effectue toujours dans l'ordre suivant : configurer les moyens de contrôle dans les données de base, configurer les moyens de contrôle au poste de travail et sélectionner les moyens de contrôle pour les ordres.

Prérequis:

- ✓ Vous avez connecté une balance à votre poste de travail.
 - ✓ Vous connaissez les paramètres de connexion de la balance.
 - ✓ Vous savez à quel port COM la balance est connectée sur le poste de travail.
- a. Nommez l'échelle, voir Administration > Gestion des données de base > Moyens de contrôle > Moyens de contrôle.
 - b. Aménager un lieu pour les moyens de contrôle (si ce n'est pas déjà fait)
 - c. Configurer la balance comme moyen de contrôle, voir Type d'appareil de contrôle. Pour cela, vous spécifiez aussi bien la fonction que la connexion de la balance au poste de travail, voir Fonction de mesure, Communication.

Quitter ce menu. Passer au menu Réglages .

- d. Enregistrer la balance comme moyen de contrôle au poste de travail, voir Réglages > Paramètres du poste de travail > Moyens de contrôle.
- e. Sélectionner la balance et la connexion pour le poste de travail. En outre, vous pouvez tester la connexion à la balance.

Quitter ce menu. Passer au menu Ordres et certificats d'étalonnage.

- f. Vous pouvez sélectionner la balance connectée dans l'ordre lors de la sélection du moyen de contrôle. Dans le didacticiel, voir Définir le moyen de contrôle, p. 82, dans le manuel d'utilisation sous Choisir le moyen d'essai pour le contrôle.

3.1.2 Créer un ordre

a. Naviguez de Menu principal à Ordres et certificats d'étalonnage.

Ordres et certificats d'étalonnage

Filtre pour type de contrôle: Aucune indication Rechercher: de: 05/09/2022 à: 20/09/2022

Aperçu de l'ordre: Certificats d'étalonnage

ID	Type de contrôle	Numéro d'ordre	Numéro d'article	Article	Date de l'étalo	État
8	STD	2022-09-16-10-00-12-EA	5	EC-27316 - Pipette graduée Type 3 BLAUBRAND® ETERNA écoulement classe AS Zéro en haut 0,01 - 1 ml	Aucune donnée	Cré
7	STD	2022-09-15-16-43-04-EA		EC-704780 - Transferpette® S (jusqu'en 2019) Variable 100 - 1000 µl	16/09/2022	En
6	STD	2022-09-15-08-59-33-EA		EC-704780 - Transferpette® S (jusqu'en 2019) Variable 100 - 1000 µl	16/09/2022	En
5	STD	2022-09-15-08-19-11-EA		EC-704780 - Transferpette® S (jusqu'en 2019) Variable 100 - 1000 µl	15/09/2022	En
4	STD	2022-09-14-17-57-57-EA		EC-704780 - Transferpette® S (jusqu'en 2019) Variable 100 - 1000 µl	Aucune donnée	Cré
3	STD	2022-09-14-16-05-37-EA		EC-704780 - Transferpette® S (jusqu'en 2019) Variable 100 - 1000 µl	14/09/2022	En
2	STD	2022-09-14-16-02-03-EA		EC-704780 - Transferpette® S (jusqu'en 2019) Variable 100 - 1000 µl	14/09/2022	En

[Retour](#) [Certificats de lots - Recherche et impression](#) [Contrôle des appareils individuels](#) [Créer un ordre](#) [Ouvrir](#)

b. Cliquez sur Créer un ordre.

Sélectionner le type d'ordre

Contrôle du lot

Utilisation lors du contrôle d'échantillons (taille au choix).
Des certificats de lot sont sortis.

Contrôle individuel

Utilisation pour contrôle 100% ou contrôle d'un appareil individuel.
Chaque appareil contient un propre certificat.

[Retour](#)

c. Cliquez sur Contrôle individuel.

- d. Sur Type de contrôle, sélectionnez la valeur STD - Normwerte.

Les types de contrôle organisent vos méthodes de contrôle. Vous ne pouvez pas créer de catégories de contrôle supplémentaires, mais devez choisir parmi les catégories de contrôle déjà enregistrées. Les plans de contrôle et les modèles de certificats sont liés au type de contrôle. Dans la gestion des utilisateurs, il faut donner à l'utilisateur l'autorisation correspondante pour le type de contrôle en question. Comme vous êtes actuellement connecté en tant qu'administrateur global, vous avez accès à toutes les données.

Contrôle individuel - Créer un ordre

Type de contrôle: **STD - Valeurs standard** | Nombre d'appareils: **1** | Client: [Sélectionner]

N° de l'ordre d'achat: [Sélectionner]

Code d'article: [Sélectionner] | Numéro AB: [Sélectionner]

Article: [Sélectionner]

Plages de volume: [Sélectionner]

Plan de contrôle: [Sélectionner]

Remarques sur l'ordre: [Saisir]

Client final: [Sélectionner]

Retour | Démarrer le contrôle

- e. Cliquez sur le bouton  à Code d'article pour afficher les articles déjà créés.

Contrôle individuel - Créer un ordre

Type de contrôle: **STD - Valeurs standard** | Nombre d'appareils: **1** | Client: [Sélectionner]

N° de l'ordre d'achat: [Sélectionner]

Code d'article: [Sélectionner] | Numéro AB: [Sélectionner]

Article: [Sélectionner]

Plages de volume: [Sélectionner]

Plan de contrôle: [Sélectionner]

Retour

Sélectionner des articles

Rechercher: [Saisir]

Code d'article	Version	Fabricant	Produit	Variation de produit	Plage de volume	État
→ EC-12484	0	BRAND GMBH + CO KG	Burette	BLAUBRAND®, robinet droit, Schilling, classe AS	0,02 - 10 ml	Déverrouillé
→ EC-12487	0	BRAND GMBH + CO KG	Burette	BLAUBRAND®, robinet droit, Schilling, classe AS	0,05 - 25 ml	Déverrouillé
→ EC-12488	0	BRAND GMBH + CO KG	Burette	BLAUBRAND®, robinet droit, Schilling, classe AS	0,1 - 50 ml	Déverrouillé
→ EC-13844	0	BRAND GMBH + CO KG	Burette	BLAUBRAND®, robinet latéral, Schilling, classe AS	0,02 - 10 ml	Déverrouillé
→ EC-13847	0	BRAND GMBH + CO KG	Burette	BLAUBRAND®, robinet latéral, Schilling, classe AS	0,05 - 25 ml	Déverrouillé
→ EC-13848	0	BRAND GMBH + CO KG	Burette	BLAUBRAND®, robinet latéral, Schilling, classe AS	0,1 - 50 ml	Déverrouillé
→ EC-13913	0	BRAND GMBH + CO KG	Burette compacte	BLAUBRAND®, classe AS	0,02 - 10 ml	Déverrouillé
→ EC-13916	0	BRAND GMBH + CO KG	Burette compacte	BLAUBRAND®, classe AS	0,05 - 25 ml	Déverrouillé
→ EC-13918	0	BRAND GMBH + CO KG	Burette compacte	BLAUBRAND®, classe AS	0,1 - 50 ml	Déverrouillé
→ EC-13963	0	BRAND GMBH + CO KG	Burette compacte	BLAUBRAND®, classe AS, marron	0,02 - 10 ml	Déverrouillé
→ EC-13966	0	BRAND GMBH + CO KG	Burette compacte	BLAUBRAND®, classe AS, marron	0,05 - 25 ml	Déverrouillé
→ EC-13968	0	BRAND GMBH + CO KG	Burette compacte	BLAUBRAND®, classe AS, marron	0,1 - 50 ml	Déverrouillé
→ EC-22521	0	BRAND GMBH + CO KG	Burette à zéro automatique	BLAUBRAND®, de Pellet, sans robinet intermédiaire, classe AS	0,02 - 10 ml	Déverrouillé
→ EC-22522	0	BRAND GMBH + CO KG	Burette à zéro automatique	BLAUBRAND®, de Pellet, sans robinet intermédiaire, classe AS	0,05 - 25 ml	Déverrouillé
→ EC-22523	0	BRAND GMBH + CO KG	Burette à zéro automatique	BLAUBRAND®, de Pellet, sans robinet intermédiaire, classe AS	0,1 - 50 ml	Déverrouillé
→ EC-22524	0	BRAND GMBH + CO KG	Burette à zéro automatique	BLAUBRAND®, de Pellet, avec flacon, sans robinet intermédiaire, classe AS	0,02 - 10 ml	Déverrouillé
→ EC-22528	0	BRAND GMBH + CO KG	Burette à zéro automatique	BLAUBRAND®, de Pellet, avec flacon, sans robinet intermédiaire, classe AS	0,05 - 25 ml	Déverrouillé
→ EC-22530	0	BRAND GMBH + CO KG	Burette à zéro automatique	BLAUBRAND®, de Pellet, avec flacon, sans robinet intermédiaire, classe AS	0,1 - 50 ml	Déverrouillé

- f. Dans le champ de recherche, tapez **Transferpette S 1000**. Pendant que vous tapez, vous voyez comment la sélection d'articles change. Ce comportement est le même dans tous les champs de recherche de EASYCAL™ 5. Nous recommandons toujours d'utiliser d'abord la fonction de recherche, car EASYCAL™ 5 est livré avec une vaste base de données de base.

Le préfixe EC- indique qu'il s'agit d'un ensemble de données préétabli et non modifiable. Si vous souhaitez modifier ces enregistrements, copiez l'enregistrement, modifiez-le et enregistrez-le sous un autre nom. Pour plus d'informations, voir Aide dans EASYCAL™ 5.

- g. Sélectionnez le code d'article EC-704780. Confirmez votre choix par un double-clic.
- h. Sur Plan de contrôle, sélectionnez le plan de contrôle correspondant. En règle générale, vous y trouverez 1 à 2 entrées.
- i. Dans le plan de contrôle, les conditions générales du contrôle ainsi que les limites de défaut de l'article affecté sont enregistrées.


- j. Cliquez sur Démarrer le contrôle.

Un message indiquant qu'aucun numéro d'ordre n'a été attribué s'affiche.


S'il existe dans votre entreprise / processus de gestion de la qualité des directives pour l'organisation des contrôles, choisissez Non et attribuez un montant.

d'ordre. S'il n'y a pas de directives concernant l'organisation des examens, sélectionnez Oui et EASYCAL™ 5 attribue un numéro d'ordre unique.

Nous vous recommandons d'opter suffisamment tôt pour une approche uniforme.

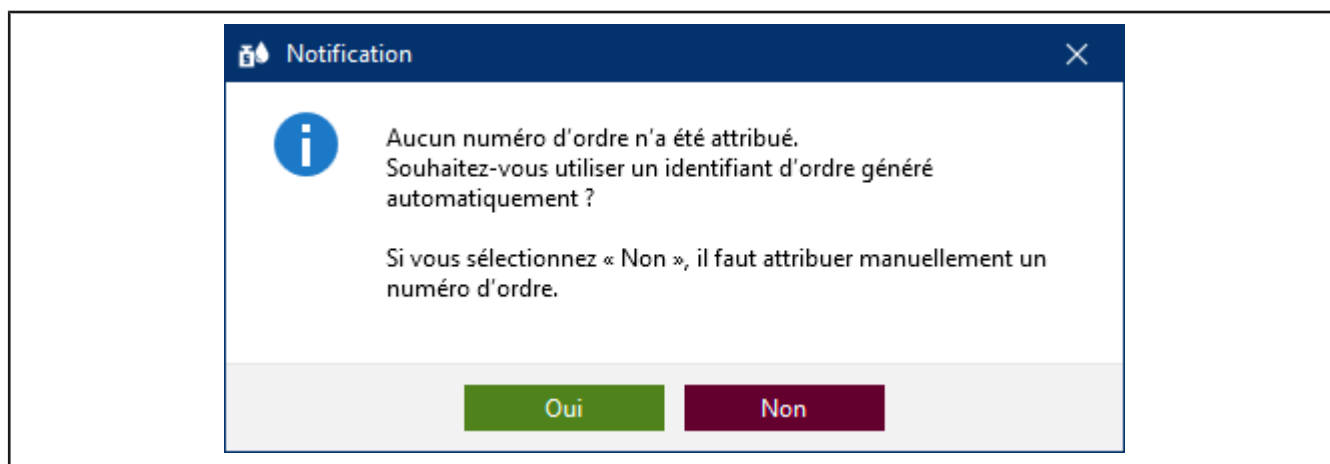

k. Poursuivez le tutoriel en cliquant sur Oui . Le numéro d'ordre est créé sur la base de l'horodatage actuel.

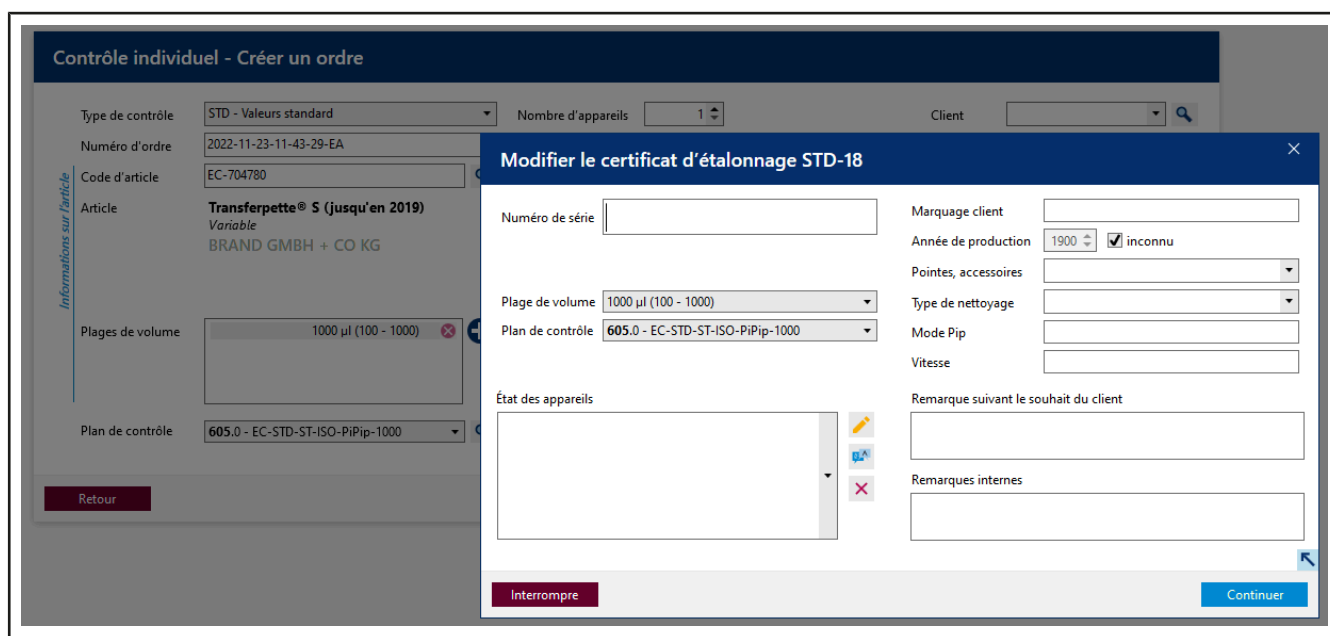

l. Vous pouvez saisir un numéro de série pour identifier l'appareil. Cela est nécessaire pour les examens réels. Mais ce n'est pas nécessaire pour le tutoriel.

m. Cliquez sur Continuer. L'ordre de contrôle est créé.

La fenêtre de démarrage du contrôle proprement dit s'ouvre.

3.1.3 Définir le moyen de contrôle

Prérequis:


✓ L'ordre est créé.

- a. Pour les moyens de contrôle, les paramètres nécessaires ainsi que le type de moyen de contrôle et le moyen de contrôle (numéro du moyen de contrôle) sont présélectionnés. Comme un seul moyen de contrôle est créé, nous nous en tiendrons à cette sélection.

3.1.4 Réalisation du contrôle


- a. Continuez en cliquant sur Caractéristique suivante .

Vous voyez le masque de saisie central de la fonctionnalité de mesure de EASYCAL™ 5 .

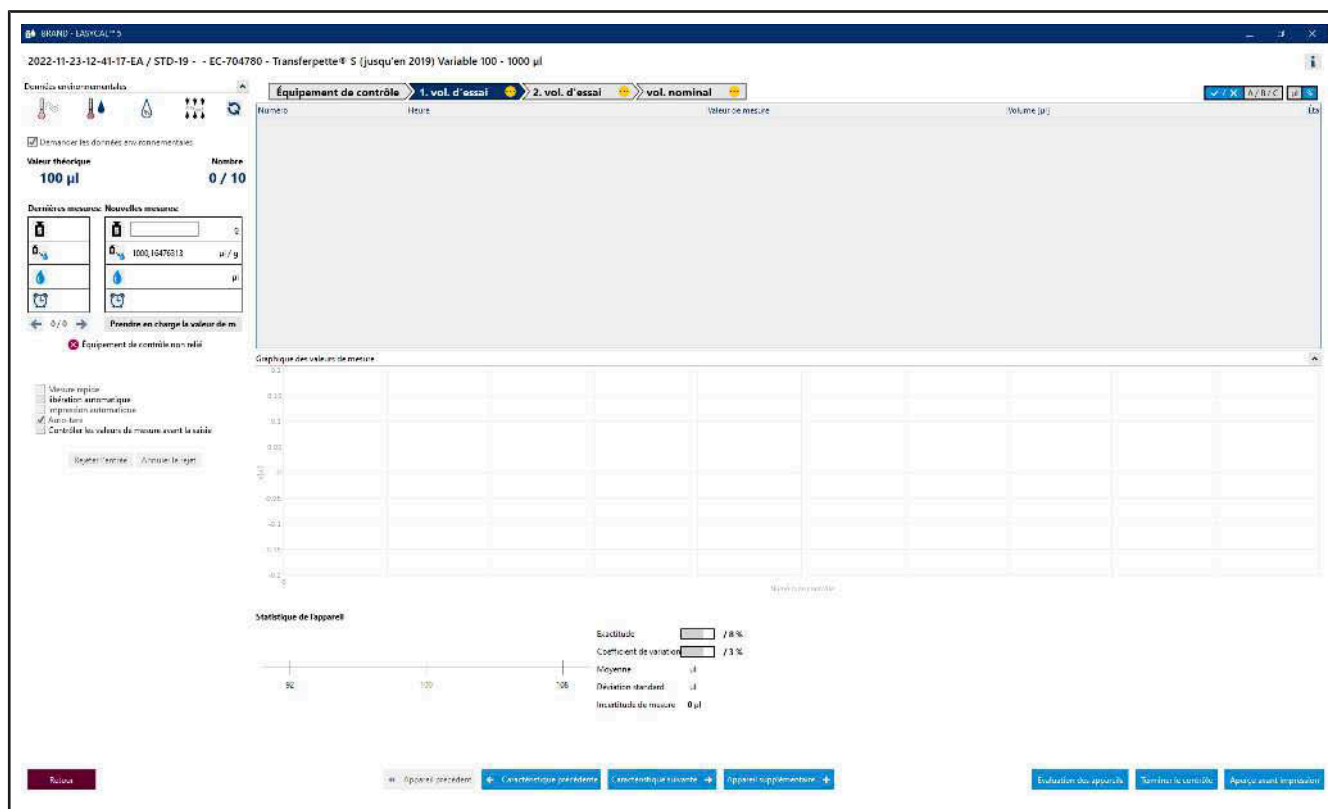

- b. Saisissez des valeurs de pesée fictives sur Nouvelle mesure . Commencez par 0 , 1 et cliquez sur "Reprendre la valeur de mesure. Une fenêtre s'affiche dans laquelle vous devez saisir ou compléter les valeurs de mesure.

Le choix du séparateur (virgule ou point) se fait par le choix de la langue dans le logiciel.

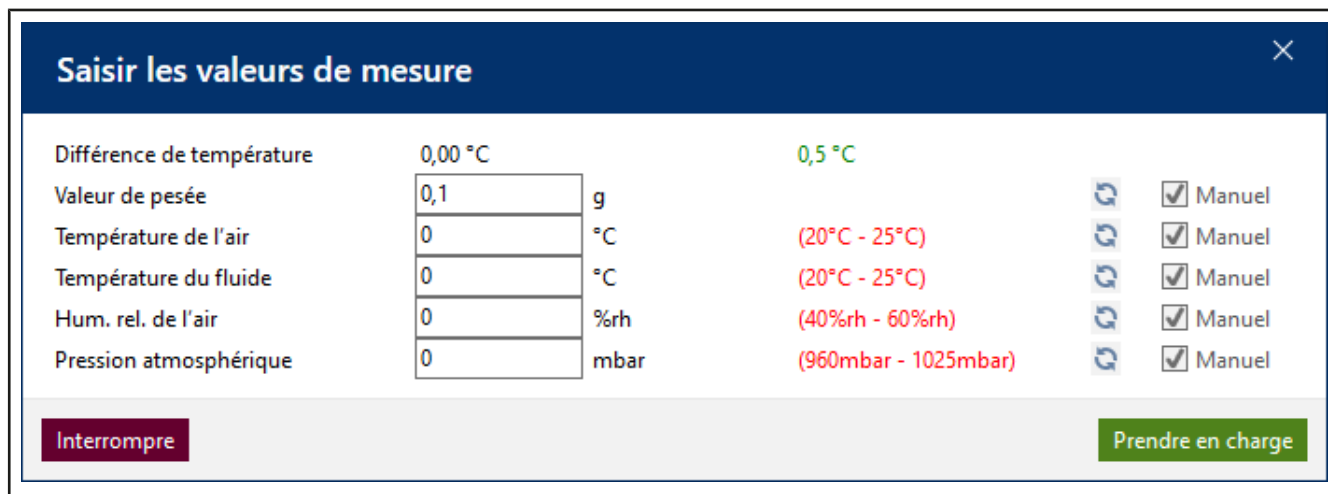

- c. Saisissez des valeurs fictives pour les paramètres environnementaux comme suit :

Saisir les valeurs de mesure ✕


Différence de température	0,00 °C	0,5 °C	
Valeur de pesée	0,1	g	☒ Manuel
Température de l'air	21	°C	☒ Manuel (20°C - 25°C)
Température du fluide	21	°C	☒ Manuel (20°C - 25°C)
Hum. rel. de l'air	40	%rh	☒ Manuel (40%rh - 60%rh)
Pression atmosphérique	960	mbar	☒ Manuel (960mbar - 1025mbar)

Interrompre
Prendre en charge


- d. Cliquez sur Reprendre. La première mesure est ainsi terminée. La valeur mesurée et le volume calculé à partir de cette valeur apparaissent dans le tableau.

Équipement de contrôle					1. vol. d'essai		2. vol. d'essai		vol. nominal		✓ / ✕ A / B / C µl %	
Numéro	Heure	Valeur de mesure				Volume [µl]				Éta		
1	23/11/2022 12:51:21	0,100000 g				100,301						


- e. Entrez maintenant de la même manière 8 fois la valeur 0,1 g comme valeur de mesure. Le tableau se remplit.

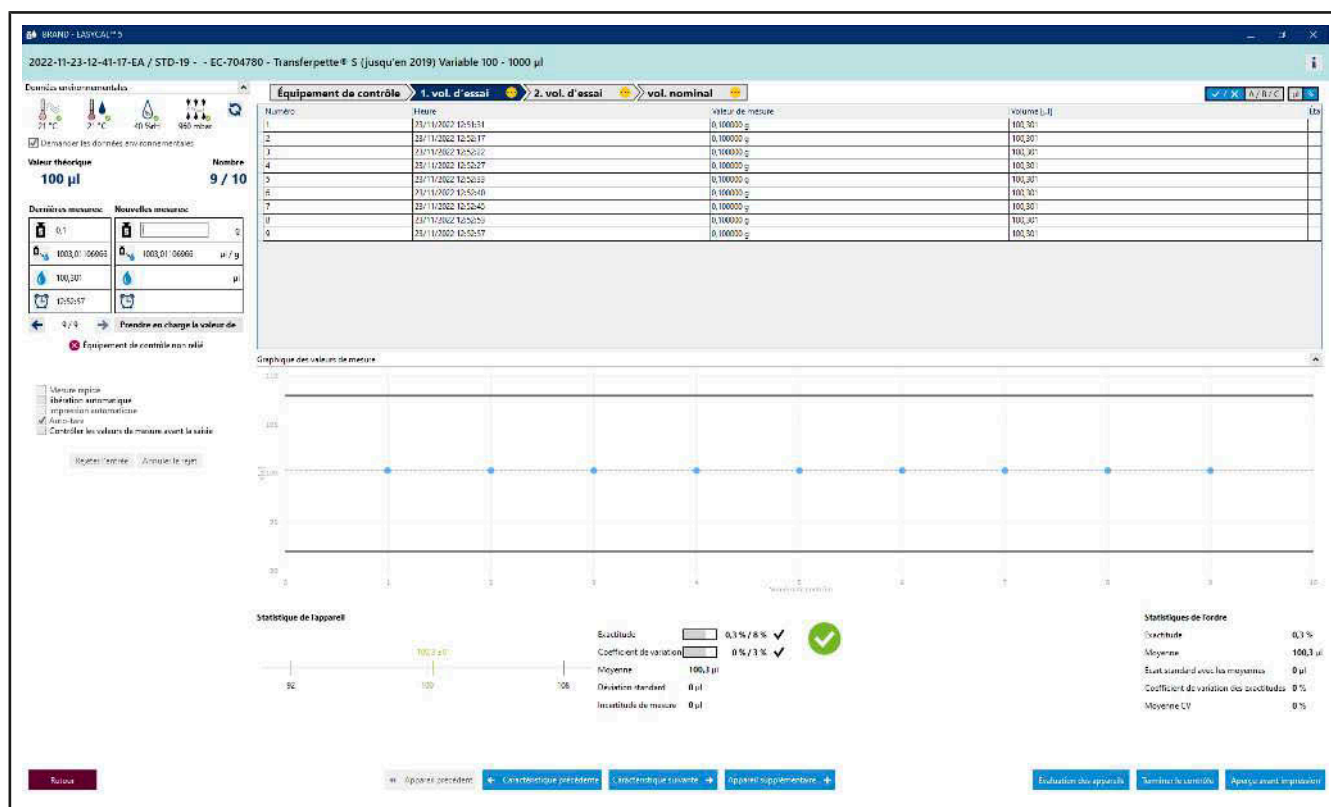

- f. La couleur bleu clair dans la zone au-dessus du tableau indique que l'ordre est en cours de traitement. Cliquez sur l'icône pour afficher ou masquer les informations avancées sur le certificat.
- g. Saisissez à nouveau 0,1 comme valeur de mesure et observez l'affichage de l'évolution au-dessus du tableau des valeurs de mesure.

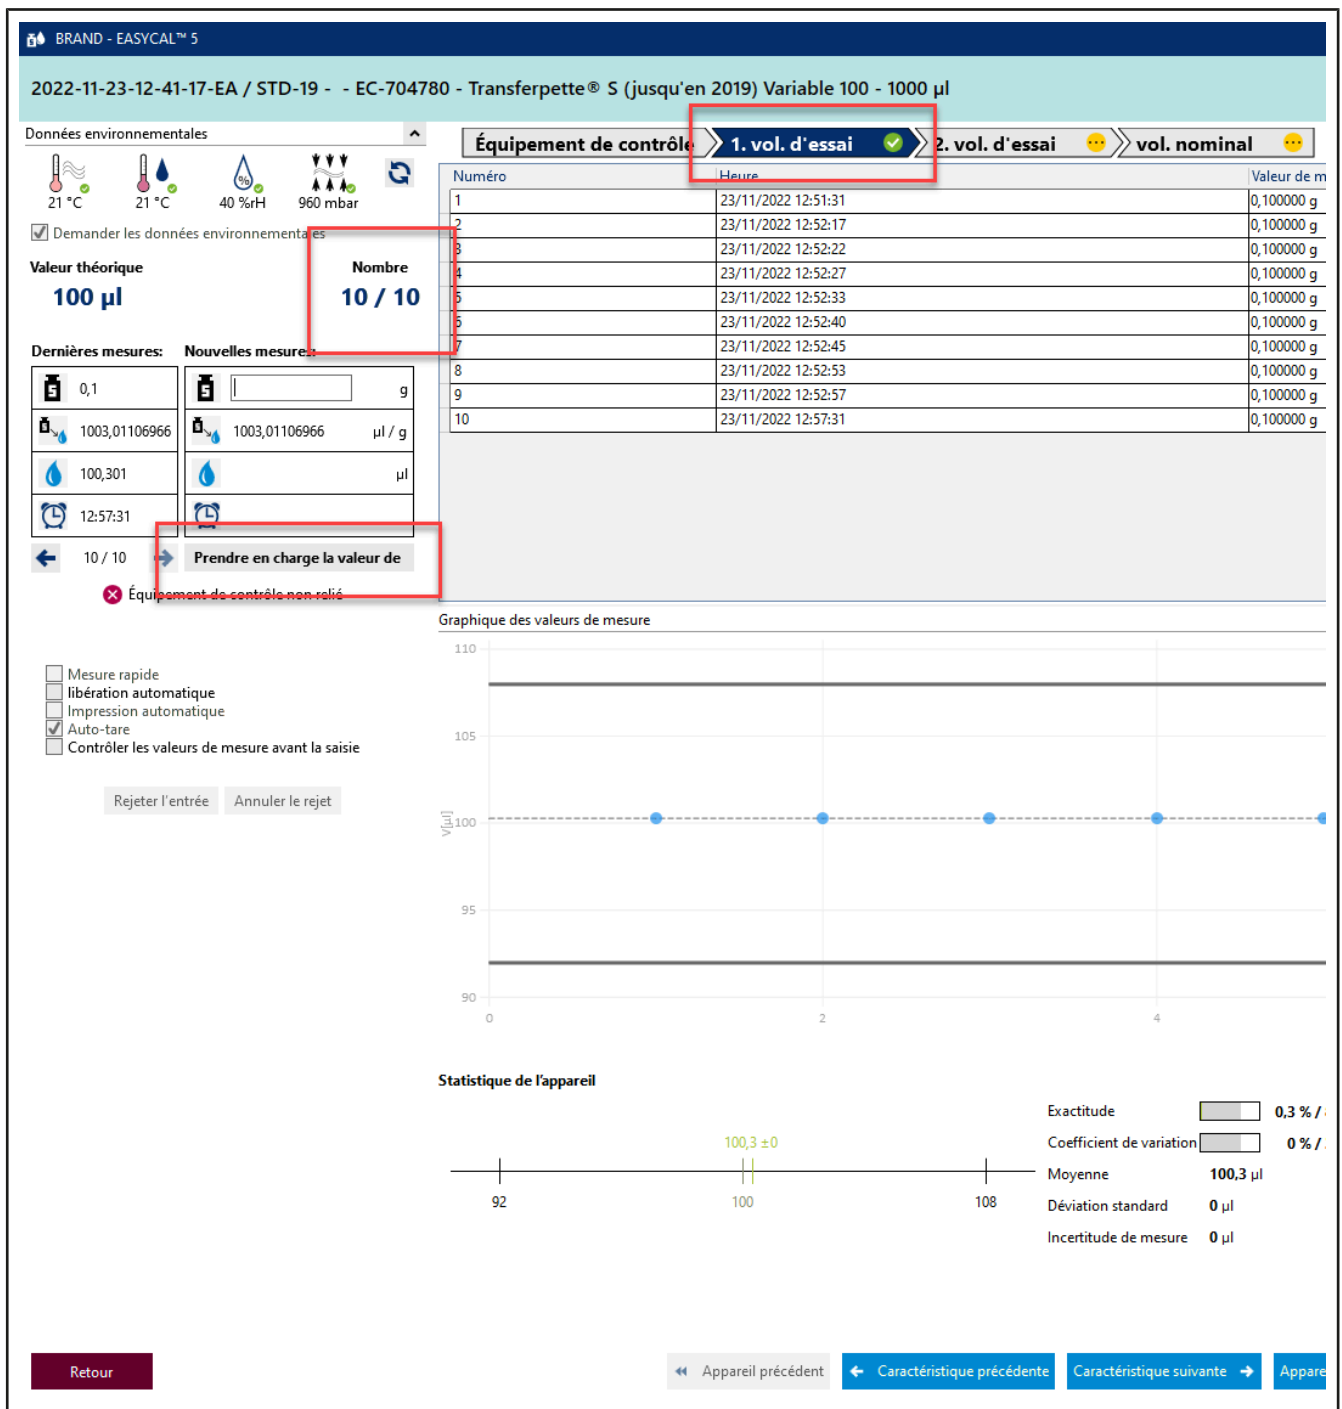

- h. En saisissant la 10e valeur de mesure, toutes les mesures requises pour la caractéristique 2 . TV ont été effectuées. La caractéristique reçoit une coche verte. Vous pouvez saisir d'autres valeurs de mesure, mais cela n'est pas exigé.

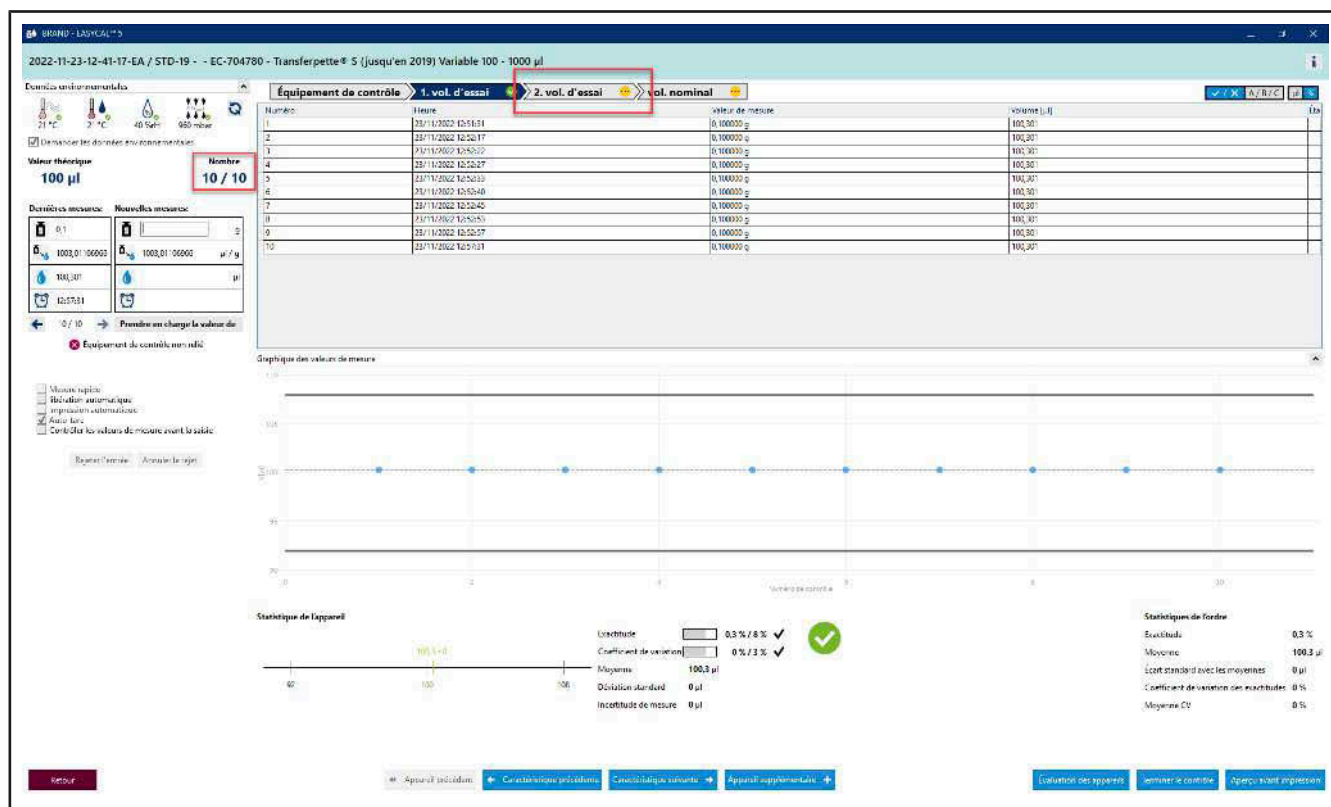


i. Cliquez sur 1. TV dans la barre de progression pour passer à la caractéristique suivante.

j. Entrez les valeurs suivantes dans Nouvelle mesure l'ordre séquentiel :


0,498
0,499
0,500

Répétez cette opération 2 fois.


➔ Vous voyez sur l'affichage Graphique des valeurs mesurées la position des différentes valeurs mesurées par rapport à des limites d'erreur définies (lignes continues) et à la valeur moyenne calculée. Sur Statistiques Appareil, vous voyez les valeurs réelles calculées pour l'exactitude et le coefficient de variation en comparaison avec les valeurs limites définies.

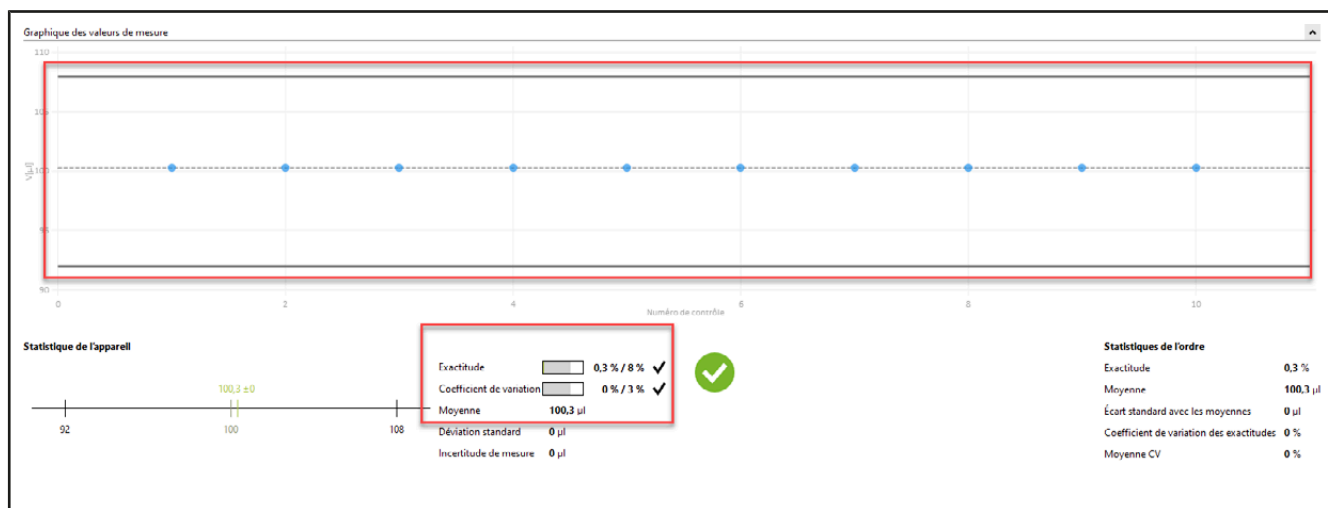

- k. Saisissez à nouveau 0,498 comme valeur de mesure, confirmez les paramètres environnementaux, puis cliquez sur NV dans la barre de progression. Ensuite, saisissez 1 comme valeur de mesure.

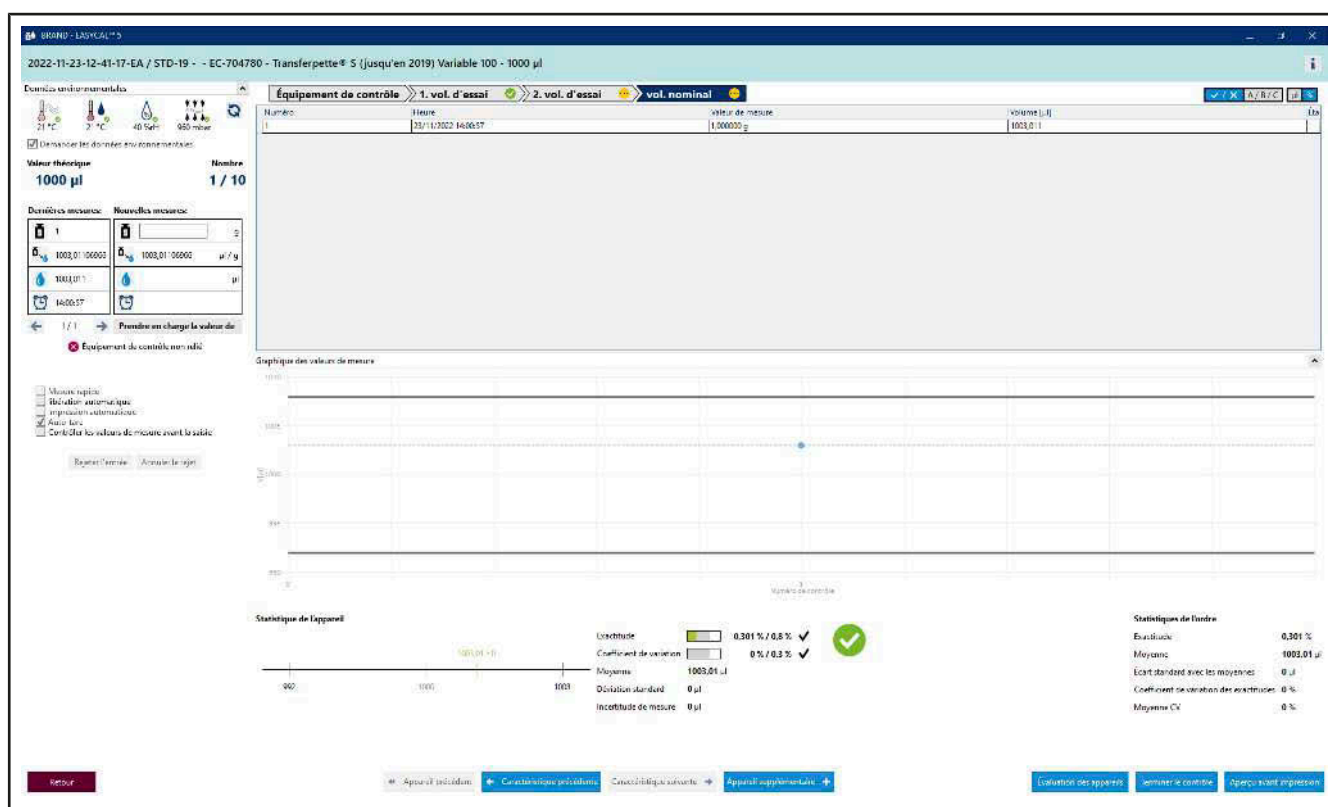


- l. Nous supposons que vous avez fait une erreur de frappe. Pour ce faire, saisissez 1,1 comme valeur de mesure et confirmez les paramètres environnementaux. Un avertissement s'affiche :

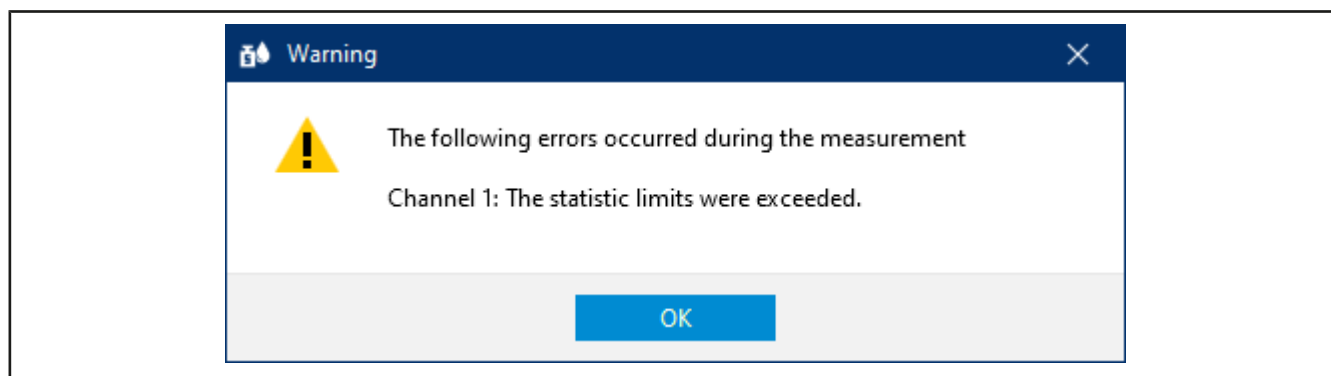


m. Acquittez cet avertissement en cliquant sur OK .

Vous voyez que les différentes zones du masque de saisie réagissent en fonction de la nouvelle valeur de mesure. Vous ne pouvez pas supprimer cette valeur de mesure, mais vous pouvez la rejeter. La valeur reste visible, mais n'est plus utilisée pour les statistiques.

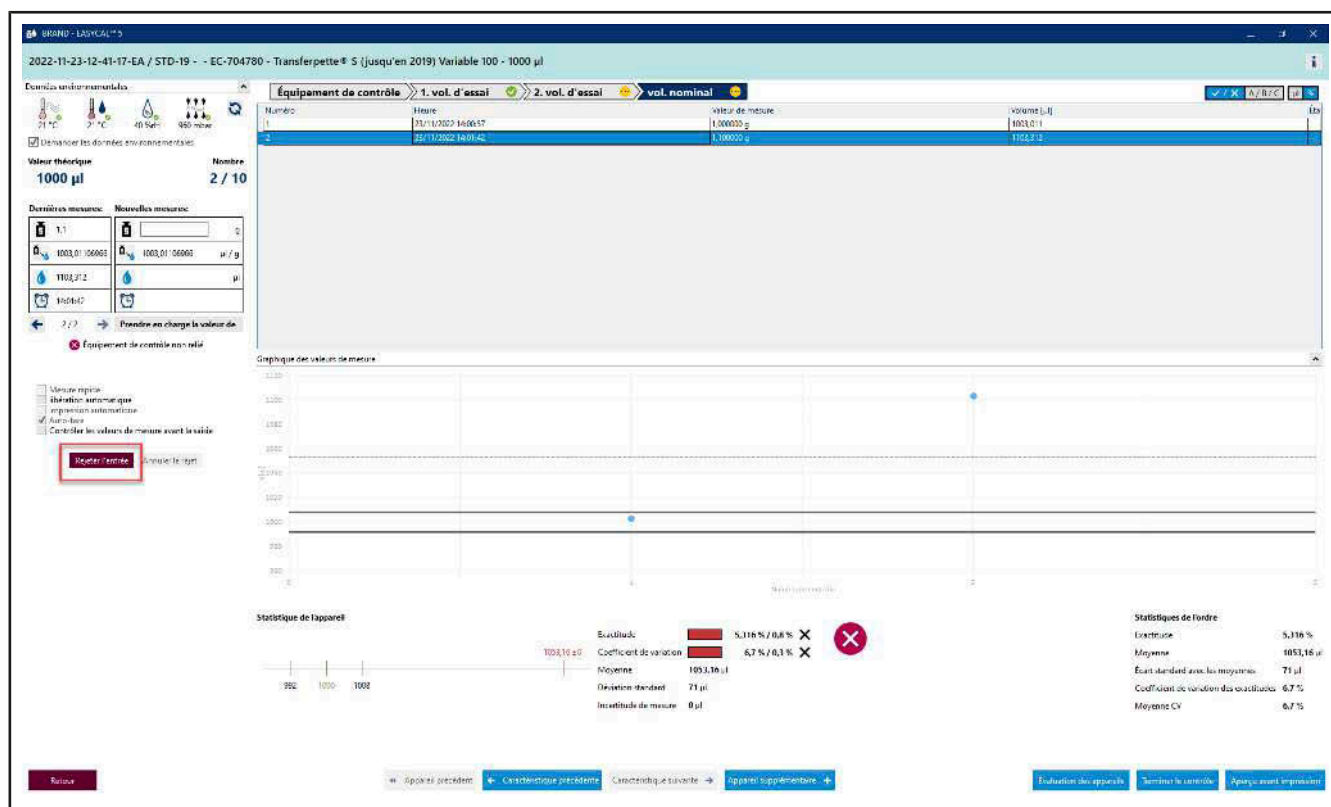


n. Cliquez sur le numéro de la mesure dans le tableau, puis cliquez sur Rejeter l'entrée.


Un message apparaît.

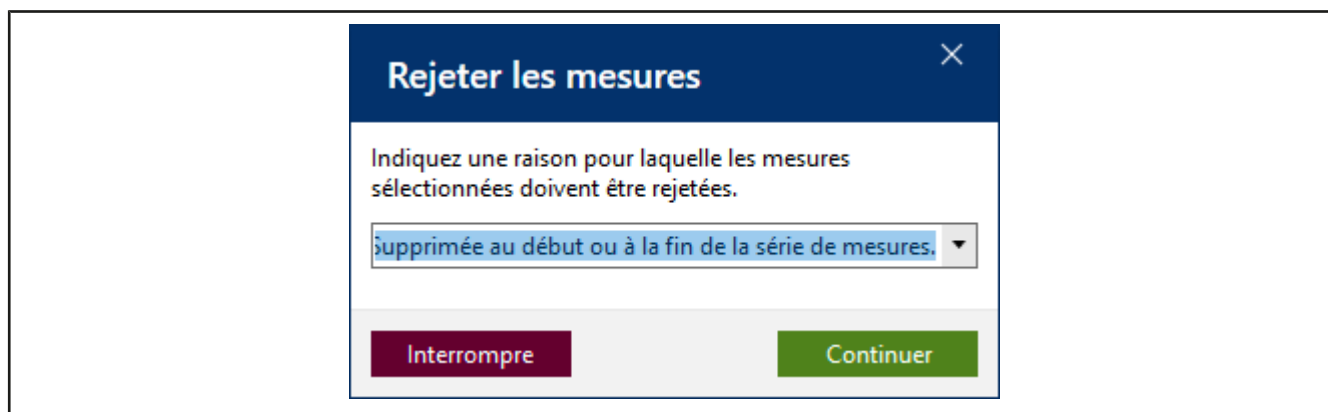

- o. Indiquez un motif, par exemple Identifiés comme aberrants. Vous pouvez également sélectionner une justification dans le menu déroulant. Ces textes peuvent être mis à jour dans les données de base. Confirmez votre choix en cliquant sur Continuer.

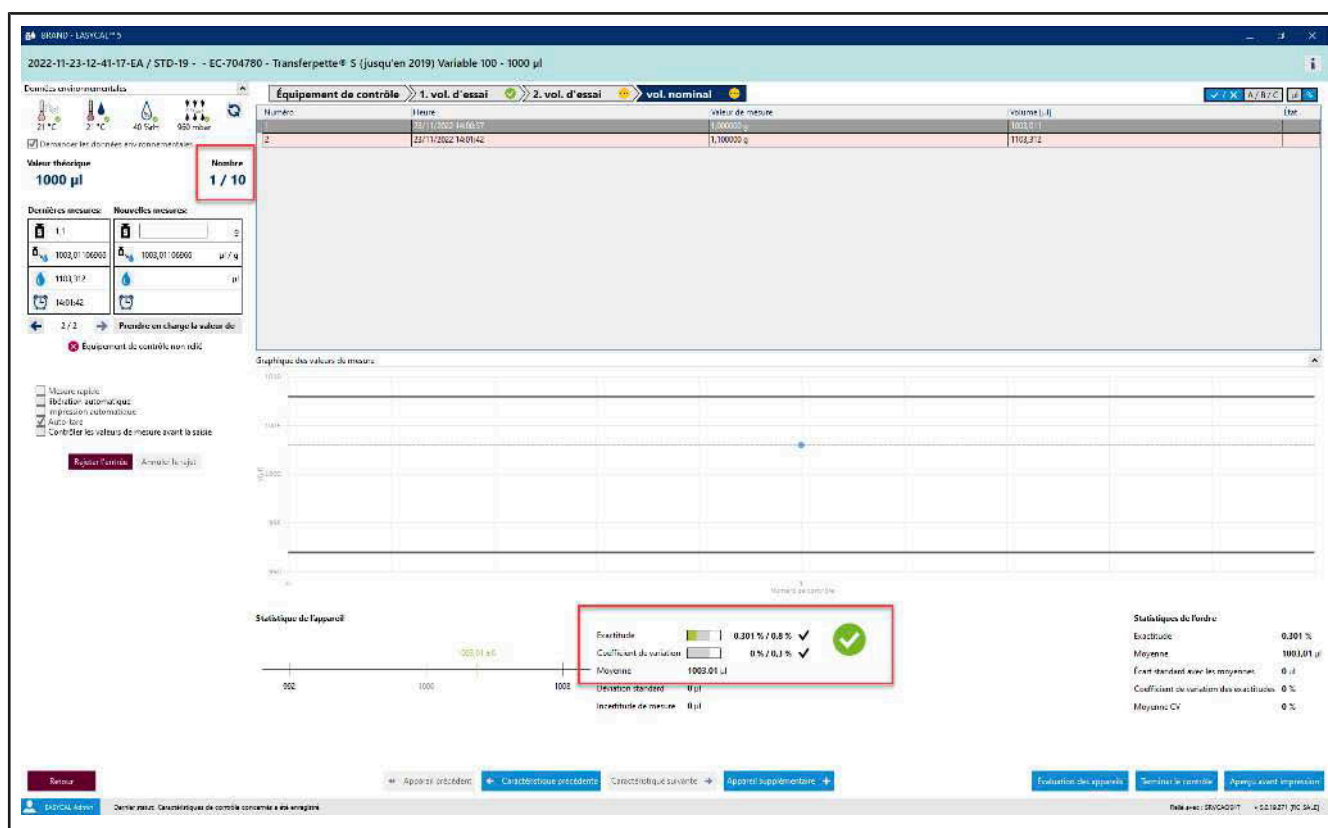


- p. La valeur de mesure 1, 1 n'est pas prise en compte dans l'évaluation.
- q. Poursuivez la saisie des valeurs de mesure jusqu'à ce que le nombre indique 10/10. En entrant la dernière valeur de mesure nécessaire, la couleur dans la zone au-dessus du tableau passe du bleu clair au jaune. Cela vous signale que le travail est terminé.

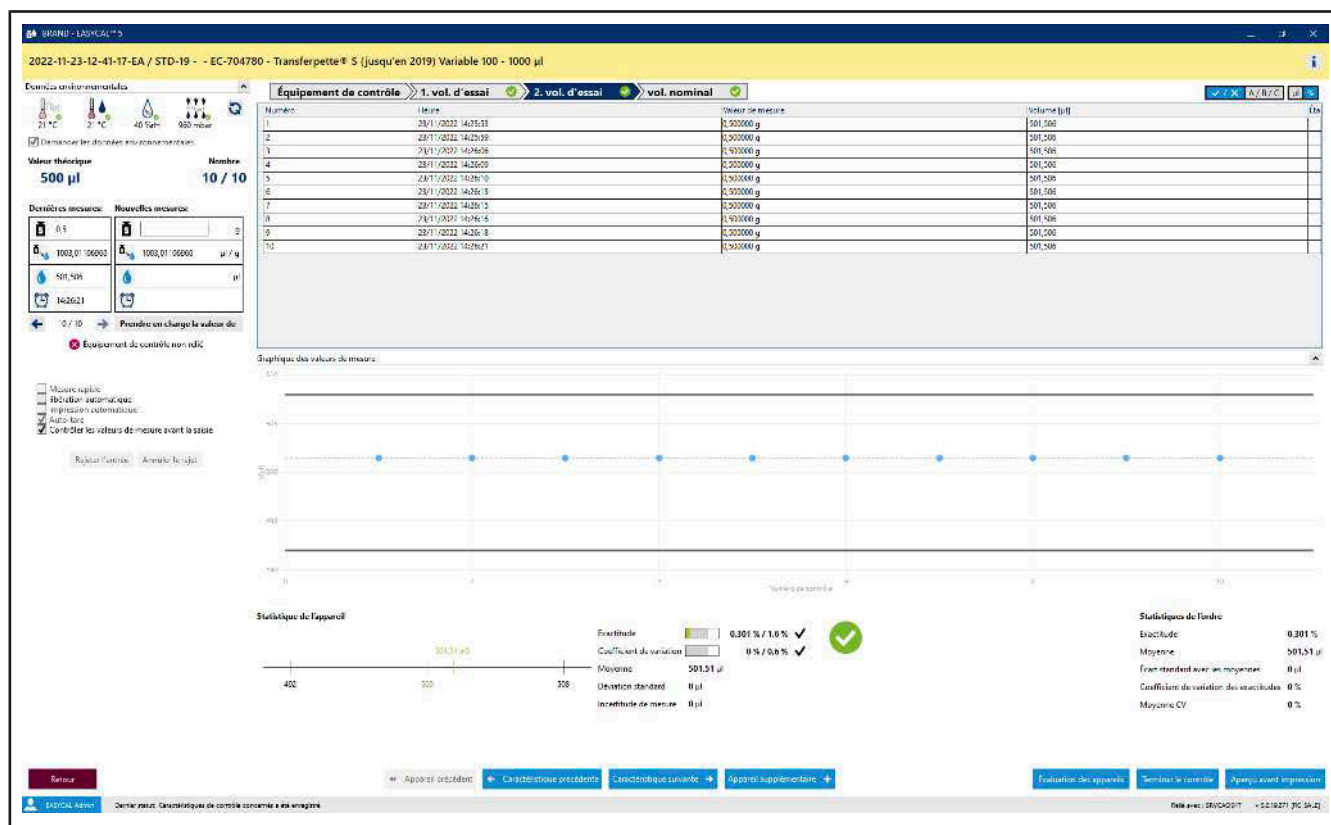

De plus, toutes les caractéristiques sont marquées d'une coche verte dans la barre de progression. La valeur de mesure rejetée est surlignée en rose.

3.1.5 Terminer le contrôle

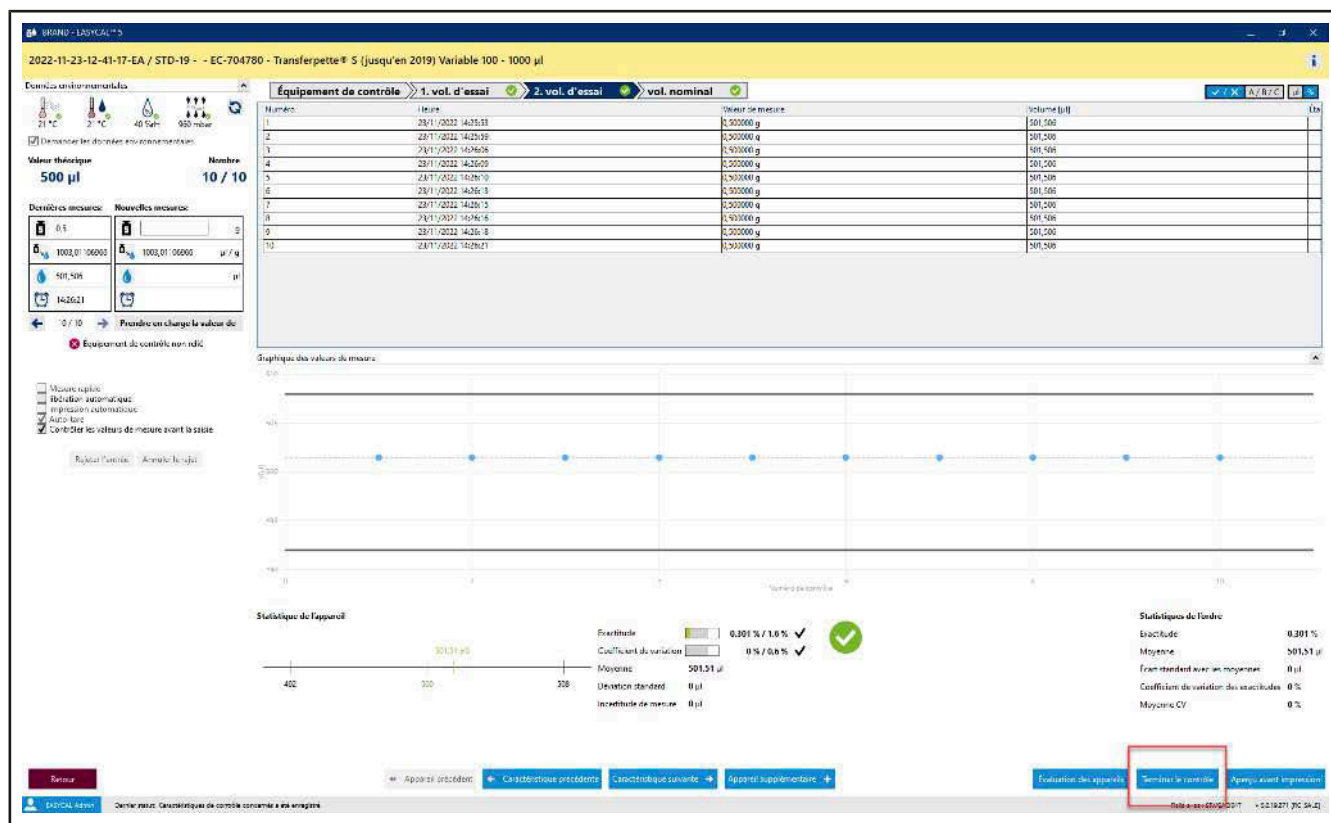

a. Cliquez sur Terminer le contrôle.

ORDRE

Ordre 2022-11-23-12-41-17-EA

Type de contrôle	STD - Valeurs standard	Article	EC-704780 - Transperette® S (jusqu'en 2019) Variable 100 - 1000 µl	Remarques sur l'ordre	Communication avec le client
Número d'ordre	2022-11-23-12-41-17-EA	Plan de contrôle	325.0 - EC-STD-ISO-Pipig-1000		
Type d'ordre	Contrôle individuel	Contrôleur	E. Admin		
Taille de lot	1	Date de l'étalonnage	23/11/2022		
Taille d'échantillon	1 / 1	N° de l'ordre d'achat			
État	Terminé	Número AB			

Caractéristiques de contrôle													
	Caractéristique de contrôle	Désignation	Valeur th.	Moyenne	tol théor.	tol OK	Écart standard	EN de cc	EN %	EN OK	CV% de + CV%	CV%	CV% OK
✓ 1	1. vol. d'essai	100µl	100,3 µl		O. K.	0 µl	0 %	0,3 %	O. K.	0 %	0 %	0 %	O. K.
✓ 2	2. vol. d'essai	500µl	501,51 µl		O. K.	0 µl	1,6 %	0,301 %	O. K.	0,6 %	0 %	0 %	O. K.
✓ 3	vol. nominal	1000µl	1003,01 µl		O. K.	0 µl	0,8 %	0,301 %	O. K.	0,3 %	0 %	0 %	O. K.

Aperçu des appareils et des certificats d'étalonnage

Type de certificat d'étalonnage	N° interne	N° de certificat d'étalonnage	Date de l'étalonnage	Numéro de série	Code d'article	Plage de volume	Eff.	Contrôles	État	État des appareils	Contrôleur	Certificat d'étalonnage lié
✓ Contrôle individuel	19	STD-19	23/11/2022		EC-704780	100 - 1000 µl	30	Terminé			E. Admin	

[Évaluation / validation](#)
[Imprimer le protocole interne](#)
[Imprimer les certificats](#)
[Nouveau certificat d'étalonnage](#)

[Retour](#)
[Retour à l'aperçu de l'ordre](#)

Enregistrer

BRAND - EASYCAL™ S

LASTICAL admin | Dernier statut: Caractéristiques de contrôle concerné à été enregistré

Fait avec : SPYCAO24ET v 5.0.19.271 [RC-SALE]

b. Vous voyez maintenant l'ordre avec un résumé des mesures pour les caractéristiques de contrôle correspondantes. Cliquez sur Imprimer le protocole interne.

[illegible]

- c. Vous voyez l'éditeur de certificats en mode d'affichage. Ici, vous pouvez imprimer ou exporter le protocole enregistré.
- d. Quittez l'éditeur de certificat en cliquant sur Retour.

BRAND - EASYCAL™ 5

Ordre 2022-11-23-12-41-17-EA

Type de contrôle: STD - Valeurs standard Article: EC-704780 - Transfertette® 5 (jusqu'en 2019) Variable 100 - 1000 µl

Numéro d'ordre: 2022-11-23-12-41-17-EA Plan de contrôle: 325.0 - EC-STD-ISO-PfPig-1000

Type d'ordre: Contrôle individuel Contrôleur: E. Admin

Taille de lot: 1 Date de l'étalonnage: 23/11/2022

Taille d'échantillon: 1 / 1 N° de l'ordre d'achat: Client: Client final:

État: Terminé Numéro AB:

Remarques sur l'ordre: Communication avec le client:

Caractéristique de contrôle	Désignation	Valeur th	Moyenne	Tol théor	Tol OK	Écart standard	É% de cc	É% OK	CV% de CV%	CV% OK	CV% OK
1	1. vel. d'essai 100µl	100,3 µl		O. K.	0 µl	8 %	0,9 %	O. K.	3 %	0 %	O. K.
2	2. vel. d'essai 500µl	501,51 µl		O. K.	0 µl	1,6 %	0,301 %	O. K.	0,6 %	0 %	O. K.
3	vol. nominal 1000µl	1003,01 µl		O. K.	0 µl	0,8 %	0,301 %	O. K.	0,3 %	0 %	O. K.

Aperçu des appareils / du certificat d'étalonnage

Type de certificat d'étalonnage	N° interne	N° de certificat d'étalonnage	Date de l'étalonnage	Numéro de série	Code d'article	Plage de volume	Eff.	Contrôles	État	État des appareils	Contrôleur	Certificat d'étalonnage lié
Contrôle individuel	19	STD-19	23/11/2022		EC-704780	100 - 1000 µl	30	Terminé			E. Admin	

Évaluation / validation Imprimer le protocole interne Imprimer les certificats Nouveau certificat d'étalonnage

Retour Retour à l'écran de l'ordre Enregistrer

- e. Cliquez sur Évaluation / validation.

Évaluation / validation

Act. État: Terminé

Nouveau statut: Validé

Remarques:

☒ Prendre en charge pour tout

☐ Tout remplacer

Interrompre Enregistrer

f. Dans la fenêtre Libéré qui s'ouvre, sélectionnez et confirmez la saisie en cliquant sur Enregistrer

ORDRE 2022-11-23-12-41-17-EA

Type de contrôle: STD - Valeurs standard
 Numéro d'ordre: 2022-11-23-12-41-17-EA
 Type d'ordre: Contrôle individuel
 Taille de lot: 1
 Taille d'échantillon: 1 / 1
 État: Terminé

Article: EC-704780 - Transfopette® 5 (jusqu'en 2019) Variable 100 - 1000 µl
 Plan de contrôle: 325.0 - EC-STD-ISO-PiPip-1000
 Contrôleur: E. Admin
 Date de l'étalonnage: 23/11/2022
 N° de l'ordre d'achat:
 Numéro AB:
 Client:
 Client final:

Remarques sur l'ordre:
 Communication avec le client:

Caractéristique de contrôle	Désignation	Valeur th	Moyenne	tol théor	tol OK	Écart standard	E% de cv E%	E% OK	CV% de CV%	CV% OK	CV% OK
1	1. vol. d'essai 100µl	100.3 µl	100.3 µl	0 µl	0 µl	0.3 µl	0.3 %	0.3 %	0 %	0 %	0.3 %
2	2. vol. d'essai 500µl	501.51 µl	501.51 µl	0 µl	0 µl	1.6 µl	0.301 %	0.301 %	0.6 %	0 %	0.6 %
3	vol. nominal 1000µl	1003.01 µl	1003.01 µl	0 µl	0 µl	0.8 µl	0.301 %	0.301 %	0.3 %	0 %	0.3 %

Aperçu des appareils / du certificat d'étalonnage

Type de certificat d'étalonnage	N° interne	N° de certificat d'étalonnage	Date de l'étalonnage	Numéro de série	Code d'article	Plage de volume	Eff.	Contrôles	État	État des appareils	Contrôleur	Certificat d'étalonnage lié
Contrôle individuel	19	STD-19	23/11/2022		EC-704780	100 - 1000 µl	30	Terminé			E. Admin	

Évaluation / validation Imprimer le protocole interne **Imprimer les certificats** Nouveau certificat d'étalonnage

Retour Retour à l'aperçu de l'ordre Enregistrer

g. Cliquez sur Imprimer les certificats .

Imprimer les certificats


☒ Tout sélectionner / désélectionner

☒ 19 STD-19

Imprimer Enregistrer Enregistrer et imprimer

Interrompre Aperçu avant impression

h. Cliquez sur la case à cocher, puis sur Aperçu avant impression.



ORDRE 2022-11-23-12-41-17-EA

Type de contrôle: STD - valeurs standard Article: 35-704780 - "antipette" 5 jusqu'en 2019 Variable 100 - 1000 µl

Numéro d'ordre: 2022-11-23-12-41-17-EA Plan de contrôle: 3450 - FC-500-600-antip-1000

Type d'ordre: Contrôle individuel Contrôleur: E. Admin

Taille de lot: 1 Date de l'étalonnage: 23/11/2022

Taille d'échantillon: 2/1 N° de l'ordre d'achat: Client: Client final:

État: En cours Numéro AB:

Remarques sur l'ordre: Communication avec le client:

Caractéristiques de contrôle:

Caractéristiques de contrôle	Valeur théorique	Test théorique OK	Ecart standard	1% de C.V.	2% de C.V.	3% de C.V.	4% de C.V.	5% de C.V.	6% de C.V.	7% de C.V.	8% de C.V.	9% de C.V.	10% de C.V.
1. vol. d'eau 100 µl	100.0 µl	O.K.	0 µl	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
2. vol. d'eau 500 µl	500.0 µl	O.K.	0 µl	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
3. vol. maximal 1000 µl	1000.0 µl	O.K.	0 µl	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %


Aperçu des appareils / du certificat d'étalonnage:

Type de certificat d'étalonnage	N° interne	N° de certificat d'étalonnage	Date de l'étalonnage	Numéro de série	Code d'article	Plage de volume	Eff.	Contrôleur	État	État des appareils	Contrôleur	Certificat d'étalonnage	Id
Contrôle individuel	19	STD-19	23/11/2022	EC-704780	100 - 1000 µl	30	Terminé	E. Admin	STD-20				
Contrôle individuel	20	STD-20	Assessé directement	EC-704780	100 - 1000 µl	0	Créé		STD-10				

Exécution / validation Imprimer le protocole interne Imprimer les certificats Nouveau certificat d'étalonnage

Retour Retour à l'aperçu des ordres Enregistrer

- j. Cliquez sur Retour à l'aperçu des ordres
- k. À partir de là, vous pouvez créer d'autres tâches et lancer des examens. Via Retour , vous accédez au menu principal.

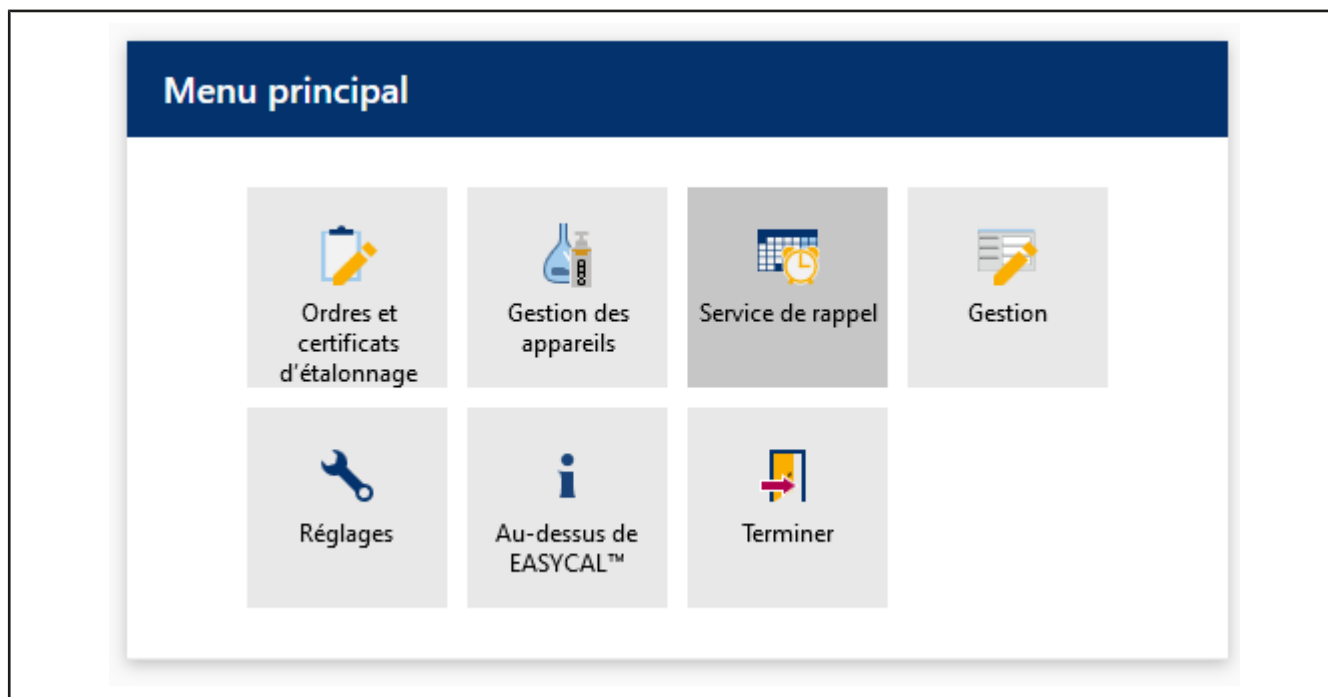

➔ Ce tutoriel se termine ici.

Aviso legal

BRAND GMBH + CO KG
Otto-Schott-Str. 25
97877 Wertheim (Germany)
T +49 9342 808 0
F +49 9342 808 98000
info@brand.de
www.brand.de

Do you need more operating manuals and translations?
Please refer to <http://www.brand.de/om> or use the following Quick
Response Code:



The original operating manual is in German. La redacción en otros idiomas es una traducción del manual de instrucciones original.

Salvo cambios técnicos, errores y erratas.

Índice

1	Observaciones preliminares	98
2	Instalación	99
3	Introducción a EASYCAL™ 5	109
3.1	Tutorial.....	109
3.1.1	Ajuste de la balanza como equipo de prueba	109
3.1.2	Crear encargo	110
3.1.3	Determinar el equipo de prueba	114
3.1.4	Realizar la prueba	114
3.1.5	Finalizar prueba	122

1 Observaciones preliminares


Este tutorial está diseñado para ayudarte a usar EASYCAL™ 5 durante tu periodo de prueba de 30 días. Aquí aprenderá a llenar diferentes áreas de EASYCAL™ 5, realizar la primera prueba de dispositivo e imprimir un certificado mediante un procedimiento ejemplar.

Tenga en cuenta que en el curso de esta introducción, los datos de muestra se generarán en la base de datos, que no se pueden eliminar más adelante. Le recomendamos que coordine esto con los requisitos normativos de su sistema de gestión de calidad.


2 Instalación

Requisito:


- ✓ Ya ha recibido el archivo de instalación de EASYCAL™ 5, EasyCal-Setup.exe, de la página inicial de LA MARCA y lo ha guardado localmente.
 - ✓ Ha recibido una licencia de demostración (ticket) por correo electrónico.
 - ✓ Tiene derechos de administrador local y tiene una conexión a Internet existente.
- a. Inicie la instalación abriendo EasyCal-Setup.exe y siga las instrucciones del asistente de instalación.

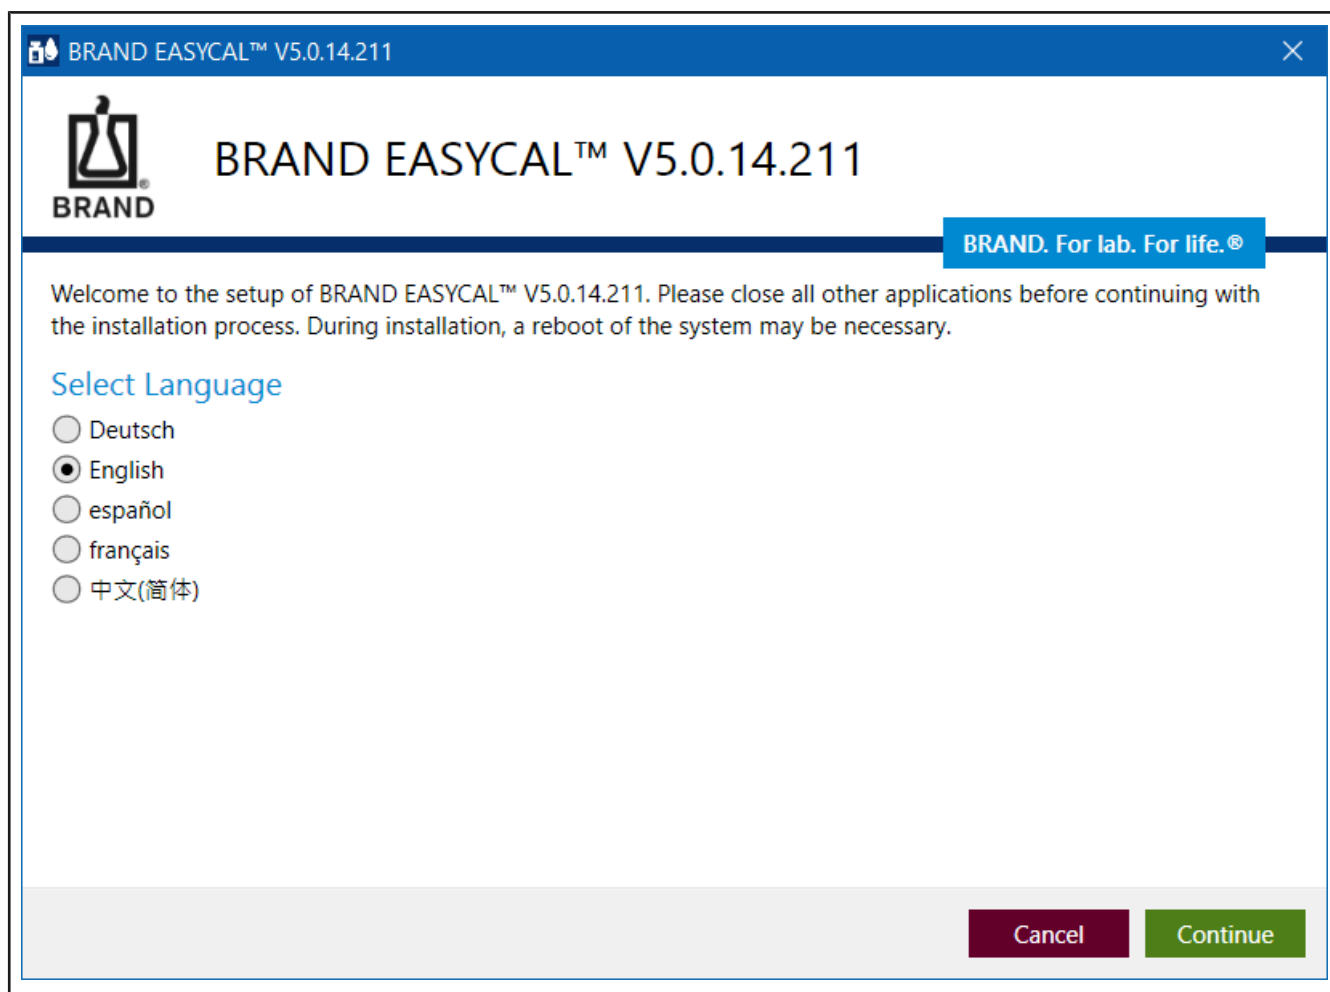

- ➔ EASYCAL™ 5 Y todos los componentes de software necesarios para el funcionamiento están instalados en su PC.
- b. Una vez finalizada la instalación EASYCAL™ 5, coloque la marca de verificación y Finalizar haga clic en.

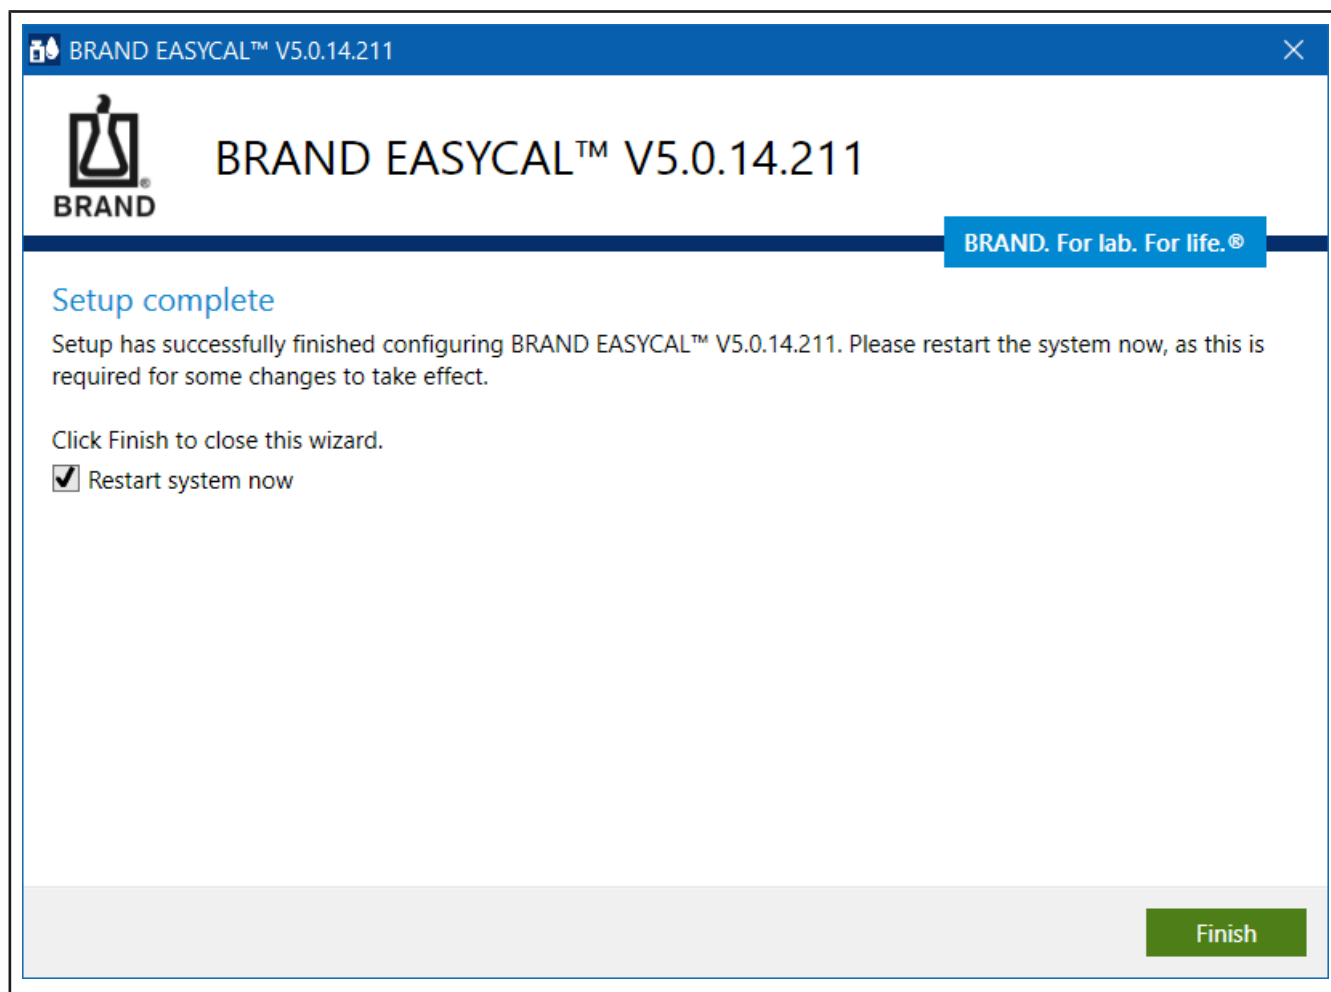


c. Se le pedirá que EASYCAL™ 5 active.

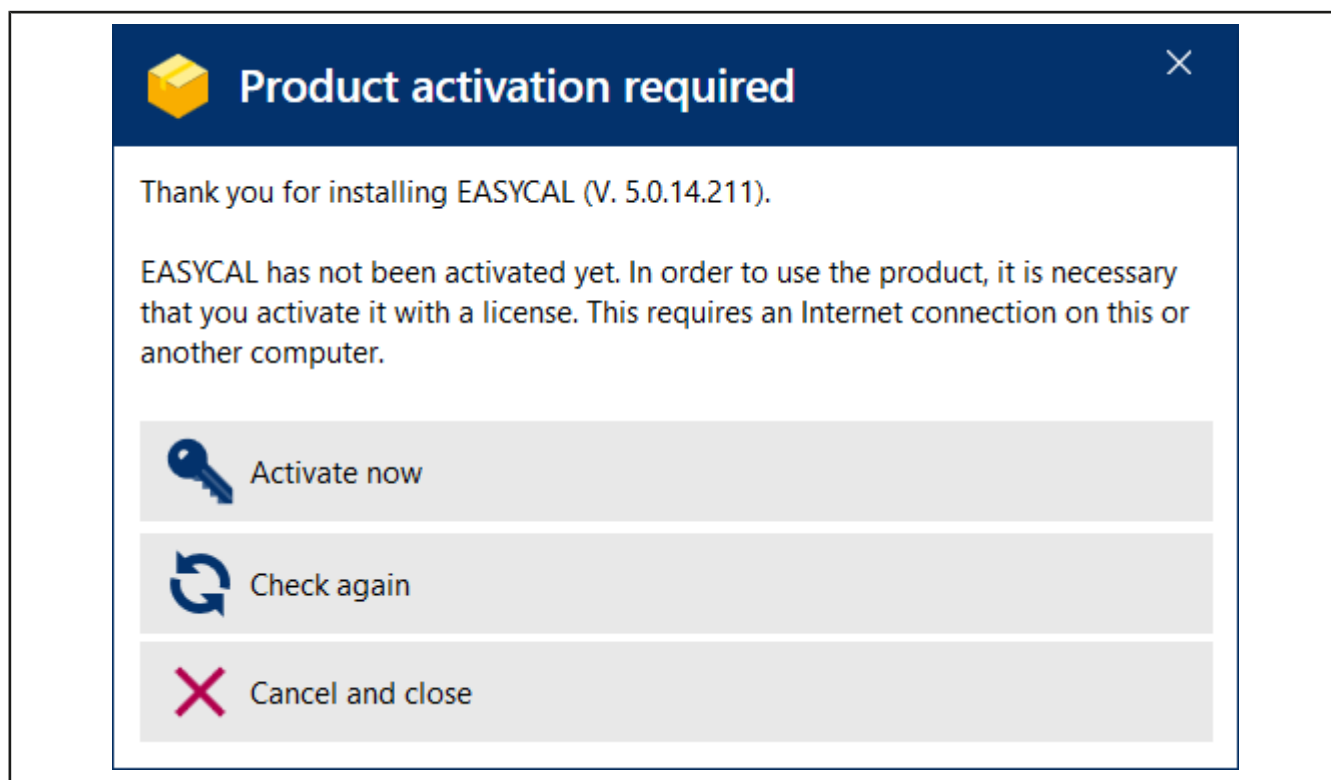


d. Haga clic en Activar ahora.


➔ Se abrirá el navegador web predeterminado con la página <https://license.brand.de/index.php>.

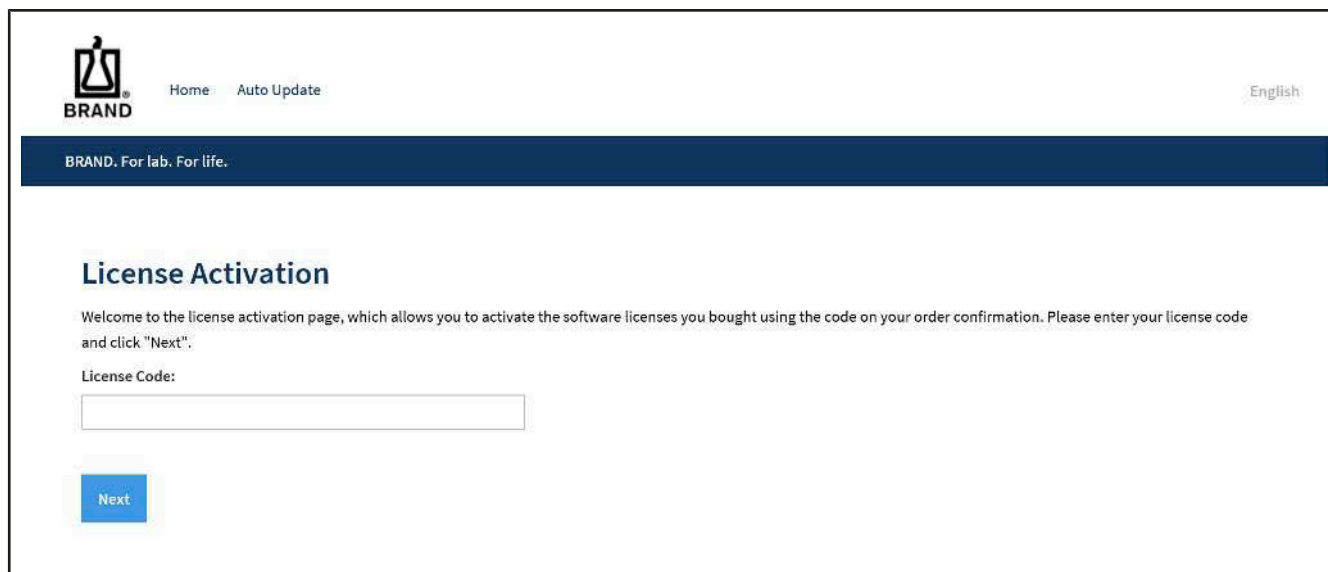


e. Introduzca su ticket (= clave de licencia) aquí.

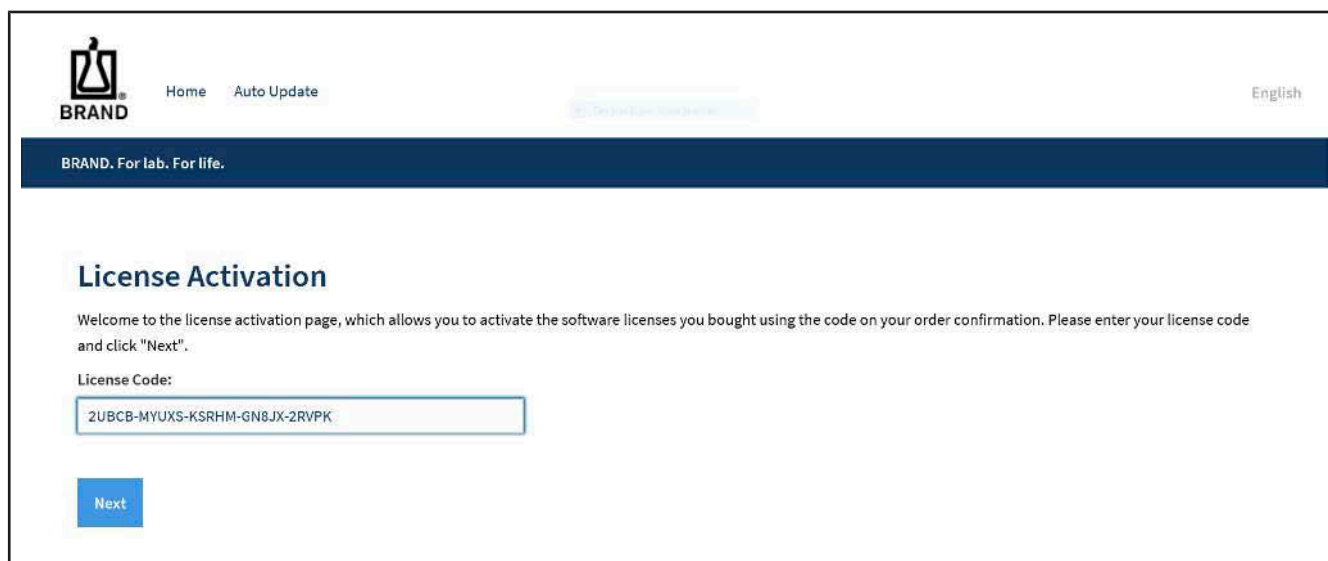

f. Haga clic en Continuar.

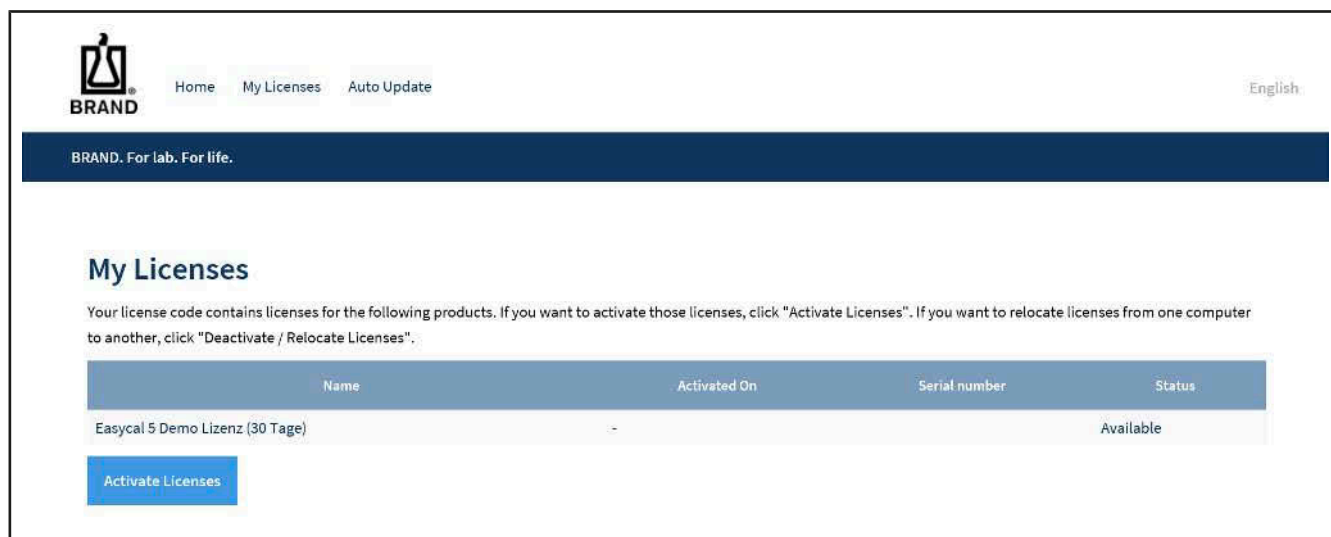

g. Haga clic en Activar licencia.

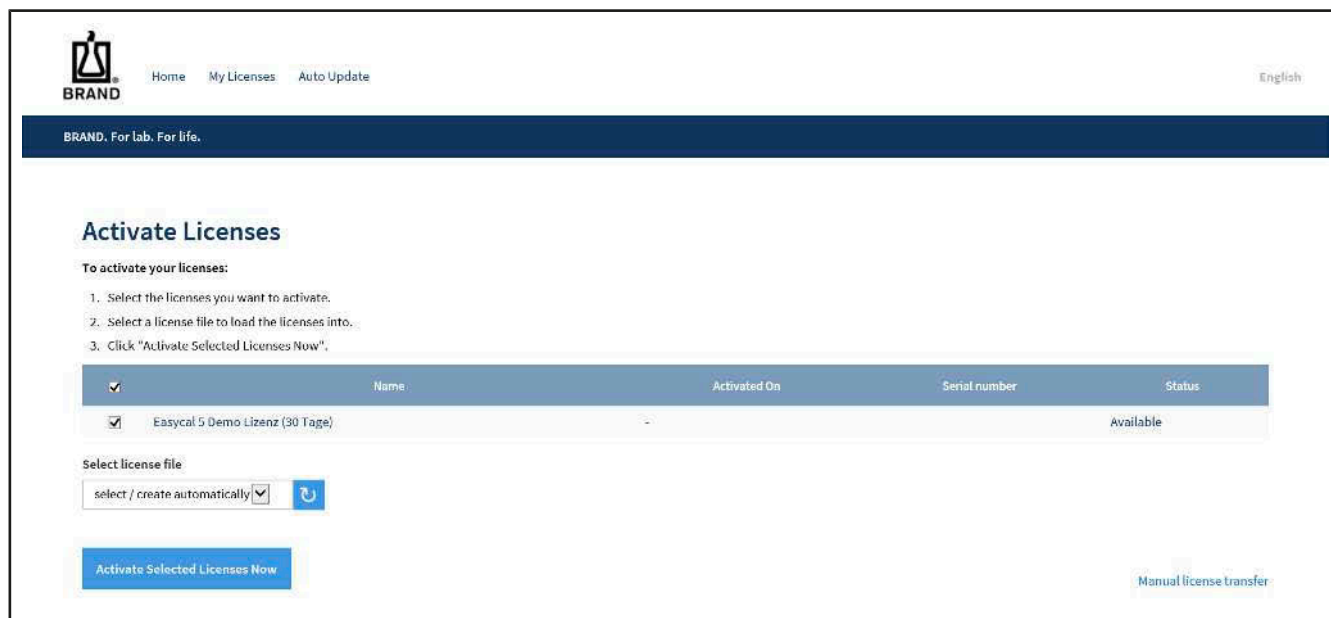

h. Si no cambia ninguno de los valores, haga clic en Activar ahora las licencias seleccionadas.

↪ La transferencia de licencia en línea está en curso.

Online License Transfer

Starting license transfer.
 Downloading license template.
 Registering license template.
 Creating license request.
 Downloading license update.
 Importing license update into target.
 Creating receipt.
 Uploading receipt.



License transfer completed successfully!

OK

i. Haga clic en Aceptar.



Home My Licenses Auto Update

English

BRAND. For lab. For life.

My Licenses


Your license code contains licenses for the following products. If you want to activate those licenses, click "Activate Licenses". If you want to relocate licenses from one computer to another, click "Deactivate / Relocate Licenses".

Name	Activated On	Serial number	Status
Easycal 5 Demo Lizenz (30 Tage)	2021-11-15 10:28:54	130-1018824202	Activated


Deactivate / Relocate Licenses

j. La licencia está activada. Puede cerrar la ventana del explorador.


k. Acceda a la ventana Activación del producto.

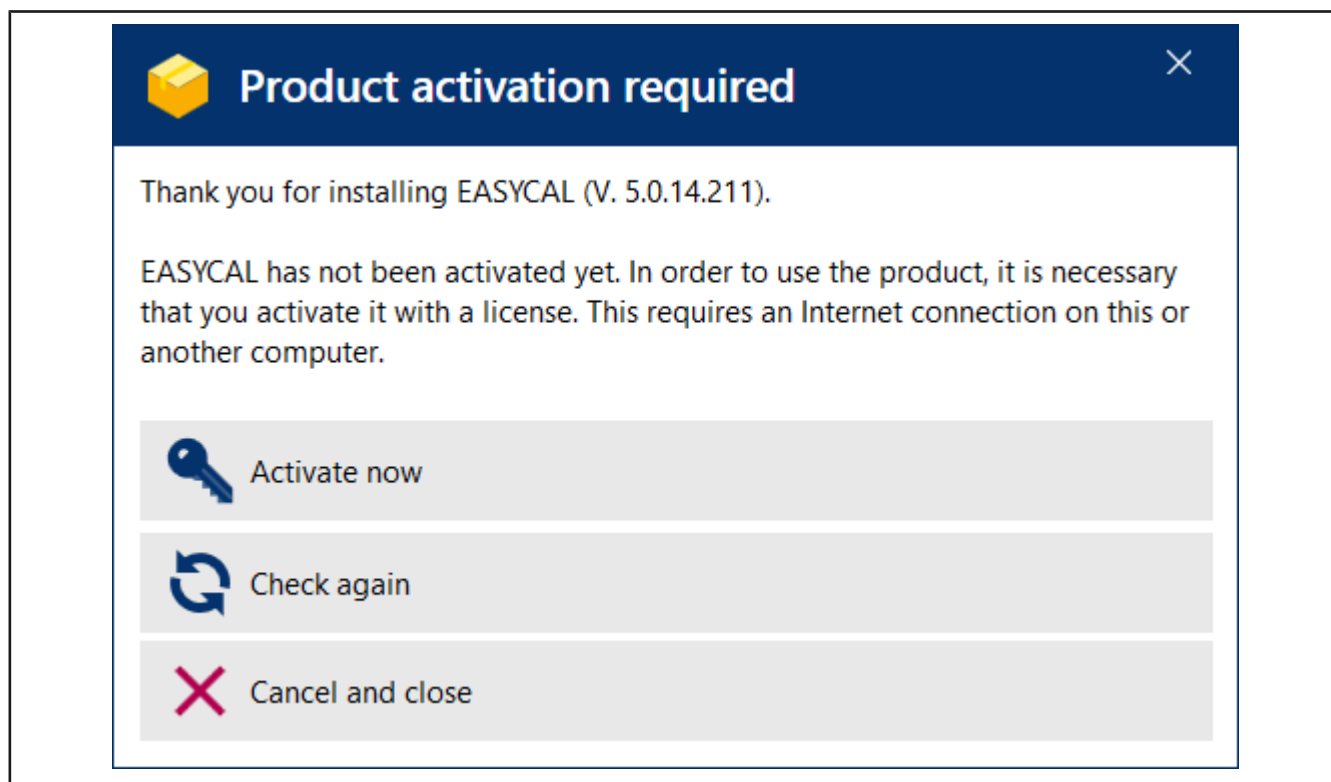


- l.** Haga clic en Volver a comprobar.

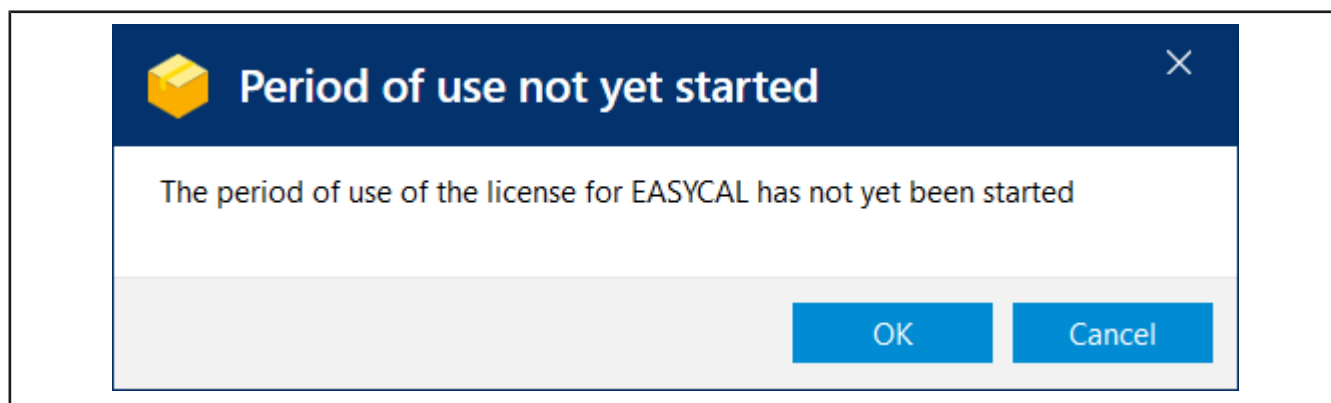


- m.** Haga clic en para Aceptar iniciar el período de uso. Aparece una ventana de información.

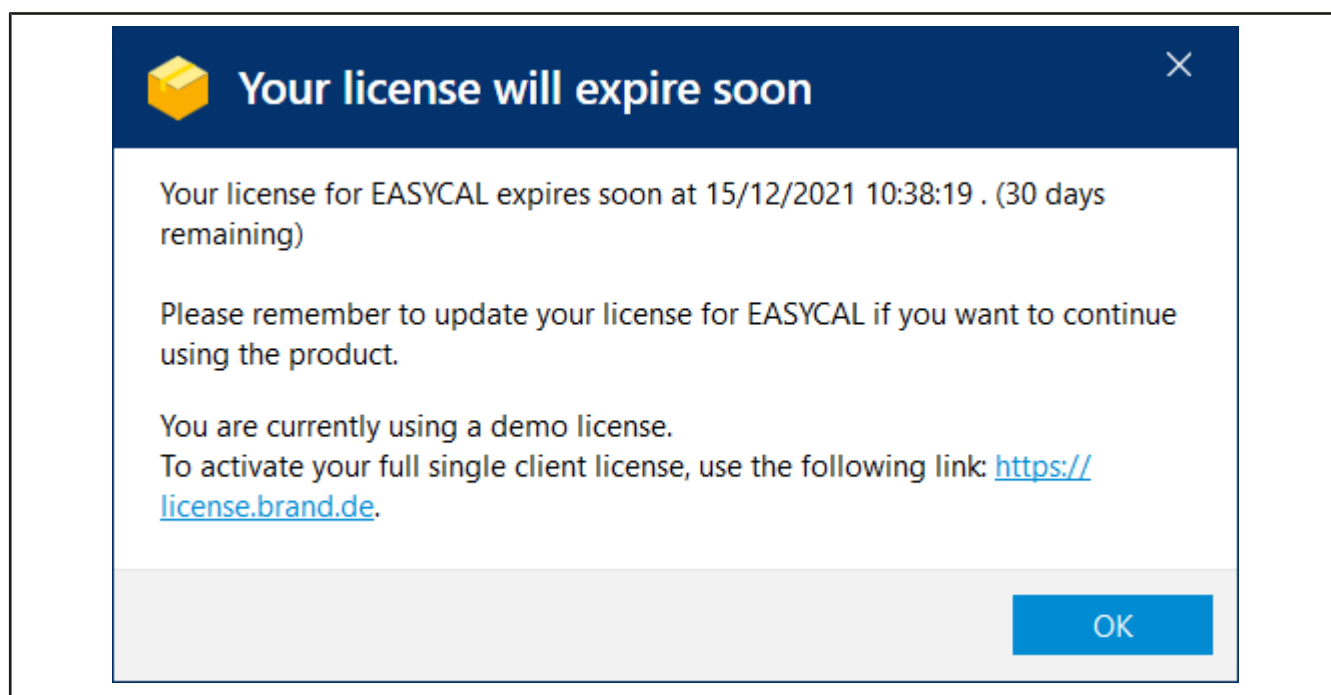


- n. Haga clic en Aceptar.
- o. Comenzando en paralelo y se EASYCAL™ 5 muestra una notificación.

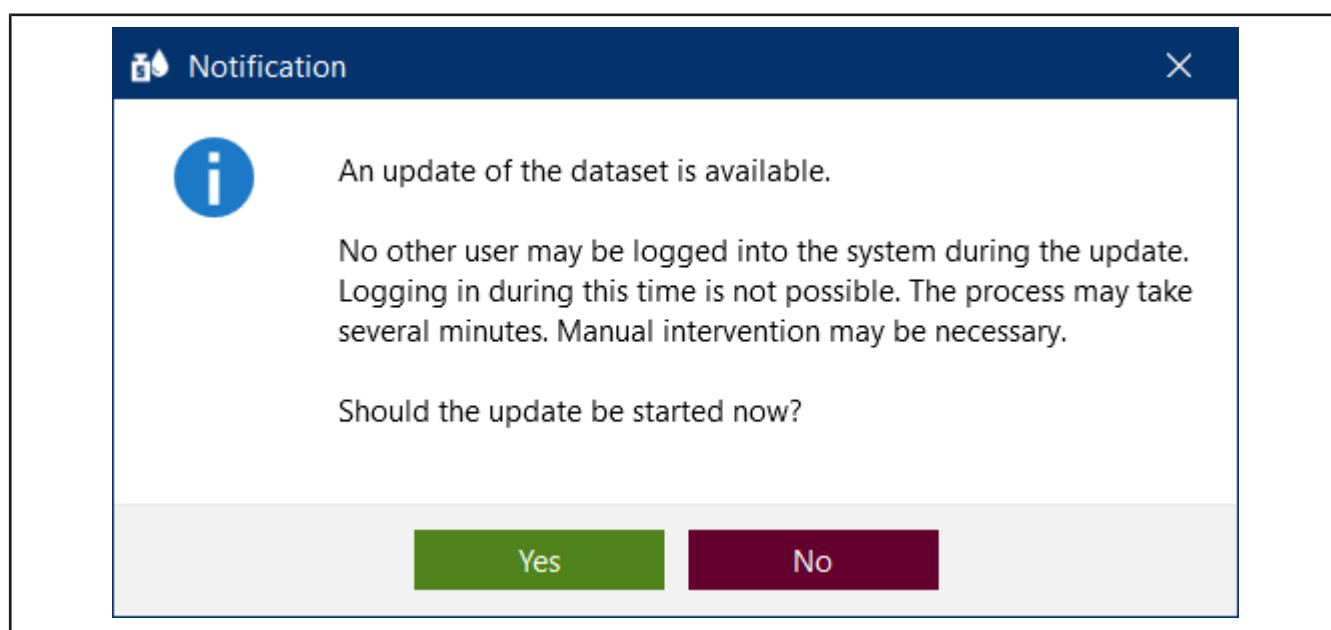


- p. Confirme la notificación haciendo clic en Sí para que la base de datos se llene inicialmente.
- q. Una notificación aparecerá después de un corto período de tiempo.

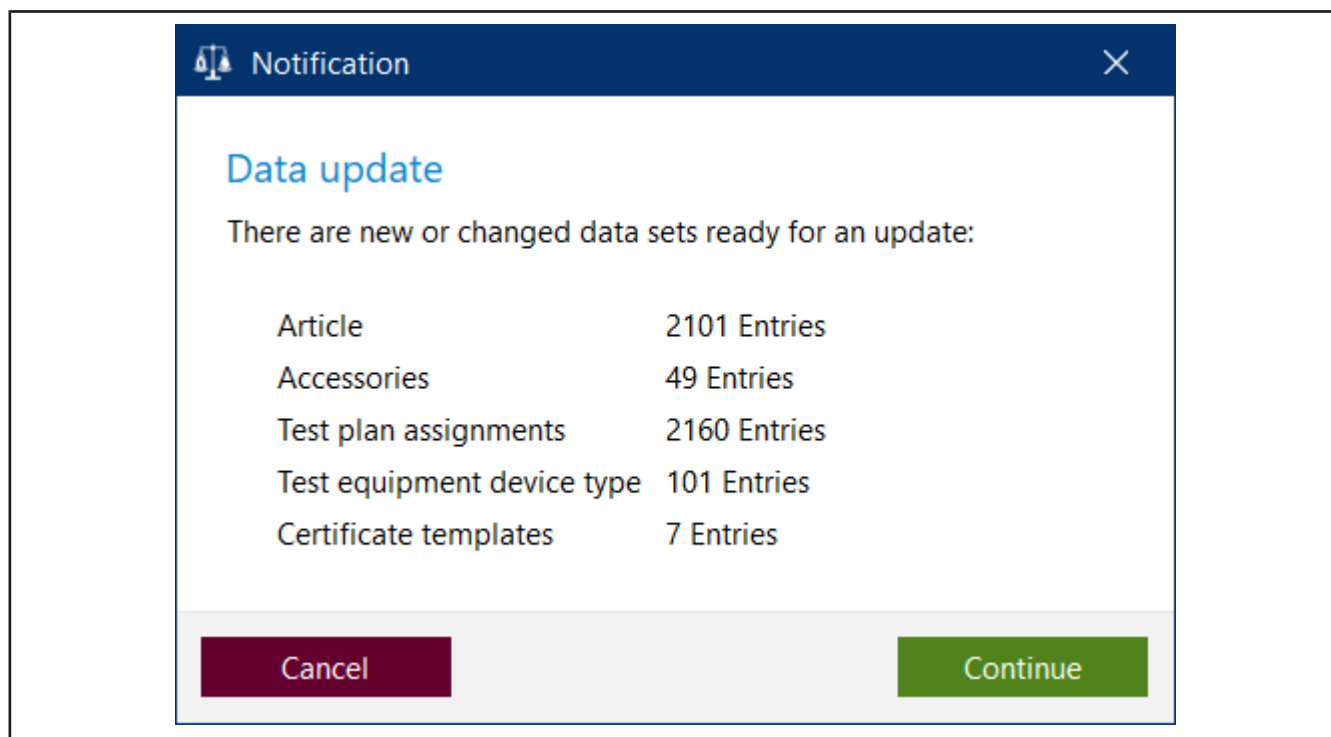


r. Restablezca la haciendo clic en Continuar.

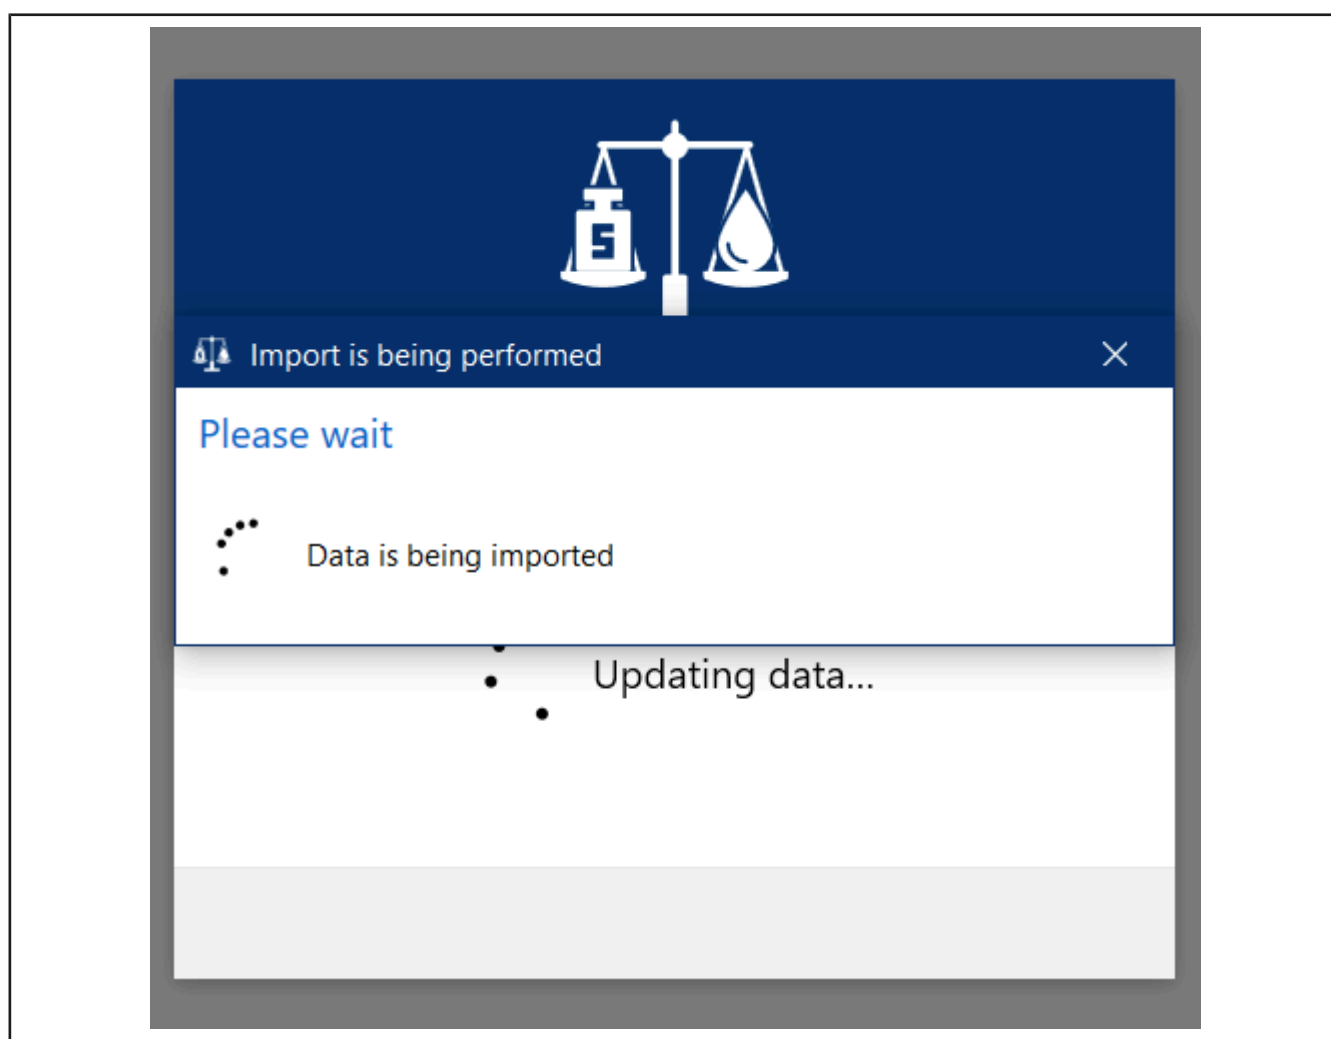

- s. Se importan los nuevos datos y se muestra el progreso.

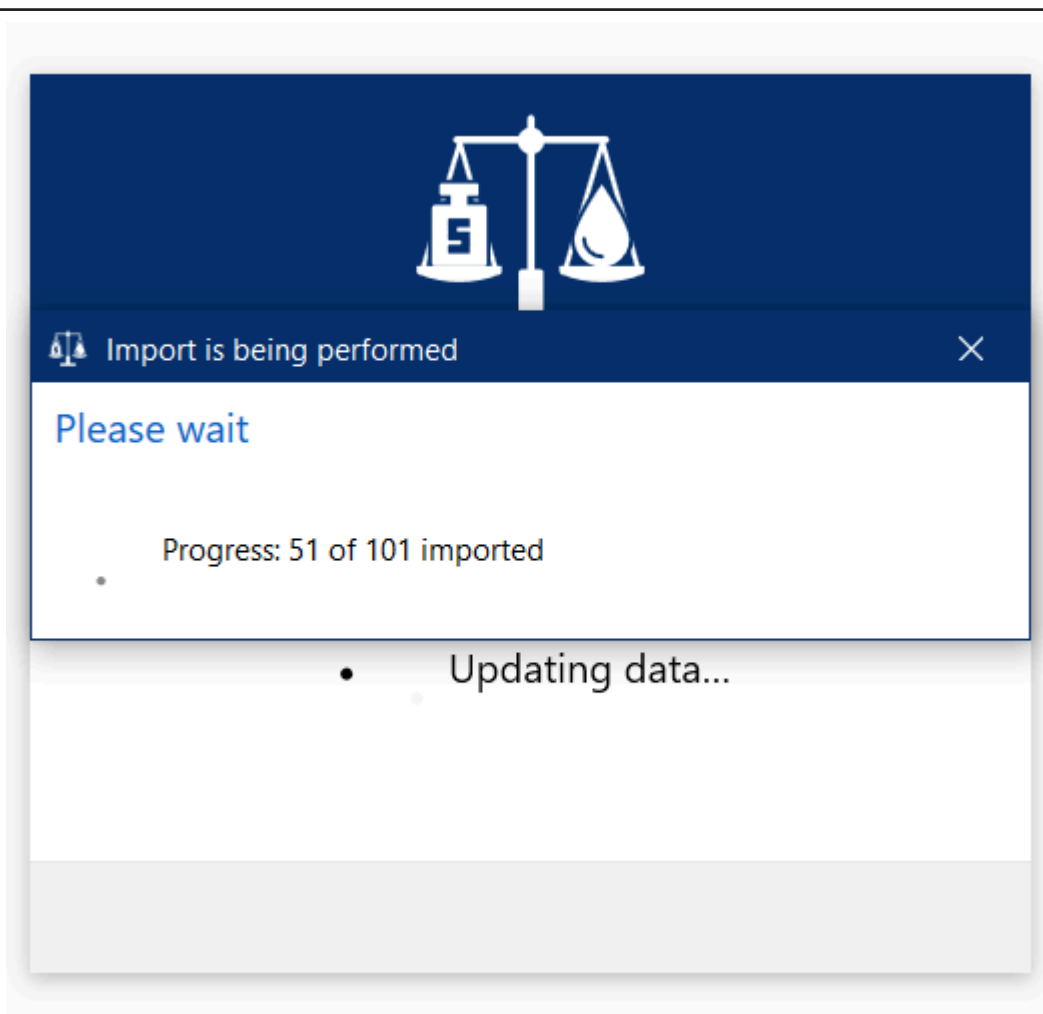


- Después de un tiempo, aparece una notificación que indica que la actualización ha finalizado.

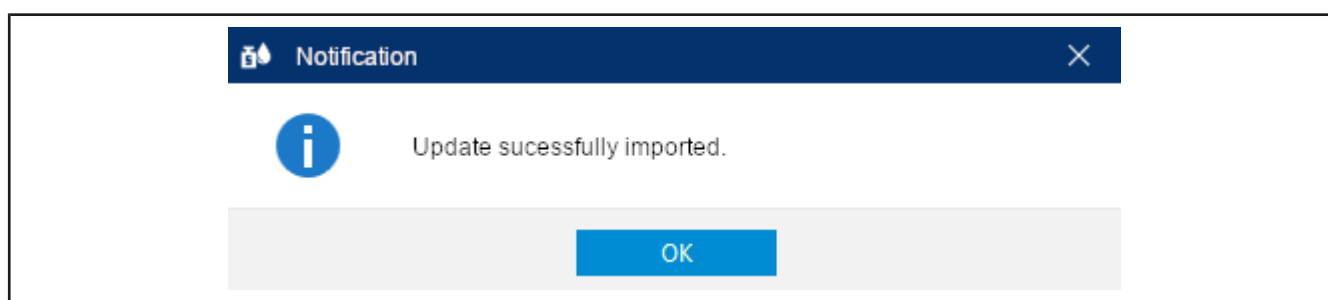

- t. Restablezca la haciendo clic en Aceptar.

- EASYCAL™ 5 iniciando. Aparecen varios mensajes para mostrar el progreso.

- Aparecerá una advertencia indicando que está utilizando una versión de demostración. Lea las notas.

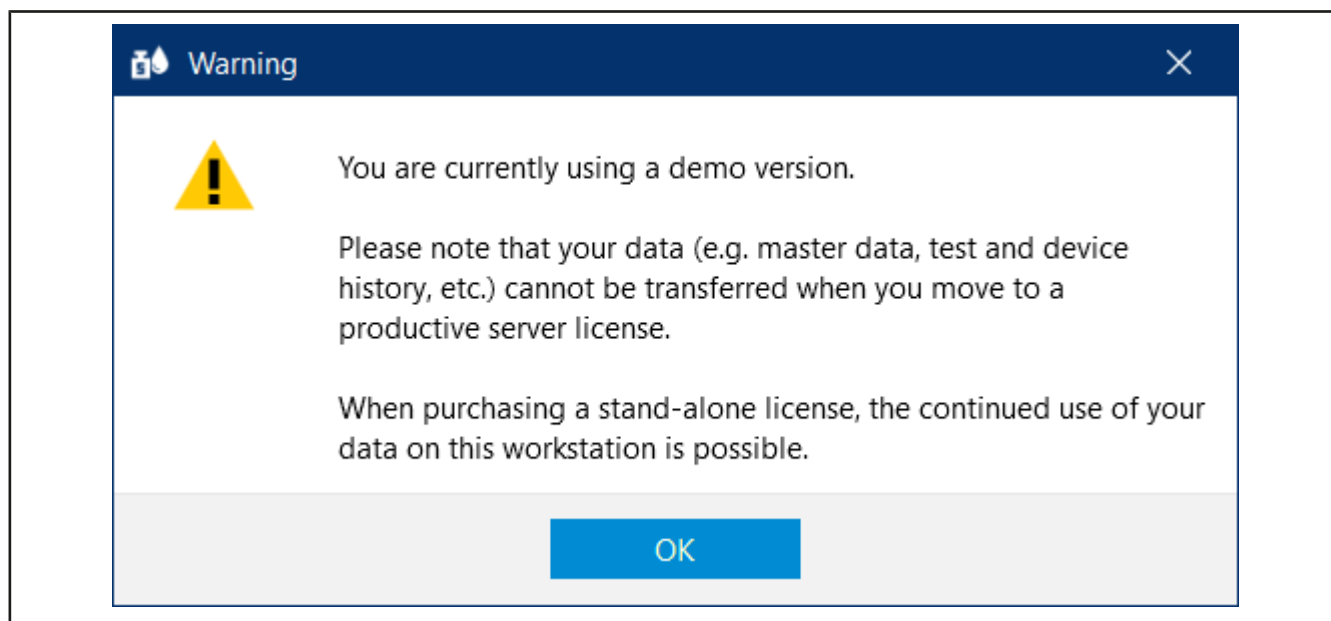

- u. Después de aceptar la advertencia, estará EASYCAL™ 5 listo para realizar la prueba.
- Se iniciará sesión automáticamente como administrador de EASYCAL. Tenga en cuenta que EASYCAL™ 5 después de la instalación, siempre se inicia en modo de usuario único. Puede cambiar esto más adelante en la configuración global, pero no debe hacerlo en este momento.

3 Introducción a EASYCAL™ 5

3.1 Tutorial

Este ejemplo muestra el proceso de una prueba, desde la creación de un encargo y el control, hasta la impresión del certificado. La sección se refiere a los datos maestros disponibles en la licencia de prueba y sirve como primera introducción al programa.

Inicio de sesión

Al iniciar el programa EASYCAL™ 5, aparece un cuadro de diálogo para iniciar sesión. Aquí el usuario se registra con el nombre de usuario y la contraseña.

3.1.1 Ajuste de la balanza como equipo de prueba

Para ajustar la balanza como equipo de prueba, proceda del siguiente modo. El ajuste se realiza siempre en el siguiente orden: ajuste del equipo de prueba en los datos maestros, ajuste del equipo de prueba en el lugar de trabajo y selección del equipo de prueba para los encargos.

Requisito:

- ✓ Ha conectado una balanza al lugar de trabajo.
 - ✓ Conoce los parámetros de conexión de la balanza.
 - ✓ Sabe a qué puerto COM está conectada la balanza en el lugar de trabajo.
- a. Asigne un nombre a la escala; consulte Administración > Mantenimiento de datos maestros > Equipo de prueba > Equipo de prueba.
 - b. Ajuste la ubicación del equipo de prueba (si aún no se ha hecho).
 - c. Configure la balanza como equipo de prueba, véase Tipo de aparato del equipo de prueba. Al hacerlo, especifique tanto la función como la conexión de la balanza al lugar de trabajo, véase Función de medición, Comunicación.
- Cierre este menú. Cambie al menú Ajustes.
- d. Registre la balanza como equipo de prueba en el lugar de trabajo, véase Ajustes > Ajustes del lugar de trabajo > Equipo de prueba.
 - e. Seleccione la balanza y la conexión para el lugar de trabajo. Además, puede comprobar la conexión a la balanza.
- Cierre este menú. Cambie al menú Encargos y certificados de calibración.
- f. En el encargo, puede seleccionar la balanza conectada en la selección del equipo de prueba. En el tutorial, consulte Determinar el equipo de prueba, p. 114, en el manual del usuario en Seleccionar el equipo de prueba para la prueba.

3.1.2 Crear encargo

- a. Navegar de Menú principal a Encargos y certificados de calibración.

Encargos y certificados de calibración

Tipo de filtro de prueba: Sin datos Búsqueda: de: 30/08/2022 hasta: 14/09/2022

Vista general del encargo Certificado de calibración

ID del encargo	Tipo de prueba	Número de encargo	Número de lote	Artículo
----------------	----------------	-------------------	----------------	----------

Atrás Certificados por lotes - Buscar e imprimir Inspección de aparatos individuales **Crear encargo** Abrir

- b. Haga clic en Crear encargo.

Seleccionar tipo de encargo

Control de lotes

Uso al comprobar muestras (cualquier tamaño).
Se emitirán certificados de lotes.

Control individual

Uso con inspección 100 % o inspección de un único aparato.
Cada aparato recibe su propio certificado.

Atrás

- c. Haga clic en Control individual.

- d. En Tipo de prueba , seleccione el valor STD - Valores estándar.

Los tipos de prueba organizan sus procesos de prueba. No puede crear tipos de prueba adicionales, sino que debe elegir entre los tipos de prueba ya establecidos. Los planes de prueba y las plantillas de certificados están vinculados al tipo de prueba. En la administración del usuario, se le debe asignar a cada usuario el permiso correspondiente para el respectivo tipo de prueba. Dado que, por el momento, usted ha iniciado sesión como administrador global, tiene acceso a todos los datos.

- e. Haga clic en el botón  en Código del artículo, para mostrar los artículos ya creados.

Código del artículo	Versión	Fabricante	Producto	Variación del producto	Rango de volumen	Estado
→ EC-12404	0	BRAND GMDII + CO KG	Bureta	DLAUBRAND®, llave recta, Schilling, clase AS	0,02 - 10 ml	Autorizado
→ EC-12487	0	BRAND GMBH + CO KG	Bureta	BLAUBRAND®, llave recta, Schilling, clase AS	0,05 - 25 ml	Autorizado
→ EC-12488	0	BRAND GMBH + CO KG	Bureta	BLAUBRAND®, llave recta, Schilling, clase AS	0,1 - 50 ml	Autorizado
→ EC-13044	0	BRAND GMDII + CO KG	Bureta	DLAUBRAND®, llave lateral, Schilling, clase AS	0,02 - 10 ml	Autorizado
→ EC-13047	0	BRAND GMBH + CO KG	Bureta	BLAUBRAND®, llave lateral, Schilling, clase AS	0,05 - 25 ml	Autorizado
→ EC-13048	0	BRAND GMBH + CO KG	Bureta	BLAUBRAND®, llave lateral, Schilling, clase AS	0,1 - 50 ml	Autorizado
→ EC-13913	0	BRAND GMDII + CO KG	Bureta compacta	DLAUBRAND®, clase AS	0,02 - 10 ml	Autorizado
→ EC-13916	0	BRAND GMBH + CO KG	Bureta compacta	BLAUBRAND®, clase AS	0,05 - 25 ml	Autorizado
→ EC-13918	0	BRAND GMBH + CO KG	Bureta compacta	BLAUBRAND®, clase AS	0,1 - 50 ml	Autorizado
→ EC-13963	0	BRAND GMDII + CO KG	Bureta compacta	DLAUBRAND®, clase AS, marrón	0,02 - 10 ml	Autorizado
→ EC-13966	0	BRAND GMBH + CO KG	Bureta compacta	BLAUBRAND®, clase AS, marrón	0,05 - 25 ml	Autorizado
→ EC-13968	0	BRAND GMBH + CO KG	Bureta compacta	BLAUBRAND®, clase AS, marrón	0,1 - 50 ml	Autorizado
→ EC-22521	0	BRAND GMDII + CO KG	Bureta de cero automático	DLAUBRAND®, según Pellet, sin llave intermedia, clase AS	0,02 - 10 ml	Autorizado
→ EC-22522	0	BRAND GMBH + CO KG	Bureta de cero automático	BLAUBRAND®, según Pellet, sin llave intermedia, clase AS	0,05 - 25 ml	Autorizado
→ EC-22523	0	BRAND GMBH + CO KG	Bureta de cero automático	BLAUBRAND®, según Pellet, sin llave intermedia, clase AS	0,1 - 50 ml	Autorizado
→ EC-22524	0	BRAND GMDII + CO KG	Bureta de cero automático	DLAUBRAND®, según Pellet, con frasco, sin llave intermedia, clase AS	0,02 - 10 ml	Autorizado
→ EC-22528	0	BRAND GMBH + CO KG	Bureta de cero automático	BLAUBRAND®, según Pellet, con frasco, sin llave intermedia, clase AS	0,05 - 25 ml	Autorizado
→ EC-22530	0	BRAND GMBH + CO KG	Bureta de cero automático	BLAUBRAND®, según Pellet, con frasco, sin llave intermedia, clase AS	0,1 - 50 ml	Autorizado

- f. En el campo de búsqueda, ingrese Transferpette S 1000. Mientras escribe, observe cómo se modifica la selección de artículos. Este comportamiento es igual en todos los campos de búsqueda EASYCAL™ 5. Recomendamos utilizar siempre la función de búsqueda en primer lugar, dado EASYCAL™ 5 se entrega con una amplia base de datos maestros.

El prefijo EC- indica que se trata de un juego de datos predefinido e invariable. Si desea modificar estos

juegos de datos, copie el juego de datos, edítelo y guárdelo bajo otro nombre. Para más información, véase la sección de Ayuda en EASYCAL™ 5.

Control individual - Crear encargo

Tipo de prueba: STD - Valor estándar | Número de aparatos: 1 | Cliente: []

Número de encargo: [] | N.º de orden de compra: []

Código del artículo: [] | Número AB: []

Artículo: []

Rangos de volumen: []

Plan de prueba: []

Selección artículo

Búsqueda: Transf

Código del artículo	Versión	Fabricante	Producto	Variación del producto	Rango de volumen	Estado
EC-30001000	0	Ireff AG	IreffLab-Transferpette® S	Fix	10 µl	Autorizado
EC-30001001	0	Treff AG	TreffLab-Transferpette® S	Fix	20 µl	Autorizado
EC-30001002	0	Treff AG	TreffLab-Transferpette® S	Fix	25 µl	Autorizado
EC-30001003	0	Treff AG	TreffLab-Transferpette® S	Fix	50 µl	Autorizado
EC-30001004	0	Ireff AG	IreffLab-Transferpette® S	Fix	100 µl	Autorizado
EC-30001005	0	Treff AG	TreffLab-Transferpette® S	Fix	200 µl	Autorizado
EC-30001006	0	Treff AG	TreffLab-Transferpette® S	Fix	500 µl	Autorizado
EC-30001007	0	Treff AG	TreffLab-Transferpette® S	Fix	1000 µl	Autorizado
EC-30001010	0	Treff AG	TreffLab-Transferpette® S	Variable	0,1 - 1 µl	Autorizado
EC-30001011	0	Treff AG	TreffLab-Transferpette® S	Variable	0,1 - 2,5 µl	Autorizado
EC-30001012	0	Treff AG	TreffLab-Transferpette® S	Variable	0,5 - 10 µl	Autorizado
EC-30001013	0	Ireff AG	IreffLab-Transferpette® S	Variable	2 - 20 µl	Autorizado
EC-30001014	0	Treff AG	TreffLab-Transferpette® S	Variable	10 - 100 µl	Autorizado
EC-30001015	0	Treff AG	TreffLab-Transferpette® S	Variable	20 - 200 µl	Autorizado
EC-30001016	0	Treff AG	TreffLab-Transferpette® S	Variable	100 - 1000 µl	Autorizado
EC-30001017	0	Ireff AG	IreffLab-Transferpette® S	Variable	500 - 5000 µl	Autorizado
EC-30001018	0	Treff AG	TreffLab-Transferpette® S	Variable	1000 - 10000 µl	Autorizado
EC-30001020	0	Treff AG	TreffLab-Transferpette® T	Variable	0,1 - 1 µl	Autorizado

- g. Seleccione el código de artículo EC-704780. Confirme su selección haciendo doble clic.
- h. En Plan de prueba, seleccione el plan de prueba correspondiente. Por lo general, aquí encontrará 1 – 2 entradas.
- i. En el plan de prueba se encuentran las condiciones marco para la prueba y los límites de error del artículo asignado.

Control individual - Crear encargo

Tipo de prueba: STD - Valor estándar | Número de aparatos: 1 | Cliente: []

Número de encargo: [] | N.º de orden de compra: []

Código del artículo: EC-704780 | Número AB: []

Artículo: **Transferpette® S (hasta 2019)**
Variable
BRAND GMBH + CO KG

Indicaciones sobre el encargo: []

Rangos de volumen: 1000 µl (100 - 1000) [+]

Plan de prueba: 325.0 - EC-STD-ISO-PIp-1000 []

Comenzar comprobación


- j. Haga clic en Iniciar prueba.

Aparece una notificación de que no se ha ingresado ningún número de encargo.


Si en su empresa/proceso de gestión de calidad existen indicaciones para la organización de las pruebas, seleccione No y asigne un número de encargo.

Si no existen indicaciones para la organización de las pruebas, seleccione Sí y EASYCAL™ 5 asignará un número de encargo inequívoco.

Recomendamos determinar un procedimiento uniforme de manera anticipada.

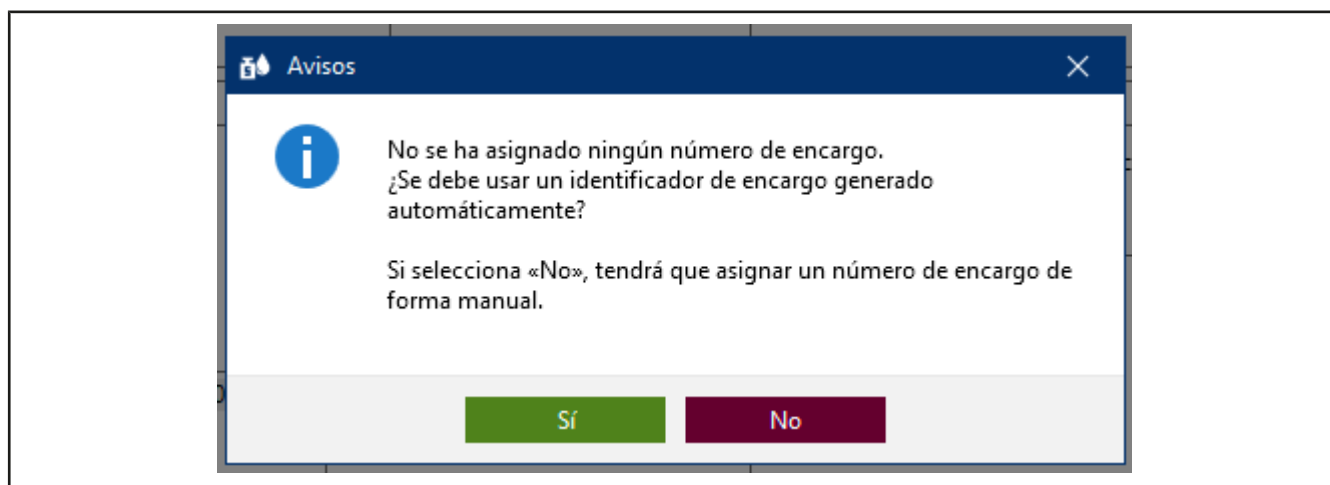

- k.** Continúe con el tutorial haciendo clic en Sí. El número de encargo se determina sobre la base de la fecha actual.

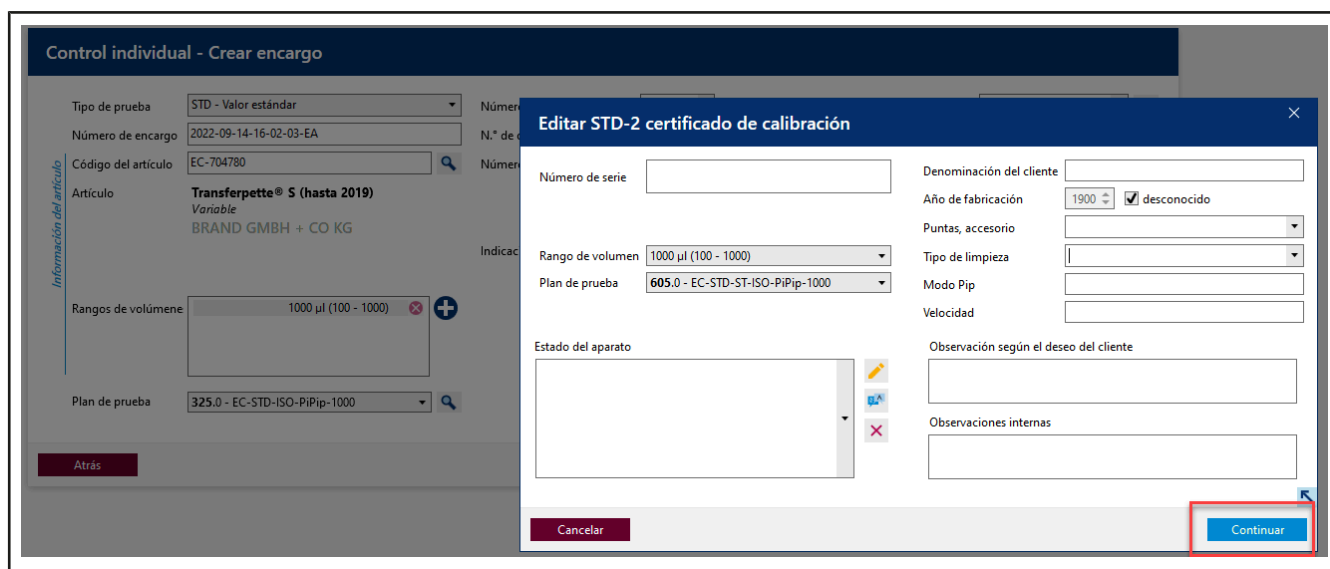

- l.** Puede ingresar un número de serie para identificar el equipo. Esto es necesario para las pruebas reales. No obstante, no es necesario para el tutorial.

- m.** Haga clic en Continuar. Se ha creado el encargo de prueba.

Se abre una ventana para iniciar la prueba real.

3.1.3 Determinar el equipo de prueba

Requisito:


- ✓ El encargo ha sido creado.

- a. En los equipos de prueba, se encuentran preseleccionados tanto los parámetros necesarios como el tipo de equipo de prueba y el equipo de prueba (número de equipo de prueba). Como solo se ha creado un equipo de prueba, lo dejamos en esta selección.

3.1.4 Realizar la prueba

- a. Continúe haciendo clic en Próximo criterio.

Verá la pantalla de ingreso central de la función de medición de EASYCAL™ 5.

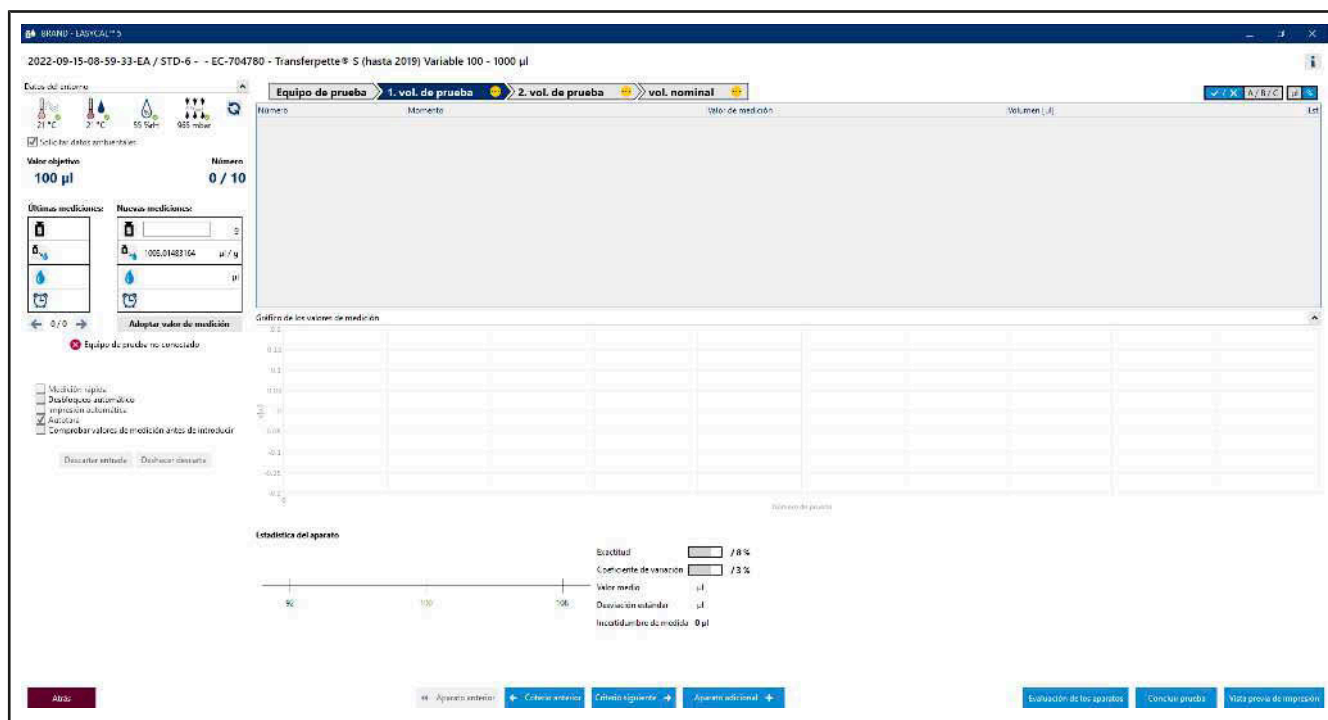

- b. En Nueva medición , ingrese valores de pesaje ficticios. Comience con 0 , 1 y haga clic en „Adoptar valor de medición. Aparecerá una ventana en la cual deberá ingresar o completar los valores de medición.

La selección del separador (coma o punto) se realizará en función de la selección del idioma en el software.

Introducir valores de medición

Diferencia de temperatura	0,00 °C	0,5 °C	
Valor de pesaje	0,0999	g	☒ Manual
Temperatura del aire	0	°C	☒ Manual
Temperatura del medio	0	°C	☒ Manual
Humedad rel. del aire	0	%rh	☒ Manual
Presión atmosférica	0	mbar	☒ Manual

Cancelar
Adoptar

- c. Ingrese valores ficticios para los parámetros ambientales del siguiente modo:

Introducir valores de medición

Diferencia de temperatura	0,00 °C	0,5 °C	
Valor de pesaje	0,0999	g	☒ Manual
Temperatura del aire	21	°C	☒ Manual
Temperatura del medio	21	°C	☒ Manual
Humedad rel. del aire	55	%rh	☒ Manual
Presión atmosférica	965	mbar	☒ Manual

Cancelar
Adoptar

- d. Haga clic en Adoptar. De este modo, finaliza la primera medición. El valor de medición y el volumen calculado a partir de este aparecerán en la tabla.

Equipo de prueba > 1. vol. de prueba > 2. vol. de prueba > vol. nominal				
Número	Momento	Valor de medición	Volumen (µl)	Estado
1	14/09/2022 17:30:09	0,099900 g	100,201	

- e. A continuación, ingrese del mismo modo 8 veces el valor 0,1 g como valor de medición. La tabla se completa.

2022-09-14-16-05-37-EA / STD-3 - - EC-704780 - Transfette® S (hasta 2019) Variable 100 - 1000 µl

Valores del encargo

Selección de datos ambientales

Valor objetivo: 100 µl

Número: 9 / 10

Últimas mediciones:

Nuevas mediciones:

Adoptar valor de medición

Equipo de prueba no conectado

Medición rápida

Desbloqueo automático

Impresión automática

Auxiliar

Comprobar valores de medición antes de introducir

Descripción entrada

Descripción salida

Apagar

Equipo anterior

Equipo siguiente

Equipo adyacente

Estadística de los aparatos

Compartir prueba

Verificar la impresión

Estadística del encargo

Exactitud

Coeficiente de variación

Valor medio

Desviación estándar

Intervalo de medición

Exactitud

Coeficiente de variación

Valor medio

Desviación estándar

Coeficiente de variación de las mediciones

Valor medio CV

Equipo de prueba > 1. vol. de prueba > 2. vol. de prueba > vol. nominal

Número	Momento	Valor de medición	Volumen (µl)	Estado
1	14/09/2022 18:04:15	0,099900 g	100,201	
2	14/09/2022 18:04:21	0,099900 g	100,201	
3	14/09/2022 18:04:29	0,099900 g	100,201	
4	14/09/2022 18:04:34	0,099900 g	100,201	
5	14/09/2022 18:04:39	0,099900 g	100,201	
6	14/09/2022 18:04:44	0,099900 g	100,201	
7	14/09/2022 18:04:48	0,099900 g	100,201	
8	14/09/2022 18:04:53	0,099900 g	100,201	
9	14/09/2022 18:05:08	0,099900 g	100,201	
10	14/09/2022 18:05:11	0,099900 g	100,201	

Gráfico de los valores de medición

Estadística del aparato

Exactitud: 0,29 % / 8 % ✓

Coeficiente de variación: 0 % / 1 % ✓

Valor medio: 100,29 µl

Desviación estándar: 0 µl

Intervalo de medición: 0 µl

Estadística del encargo

Exactitud: 0,29 %

Coeficiente de variación: 0 %


Valor medio: 100,29 µl

Desviación estándar de los valores medios: 0 µl


Coeficiente de variación de las mediciones: 0 %

Valor medio CV: 0 %

- f. El color celeste en el área superior de la tabla indica que se está procesando el encargo. Haga clic en el icono  para mostrar y volver a ocultar la información de certificado ampliada.
- g. Vuelva a ingresar 0,1 como valor de medición y observe la visualización del proceso a través de la tabla de valores de medición.

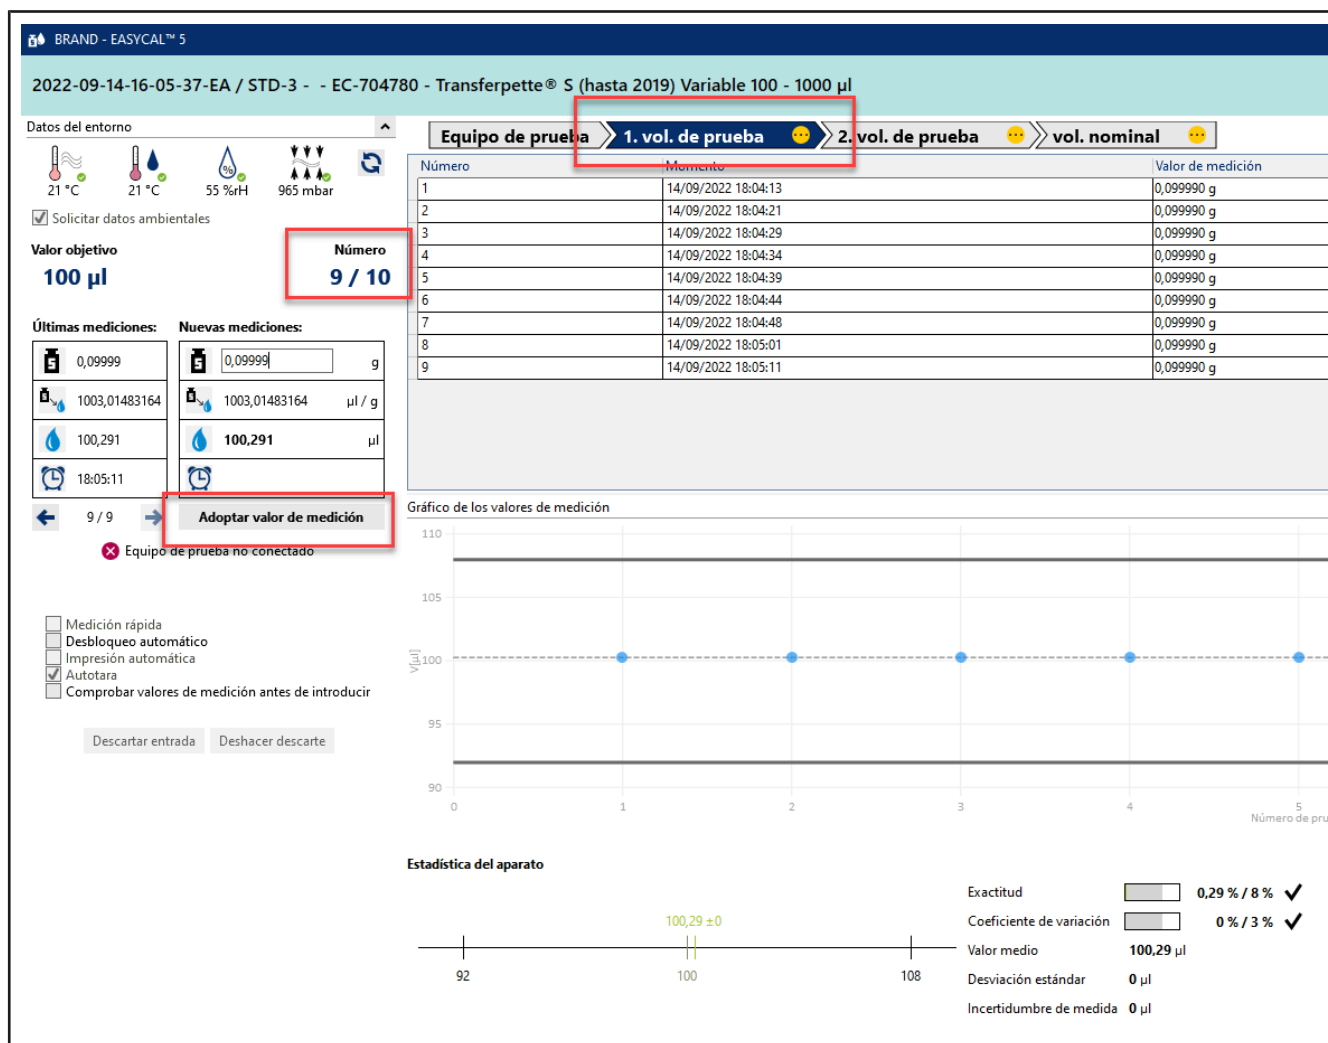

- h. Al ingresar el décimo valor de medición, se realizan todas las mediciones requeridas para el criterio 2. TV. El criterio recibe una marca de verificación verde. Puede ingresar más valores de medición, pero no es obligatorio.

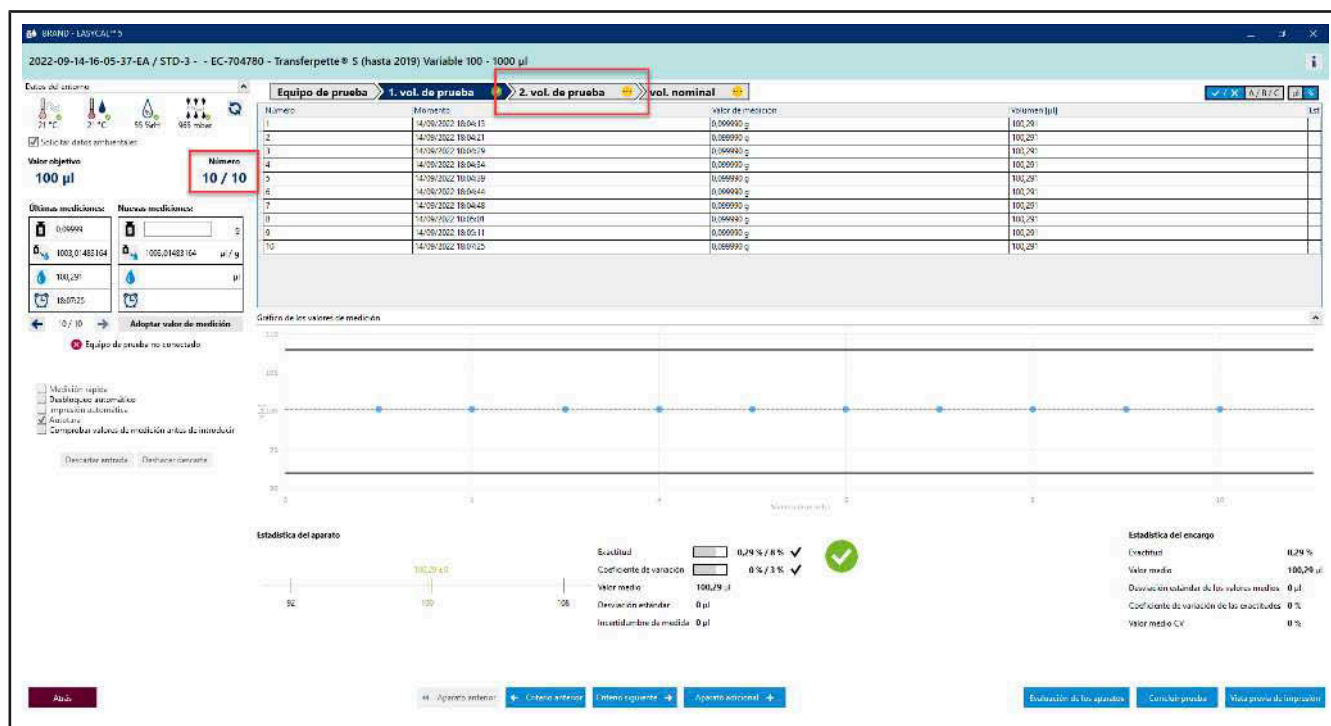

i. En el indicador del progreso, haga clic en 1 . TV para saltar al siguiente criterio.

j. Introduzca los siguientes valores en Nueva medición orden secuencial:

0,498

0,499


0,500

Repita esto 2 veces.


➤ En la pantalla Gráfico de los valores de medición , verá la situación de cada valor de medición en referencia a los límites de error definidos (líneas continuas) y el valor medio calculado. En Estadística del equipo, verá los valores reales calculados para la exactitud y el coeficiente de variación en comparación con los valores límite definidos.



k. Vuelva a ingresar 0,498 como valor de medición, confirme los parámetros ambientales y haga clic en NV en el indicador del progreso. A continuación, ingrese 1 como valor de medición.

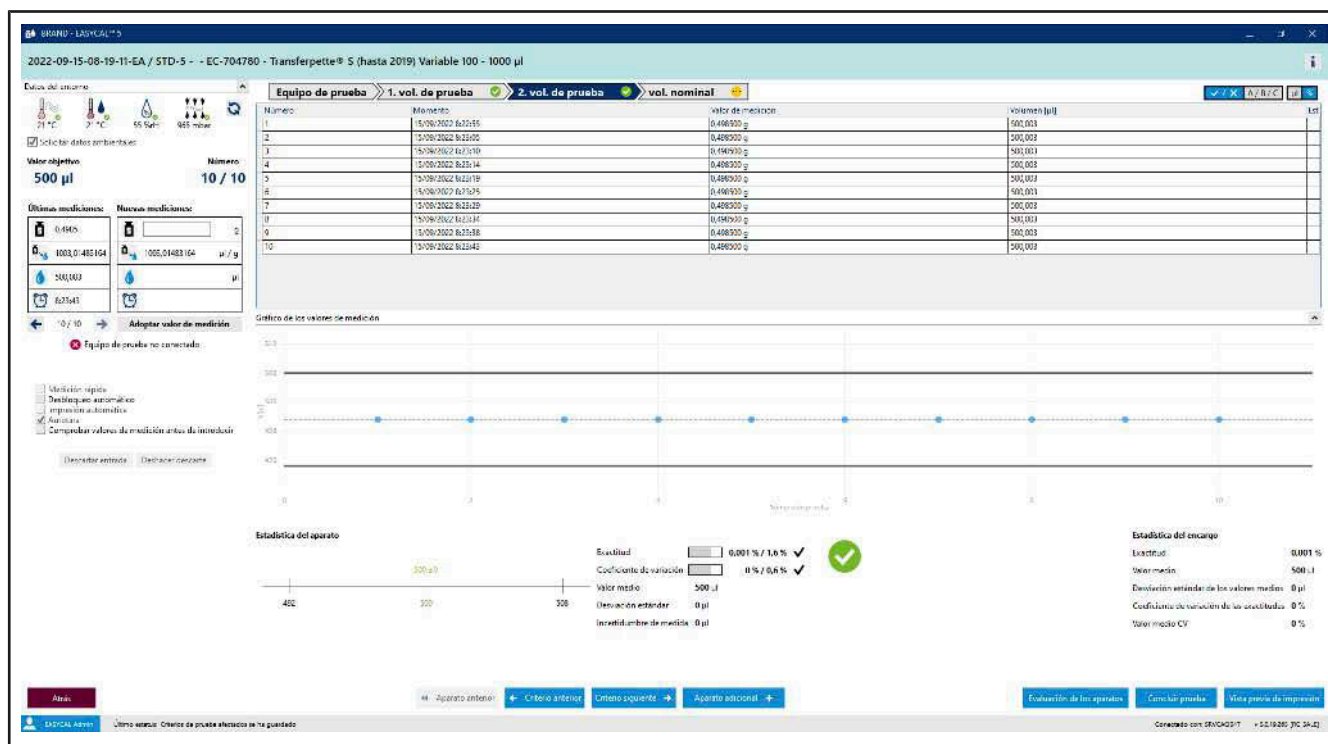


- l. Supongamos que ha cometido un error de escritura. Ingrese 1, 1 como valor de medición y confirme los parámetros ambientales. Aparece una advertencia:

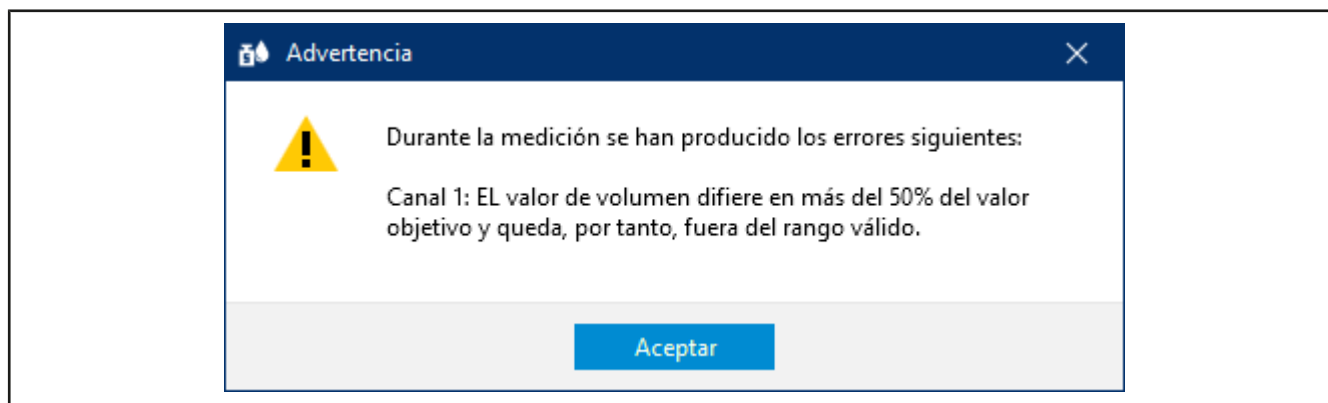

- m. Restablezca la advertencia haciendo clic en Aceptar .

Verá que las diferentes áreas de la pantalla de ingreso reaccionarán en función del nuevo valor de medición. No puede borrar este valor de medición, pero lo puede desechar. El valor permanecerá visible, pero ya no será utilizado para la estadística.

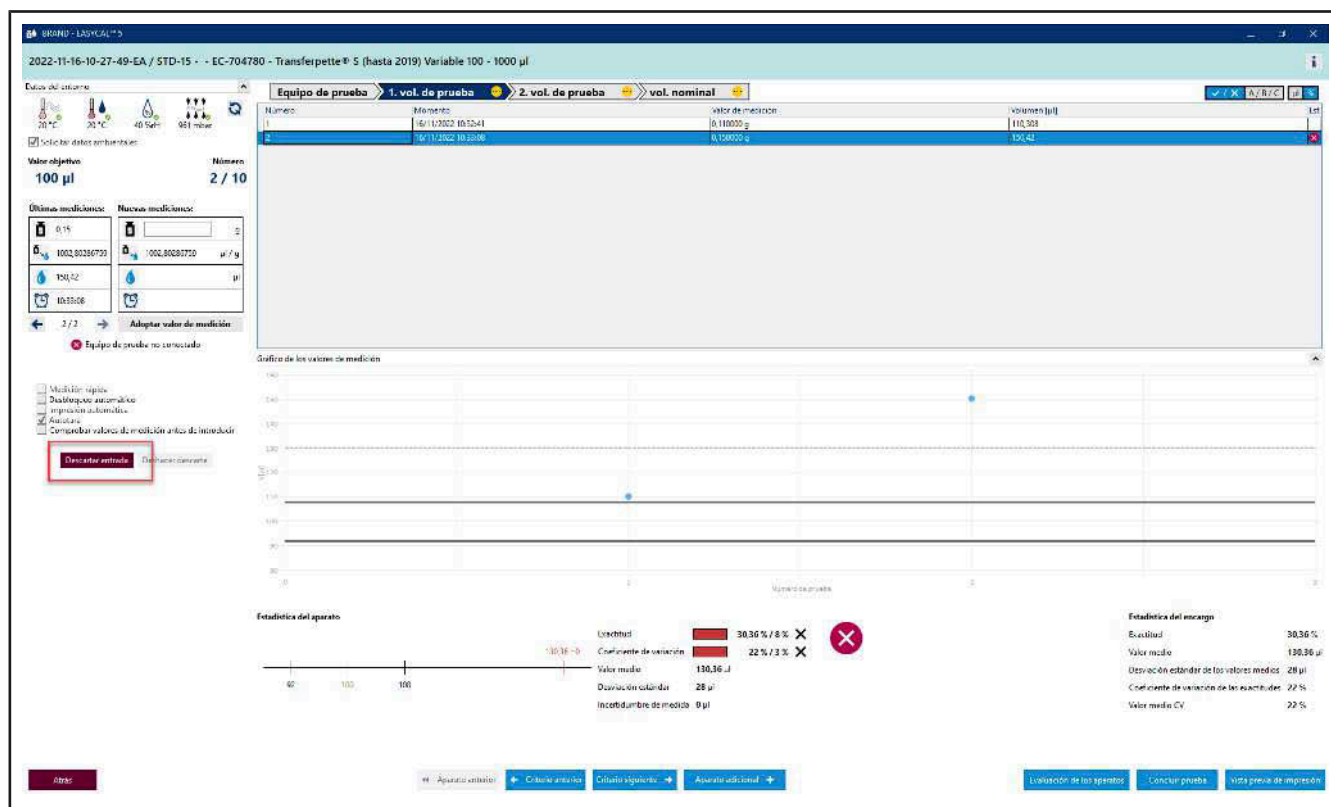


n. Haga clic en el número de la medición en la tabla y, a continuación, haga clic en la entrada.

Aparece una nota.

The screenshot shows a dialog box titled 'Descartar medidas' (Discard measurements). The dialog box contains the following elements:


- Header:** A blue bar with the title 'Descartar medidas' and a close button (X).
- Text:** 'Especifique un motivo para descartar las mediciones seleccionadas.' (Specify a reason to discard the selected measurements.)
- Dropdown Menu:** A dropdown menu with the selected option 'Eliminado al principio o al final de la serie de medición.' (Deleted at the beginning or end of the measurement series.)
- Buttons:** Two buttons at the bottom: 'Cancelar' (Cancel) and 'Continuar' (Continue).

o. Ingrese un motivo, por ejemplo Identificado como un valor atípico. Como alternativa, puede seleccionar un motivo del menú desplegable. Estos textos se pueden actualizar en los datos maestros. Confirme su selección haciendo clic en Continuar.

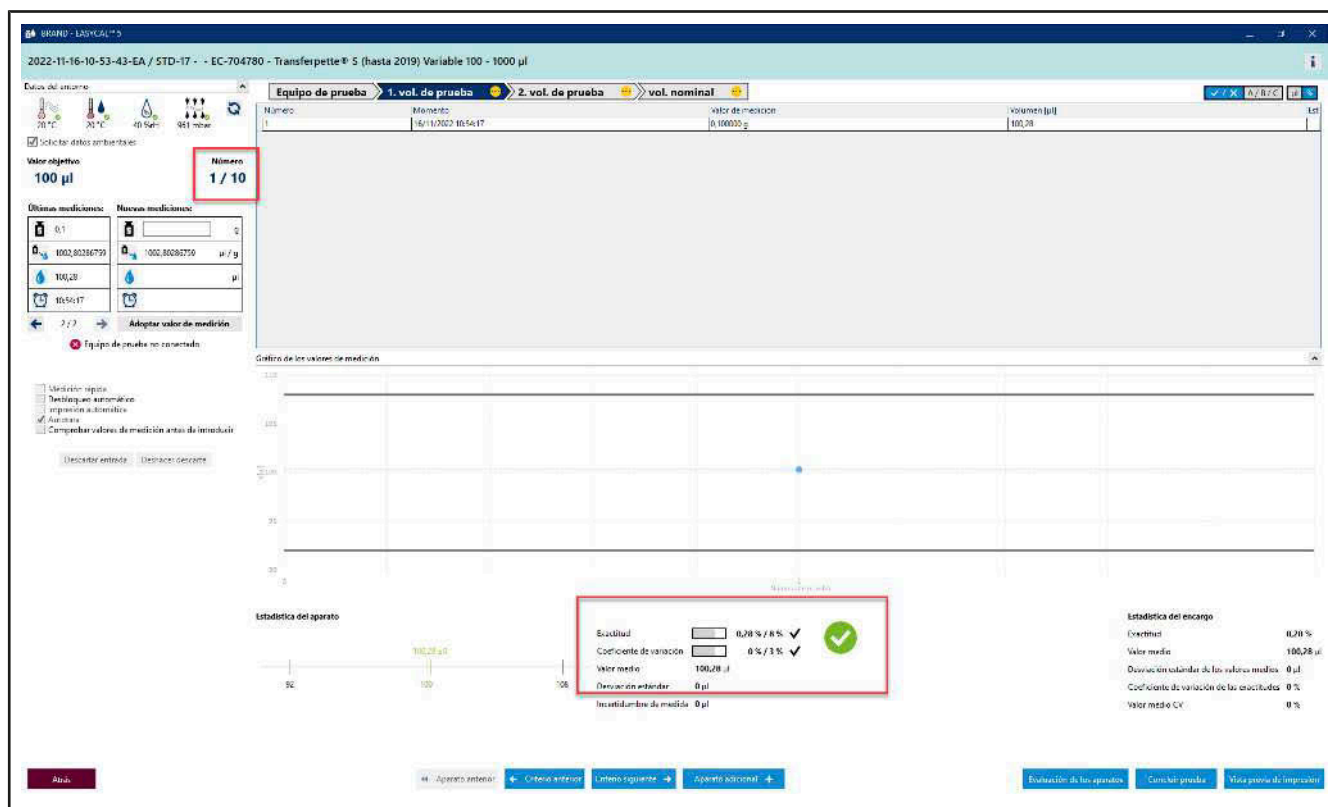

p. El valor de medición 1, 1 ya no se considera en la evaluación.

q. Continúe ingresando valores de medición hasta que se detenga en el número 10/10. Al ingresar el último valor de medición necesario, el color en el área sobre la tabla cambiará de celeste a amarillo. Esto le indicará que el encargo ha finalizado.

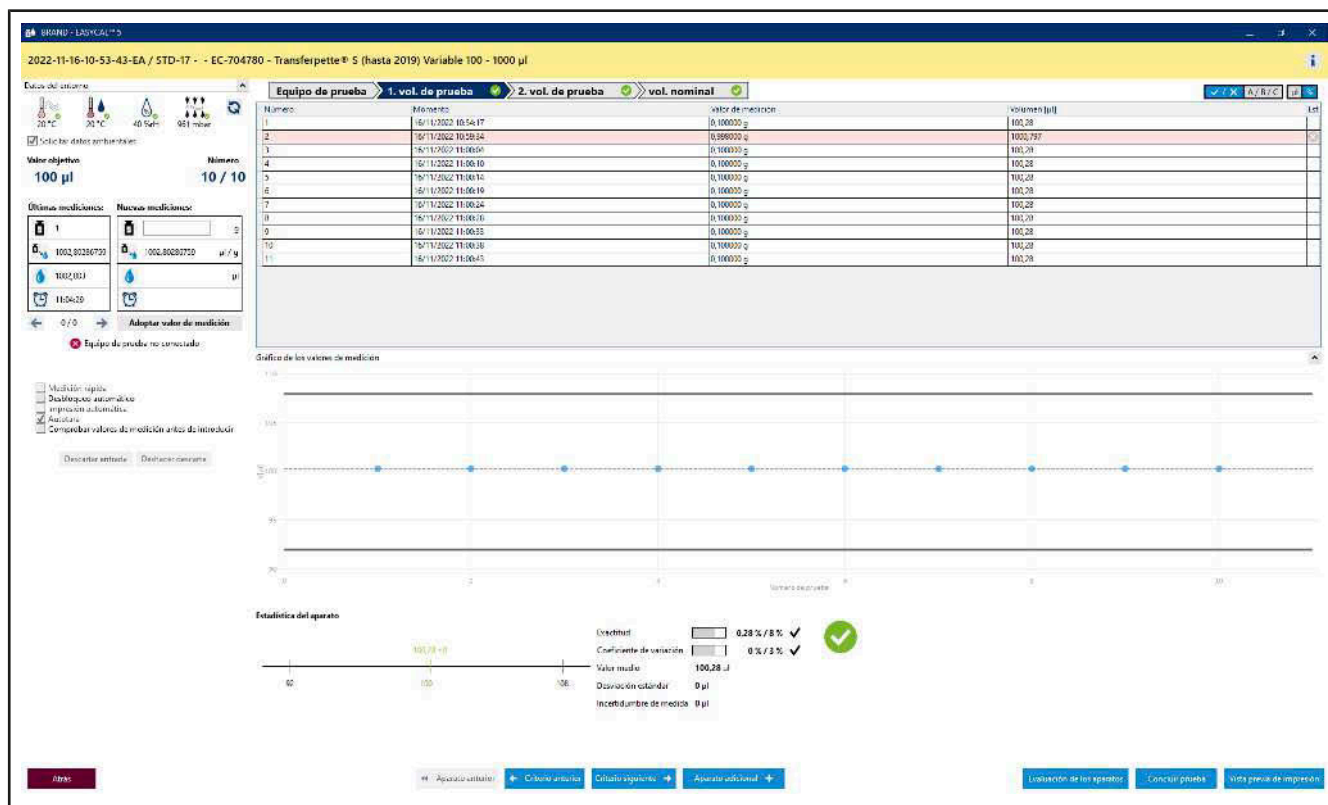

A continuación, todos los criterios del indicador de progreso tendrán una marca de verificación verde. El valor de medición desechado se mostrará en rosa.

3.1.5 Finalizar prueba

a. Haga clic en Finalizar prueba.

- b. A continuación, verá el encargo con un resumen de las mediciones del respectivo criterio de prueba. Haga clic en Imprimir protocolo interno.

EASYCAL™ 5
Resultados de la auditoría

Test-Company

Resumen de la auditoría
Número de protocolo: 2023-11-16-10-53-43-EA
Cantidad de bits de 1: 1000 bits

Tipos de ensayo: STD - Valor estándar
Artículo: PC-734750
Transparencia: 5 (media 2012) Versión: 101 - 1000 µl

2. Tolerancias
Límite de error (µl): 1
Estandar (CV) (µl): 0.5
Coeficiente de variación (CV) (µl): 0.3

3. Estado del encargo: **Completado**
Equipos de prueba en mano: 76.750 (aproximadamente 10.000) unidades

4. Resultados de los aparatos (con tolerancias del aparato)

Nº Aparato	Característica de prueba	Medida (µl)	Desviación (CV) (%)	Característica de referencia (µl)	Medida (µl)	Desviación (CV) (%)	Desviación de la referencia (%)
1	100 µl	9.5%	0.5%	100.00 µl	9.5%	0.5%	0.0%
2	100 µl	9.5%	0.5%	100.00 µl	9.5%	0.5%	0.0%
3	100 µl	9.5%	0.5%	100.00 µl	9.5%	0.5%	0.0%

Barra de herramientas: Atrás, Imprimir, Guardar como PDF, Guardar e imprimir

- c. Verá el editor de certificados en el modo de visualización. Aquí puede imprimir o exportar el protocolo presentado.
- d. Cierre el editor de certificados haciendo clic Atrás.

BRAND - EASYCAL™ 5

Encargo 2022-11-16-10-53-43-EA

Tipo de prueba: STD - Valor estándar Artículo: EC-704780 - Transferpette® 5 (hasta 2019) Variable 100 - 1000 µl

Número de encargo: 2022-11-16-10-53-43-EA Plan de prueba: 325.0 - EC-STD-ISO-PiP-1000

Tipo de encargo: Control individual Auditor: E. Admin

Tamaño de lote: 1 Fecha de calibración: 16/11/2022

Tamaño de muestra: 1 / 1 N° de orden de compra: Cliente: Cliente final:

Estado: Completado Número AB: Cliente final:

Indicaciones sobre el encargo: Comunicación con el cliente:

Criterios de prueba

Criterio de prueba	Denominación	Valor obj	Valor medio	Tol obj	Tol OK	Desviación es	E% obj	E% OK	E% OK	CV % obj	CV % OK	CV % OK
1	1. vol. de prueba 100µl	100,28 µl	OK	0 µl	0 %	0,28 %	0,28 %	OK	0,3 %	0 %	0 %	OK
2	2. vol. de prueba 500µl	500,4 µl	OK	0 µl	0 %	0,4 %	0,4 %	OK	0,6 %	0 %	0 %	OK
3	vol. nominal 1000µl	1002,8 µl	OK	0 µl	0 %	0,8 %	0,8 %	OK	0,3 %	0 %	0 %	OK

Vista general del certificado del aparato/de calibración

Tipo de certificado de calibración	N° interno	Número de certificado de calibración	Fecha de calibración	Número de serie	Código del artículo	Rango de volumen	Pruebas reali.	Estado	Estado del aparato	Auditor	Certificado de calibración vinculado
Control individual	17	STD-17	16/11/2022		EC-704780	100 - 1000 µl	30	Completado		E. Admin	

Valoración / autorización Seguimiento interno Seguimiento certificado Certificado de calibración nuevo

Atás Volver a la vista general del encargo Guardar

e. Haga clic en Valoración/autorización.

Valoración / autorización

Act. Estado: Completado

Estatus nuevo: Completado

Observaciones:

☒ Adoptar para todo

☐ Sobrescribir todo

Cancelar Guardar

f. En la ventana que se abre, seleccione Autorizado y restablezca la entrada con Guardando....

BRAND - EASYCAL™ 5

Encargo 2022-11-16-10-53-43-EA

Tipo de prueba: STD - Valor estándar Artículo: EC-704780 - Transfepette® 5 (hasta 2019) Variable 100 - 1000 µl

Número de encargo: 2022-11-16-10-53-43-EA Plan de prueba: 325.0 - EC-STD-ISO-PiPip-1000

Tipo de encargo: Control individual Auditor: E. Admin

Tamaño de lote: 1 Fecha de calibración: 16/11/2022

Tamaño de muestra: 1 / 1 N.º de orden de compra: Cliente: Cliente final:

Estado: Completado Número AB: Cliente final:

Indicaciones sobre el encargo: Comunicación con el cliente:

Criterios de prueba:

Criterio de prueba	Denominación	Valor obj	Valor medio	Tol objet	Tol OK	Desviación es E%	obj E%	E% OK	CV % obj	CV %	CV % OK
1	1. vol. de prueba 100µl	100,28 µl	OK	0 µl	0 µl	0,28 %	0,28 %	OK	0,3 %	0 %	0 % OK
2	2. vol. de prueba 500µl	500,4 µl	OK	0 µl	0 µl	1,6 %	0,08 %	OK	0,6 %	0 %	0 % OK
3	vol. nominal 1000µl	1002,8 µl	OK	0 µl	0 µl	0,8 %	0,28 %	OK	0,3 %	0 %	0 % OK

Vista general del certificado del aparato/de calibración

Tipo de certificado de calibración	N.º interno	Número de certificado de calibración	Fecha de calibración	Número de serie	Código del artículo	Rango de volumen	Pruebas reales	Estado	Estado del aparato	Auditor	Certificado de calibración vinculado
Control individual	17	STD-17	16/11/2022		EC-704780	100 - 1000 µl	30	Completado		E. Admin	

Valores / autorización Registro protocolo interno **Registro certificados** Certificado de calibración nuevo

Atrás Volver a la vista general del encargo Guardar

g. Haga clic en Imprimir certificados .

Imprimir certificados


☒ Seleccionar / eliminar selección de todos

☒ 17 STD-17


Imprimir Guardar Guardar e imprimir

Cancelar **Vista previa de impresión**

h. Haga clic en la casilla de verificación y, a continuación, en Vista previa de impresión.

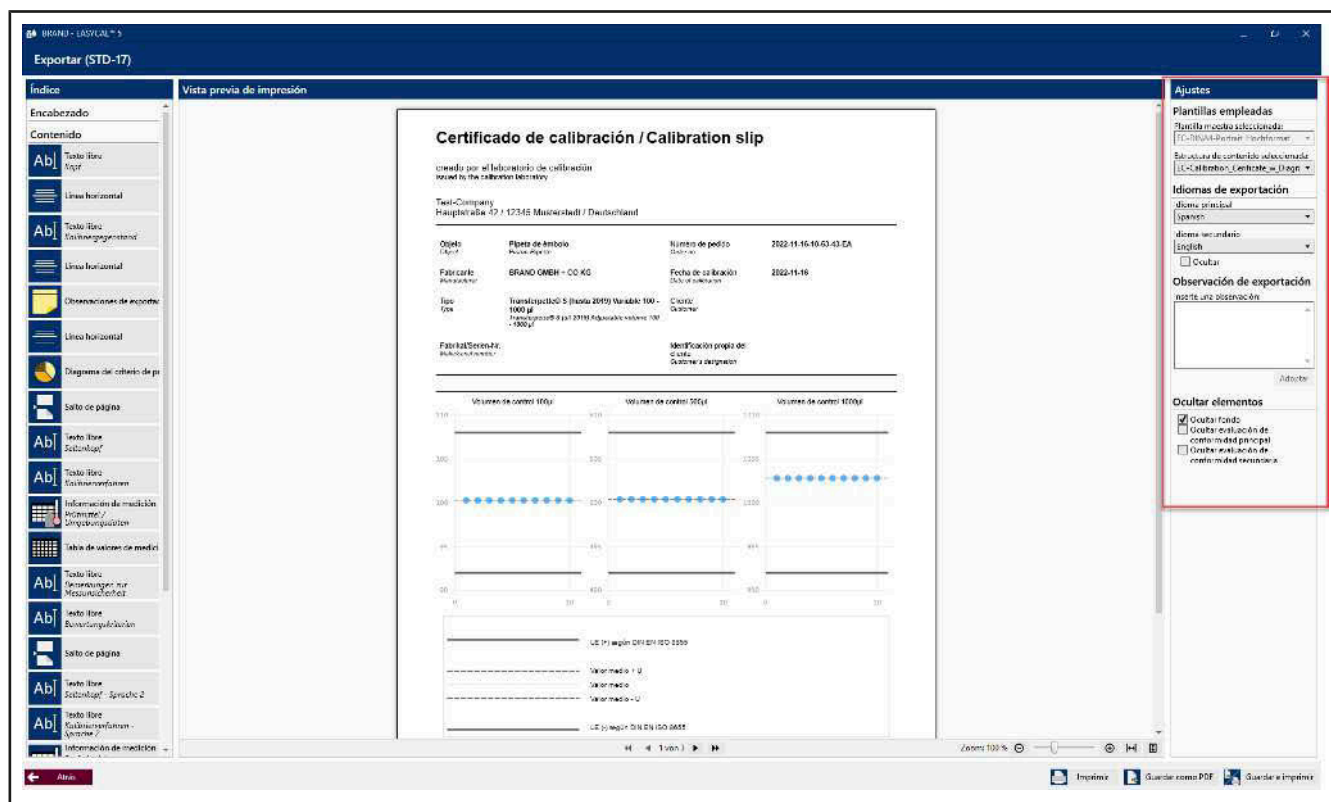

- Se abrirá el editor de certificados en el modo Vista previa de impresión. Podrá realizar ajustes en el área derecha y, en función de la estructura de contenido seleccionada, ingresar observaciones de exportación.

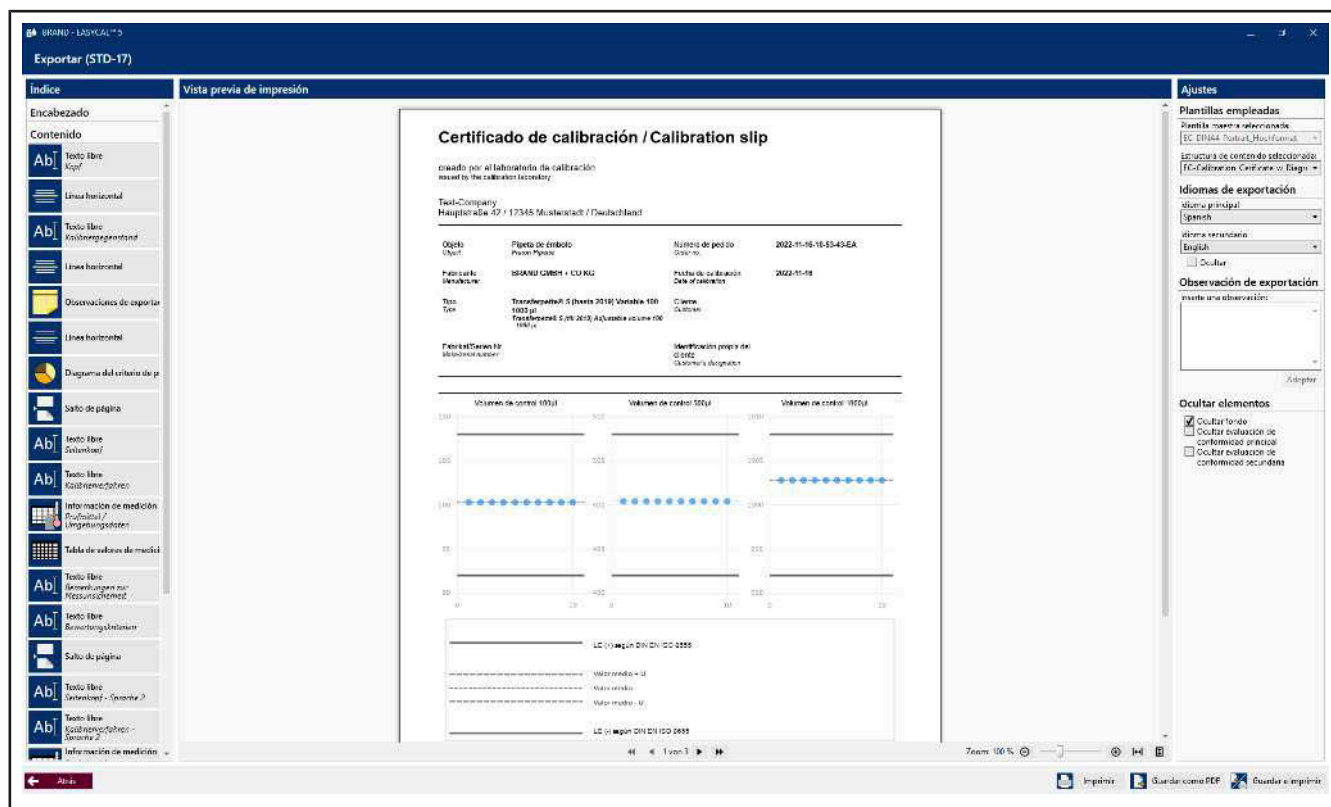

- i. Aquí también podrá exportar el certificado como PDF o imprimirlo en papel. Pulse para Atrás salir de Vista previa de impresión.

BRAND - EASYCAL™ 5

Encargo 2022-11-16-10-53-43-EA

Tipo de prueba: STD - Valor estándar Artículo: EC-704780 - Transferepette® 5 (hasta 2019) Variable 100 - 1000 µl

Número de encargo: 2022-11-16-10-53-43-EA Plan de prueba: 325.0 - EC-STD-ISO-PHP-1000

Tipo de encargo: Control individual Auditor: E. Admin

Tamaño de lote: 1 Fecha de calibración: 16/11/2022

Estado: Completado N.º de orden de compra: Cliente: Cliente final:

Indicaciones sobre el encargo: Comunicación con el cliente:

Criterios de prueba

Criterio de prueba	Denominación	Valor obj	Valor medio	Tol objet	Tol OK	Desviación es	E% objet	E% OK	CV % obj	CV % OK	CV % OK
1	1. vol. de prueba 100µl	100,29 µl	OK	0 µl	0 µl	0,29 %	0,29 %	OK	0 %	0 %	OK
2	2. vol. de prueba 500µl	500,4 µl	OK	0 µl	0 µl	1,6 %	0,08 %	OK	0,6 %	0 %	OK
3	vol. nominal 1000µl	1002,8 µl	OK	0 µl	0 µl	0,8 %	0,28 %	OK	0,3 %	0 %	OK

Vista general del certificado del aparato/de calibración

Tipo de certificado de calibración	N.º interno	Número de certificado de calibración	Fecha de calibración	Número de serie	Código del artículo	Rango de volumen	Pruebas reali.	Estado	Estado del aparato	Auditor	Certificado de calibración vinculado
Control individual	17	STD-17	16/11/2022		EC-704780	100 - 1000 µl	30	Completado		E. Admin	

Valación / autorización Iniciar protocolo interno Iniciar certificados Certificado de calibración nuevo

Atrás **Volver a la vista general del encargo** Guardar

- j. Haga clic en Volver a la vista general del encargo
- k. Desde aquí puede crear otros encargos e iniciar pruebas. Puede volver al menú principal con Atrás .



➔ Aquí finaliza este tutorial.



| Printed in Germany | 0823-3